


# VDR-4 – Imagier

Nicolas Blais St-Laurent inh


18 septembre 2019

# Cycle à haute et basse fréquence

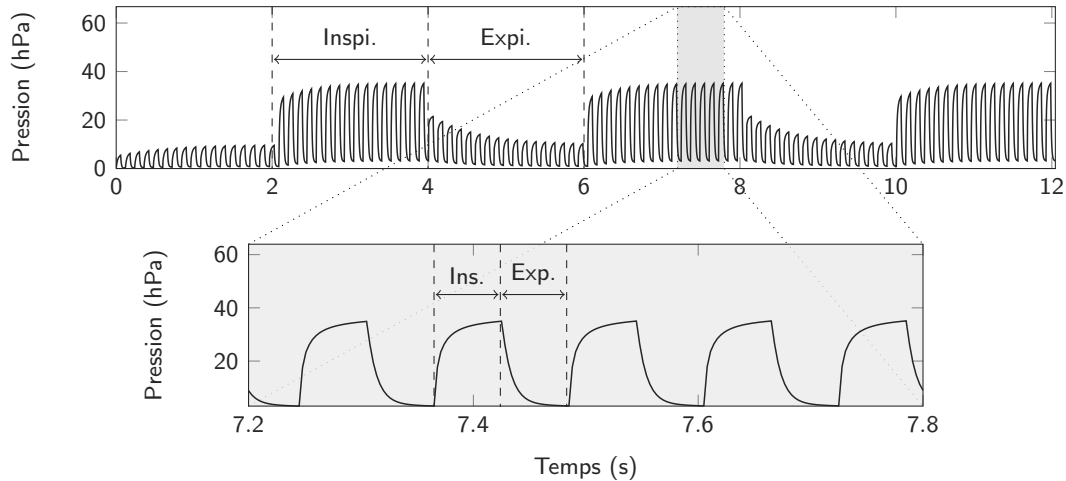


# Fonctionnement du phasitron


Insuflation

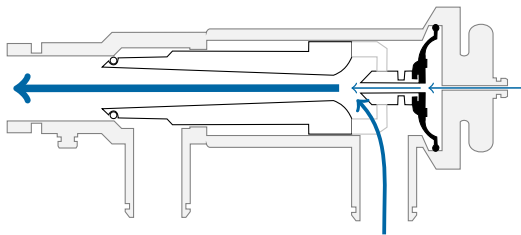


Expiration

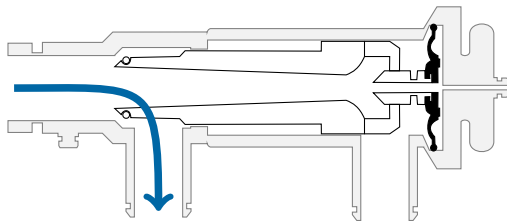


# Pressions moyennes

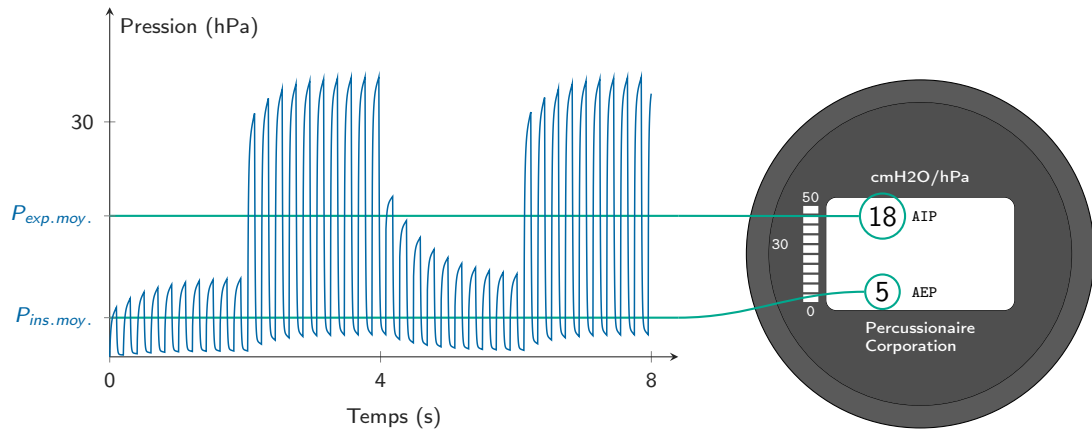


# Pression motrice

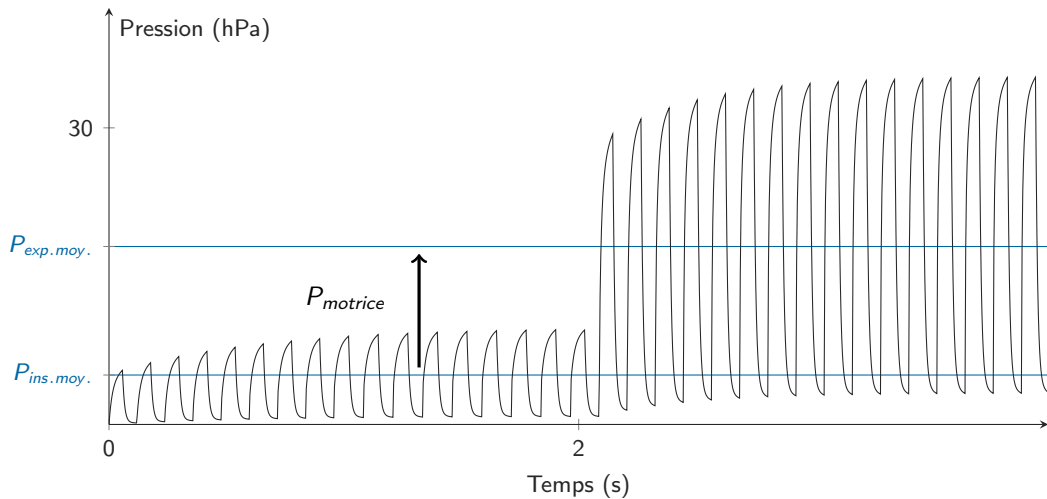

## Ratio I:E normal et inversé

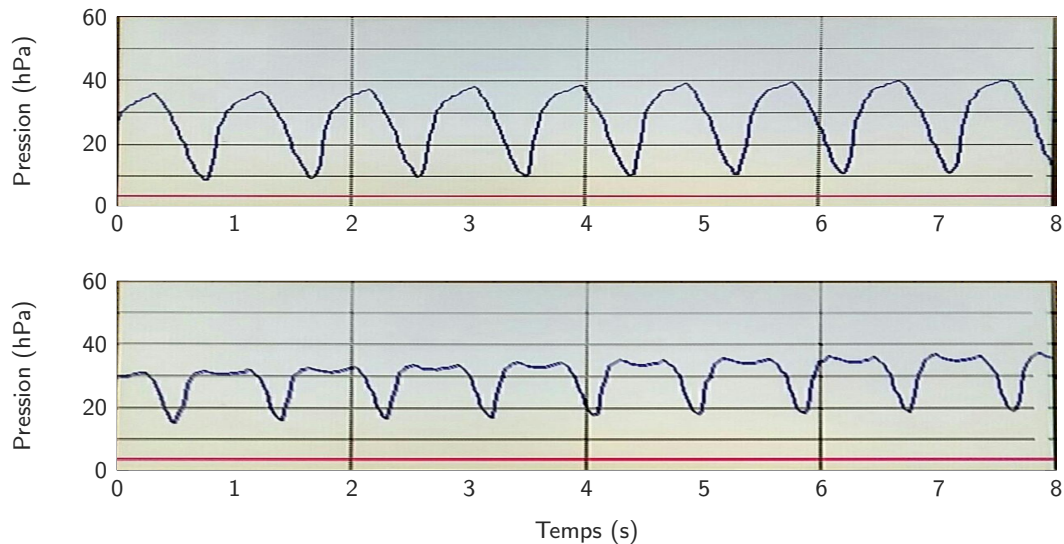


## Ratio I:E normal et inversé

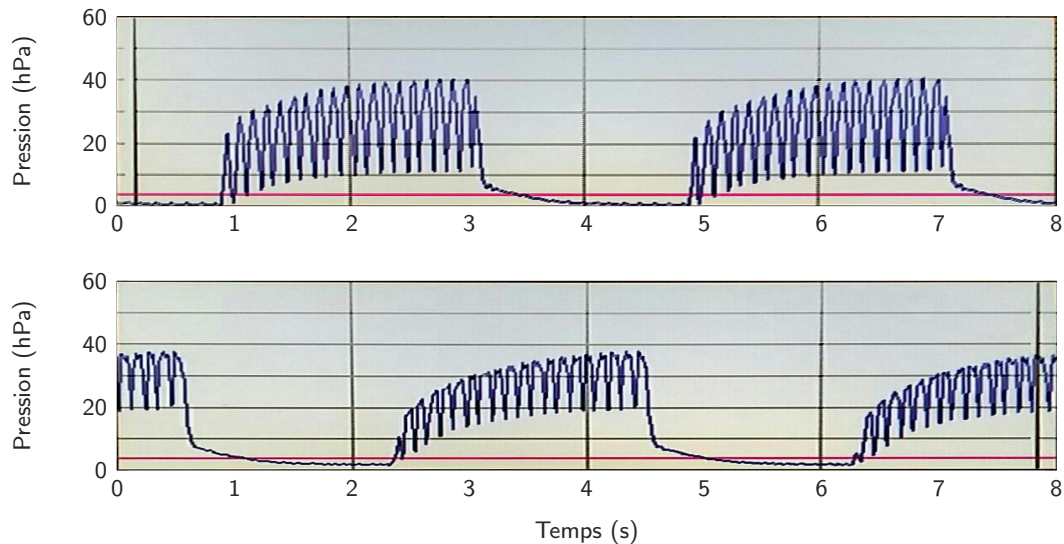


# Augmentation des résistances

Résistances normales

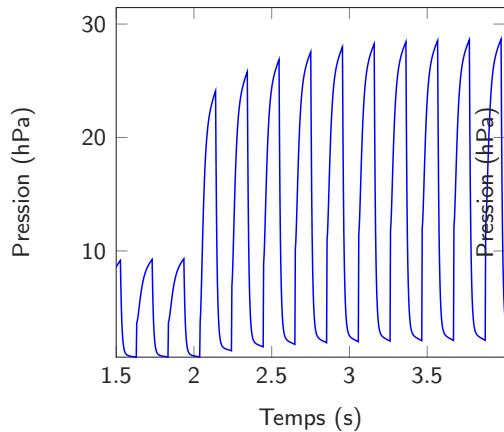


Résistances augmentées

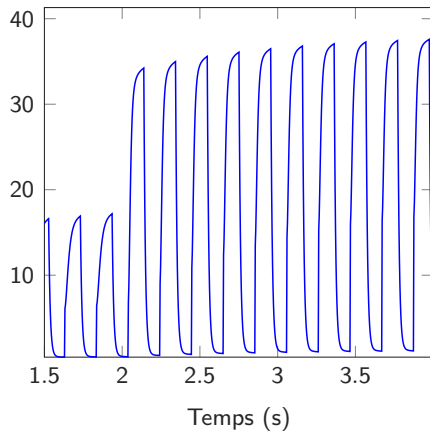





# Cartouche pneumatique

Cartouche ouverte

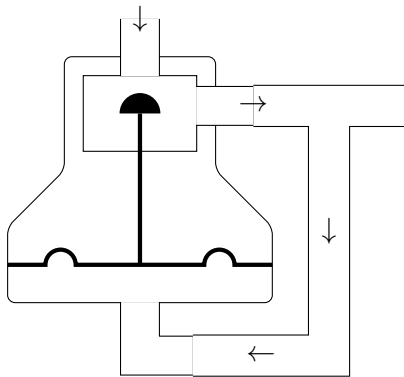


Cartouche fermée

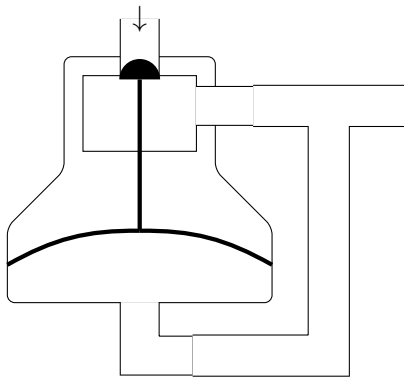



REVISÉD February '87

# Paramètres d'amplitude

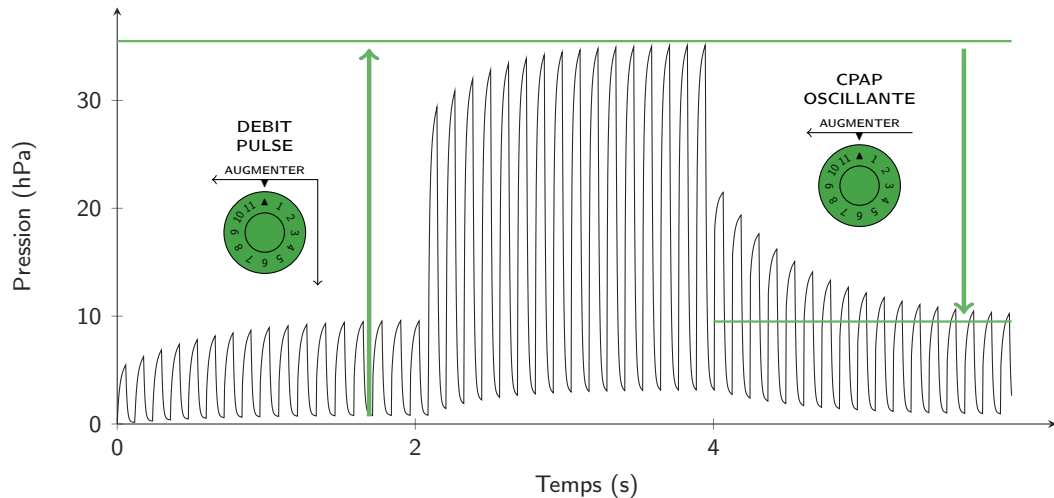


# Paramètre de cyclage haute fréquence

FREQUENCE  
DE PERCUSSION

AUGMENTER  
←



RAPPORT  
 $i/e$



# Séquence des ajustements

