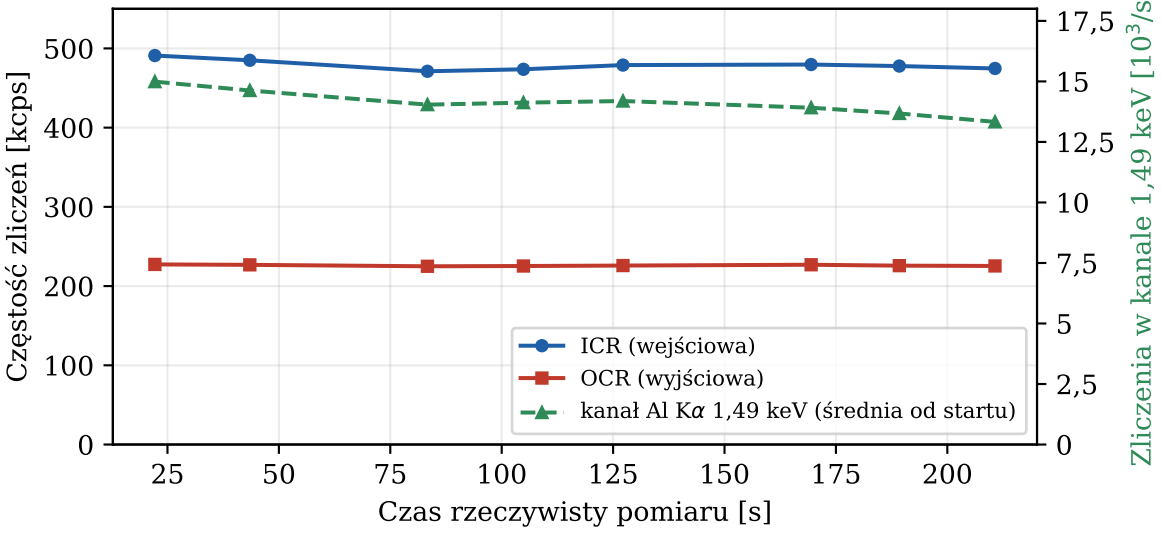
Częstość zliczeń [kcps]
0
100
200
300
400
500
25
50
75
100
125
150
175
200
Czas rzeczywisty pomiaru [s]
Zliczenia w kanale 1,49 keV [10$^3$/s]
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
ICR (wejściowa)
OCR (wyjściowa)
kanał Al Kα 1,49 keV (średnia od startu)