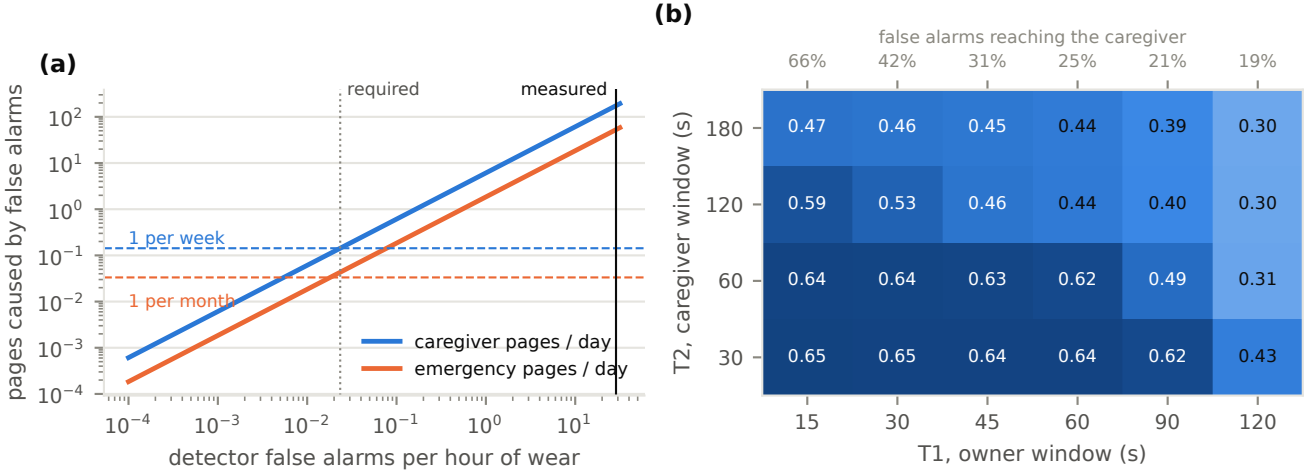
(a)
pages caused by false alarms
required
measured
1 per week
1 per month
caregiver pages / day
emergency pages / day
detector false alarms per hour of wear
(b)
false alarms reaching the caregiver
66%
42%
31%
25%
21%
19%
T2, caregiver window (s)
180
120
60
30
0.47 0.46 0.45 0.44 0.39 0.30
0.59 0.53 0.46 0.44 0.40 0.30
0.64 0.64 0.63 0.62 0.49 0.31
0.65 0.65 0.64 0.64 0.62 0.43
15
30
45
60
90
120
T1, owner window (s)