

Certificado de Calibración

CALIBRATION CERTIFICATE

Hoja 1 de 2
No. LMD-1365-25

Nombre del cliente: <i>Customer name:</i>	METRICS WORKS SALTILLO
Dirección: <i>Address:</i>	CALLE 17 No 3820 SALTILLO, COAHUILA C.P: 25013
Atención a: <i>Attention to:</i>	CARLOS GUTIERREZ
Descripción del instrumento: <i>Instrument description:</i>	MICROMETRO Alcance de Medición: 0 in a 1 in No. De Serie: 71500992 Identificación No: CALMI-001 Modelo: 293-340-30 Condiciones del equipo: Condiciones Normales de Operación.
Magnitud evaluada: <i>Evaluated quality:</i>	DIMENSIONAL
Marca: <i>Manufacturer:</i>	MITUTOYO
Resultado de calibración: <i>Calibration result:</i>	Se indica en la hoja 2
Incertidumbre: <i>Uncertainty:</i>	Se indica en la hoja 2
Condiciones ambientales de medición: <i>Environmental conditions of measurement:</i>	Temperatura: 20 °C ±1 °C Humedad Relativa: 45 % ±10 %
Fecha de recepción: <i>Reception date:</i>	2025-02-26
Fecha de calibración: <i>Date of calibration:</i>	2025-02-26
Fecha de emisión: <i>Date of issue:</i>	2025-02-27
Método utilizado: <i>Used method:</i>	PB-DIM-03 Procedimiento interno, Referencia: JIS B 7502 - vigente
Lugar de la calibración: <i>Place of calibration:</i>	Servicio en Planta.

Nota 1: Las condiciones y observaciones indicadas en la hoja siguiente forman parte de este certificado.

Este certificado tiene validez únicamente en su forma íntegra y original.

Nota 2: Este certificado de calibración cumple con los requisitos y especificaciones de la Norma ISO/IEC 17025:2017

Nota 3: Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en el certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en el momento de calibración.

Nota 4: Cualquier ajuste posterior a la calibración de los equipos, invalidará los resultados de la calibración.

Calibró:
Calibrated by:

Ing. Miguel A. Flores Escobedo
Metrólogo

Aprobó:
Approved by:

Ing. Miguel A. Flores Ríos
Metrólogo


FIR-PCC Rev 0

Resultados de Calibración

Hoja 2 de 2
No. LMD-1365-25

Gráfica de desviación

Alcance:		0.50000 in	a	1.00000 in	
		Resolución: 0.00005 in			
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre $\pm$ in	Error in	Tolerancia $\pm$ in	Juicio
0.50000	0.50001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple
0.60000	0.60000	0.000059	0.00000	0.00016	Sí cumple
0.65000	0.65001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple
0.70000	0.70001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple
0.75000	0.75001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple
0.80000	0.80000	0.000059	0.00000	0.00016	Sí cumple
0.85000	0.85001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple
0.90000	0.90001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple
0.95000	0.95001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple
1.00000	1.00001	0.000059	0.00001	0.00016	Sí cumple

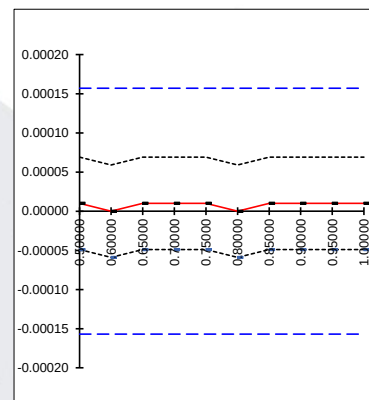

--- Tolerancia del Instrumento
--- Error $\pm$ Incertidumbre
--- Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI (Sistema Internacional) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura $k = 2$ para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC

La tolerancia reportada en este certificado fue calculada a partir de las especificaciones de exactitud provenientes de la norma JIS B 7502

Regla de decisión:

100% de aceptación estricta (ASME B89.7.3.1)

Aceptación estricta y rechazo relajado utilizando bandas de protección simétricas 100% de dos lados con resultados de medición promedio y rechazo con causa.

Error $\pm$ Incertidumbre dentro de tolerancias

Patrón utilizado
Trazabilidad
Número de certificado:
Vigencia
Identificación:

Gauge Block Set
CENAM
EM-DI-56028
2025-03-22
EPD-117

Termohigrómetro
CENAM
HUR-0081-2024 / TEM-0082-2024
2025-07-20 / 2025-07-24
EPT-64

Fin del certificado

FIC-RCC Rev 0