

Certificado de Calibración

CALIBRATION CERTIFICATE

Hoja 1 de 2
No.LMD-1650-26

Nombre del cliente: METRICS WORKS SALTILLO
Customer name:

Dirección: CALLE 17 #3820 INDUSTRIAL AMISTAD, SALTILLO COAHUILA,
Address: C.P. 25013

Atención a: CARLOS GUTIERREZ
Attention to:

Descripción del instrumento: **CALIPER**
Instrument description:
Alcance de Medición: 0 mm a 200 mm / 0 in a 8 in
No. De Serie: 39612
Identificación No: CALCA-010
Modelo: 571-212-30
Condiciones del equipo: Condiciones Normales de Operación.

Magnitud evaluada: **DIMENSIONAL**
Evaluated quality:

Marca: **MITUTOYO**
Manufacturer:

Resultado de calibración: Se indica en la hoja 2
Calibration result:

Incertidumbre: Se indica en la hoja 2
Uncertainty:

Condiciones ambientales de medición: Temperatura: 20 °C ±1 °C
Environmental conditions of measurement: Humedad Relativa: 45 % ±10 %

Fecha de recepción: 2026-03-12
Reception date:

Fecha de calibración: 2026-03-12
Date of calibration:

Fecha de emisión: 2026-03-13
Date of issue:

Método utilizado: **PB-DIM-01** Procedimiento interno, Referencia: **JIS B 7507** - vigente
Used method:

Lugar de la calibración: Servicio en Planta
Place of calibration:

Nota 1: Las condiciones y observaciones indicadas en la hoja siguiente forman parte de este certificado.

Este certificado tiene validez únicamente en su forma íntegra y original.

Nota 2: Este certificado de calibración cumple con los requisitos y especificaciones de la Norma ISO/IEC 17025:2017

Nota 3: Los resultados y los niveles de incertidumbres declarados en el certificado de calibración corresponden exclusivamente al instrumento descrito en el momento de calibración.

Nota 4: Cualquier ajuste posterior a la calibración de los equipos, invalidará los resultados de la calibración.

Calibró:
Calibrated by:

Ing. Miguel A. Flores Escobedo
Metrólogo

Aprobó:
Approved by:

Ing. Miguel A. Flores Ríos
Metrólogo

FIR-PCC Rev 0


Resultados de Calibración

Hoja 2 de 2
No.LMD-1650-26

MEDICIÓN DE EXTERIORES

Alcance:		20.00 mm	a	200.00 mm	
		Resolución:		0.01 mm	
Media del Patrón	Media del Instrumento	Incertidumbre $\pm$ mm	Error mm	Tolerancia $\pm$ mm	Juicio
20.000	20.00	0.0075	0.00	0.03	Sí cumple
40.000	40.00	0.0075	0.00	0.03	Sí cumple
60.000	60.00	0.0076	0.00	0.03	Sí cumple
80.000	80.00	0.0077	0.00	0.03	Sí cumple
100.000	100.00	0.0077	0.00	0.03	Sí cumple
120.000	120.00	0.0078	0.00	0.03	Sí cumple
140.000	140.00	0.0078	0.00	0.03	Sí cumple
160.000	160.00	0.0079	0.00	0.03	Sí cumple
180.000	180.00	0.0080	0.00	0.03	Sí cumple
200.000	200.00	0.0080	0.00	0.03	Sí cumple

Gráfica de desviación

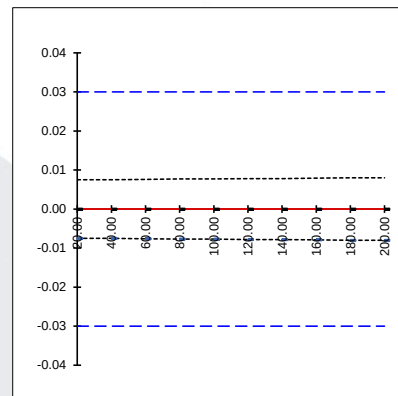

--- Tolerancia del Instrumento
--- Error $\pm$ Incertidumbre
--- Error = (Media del Instrumento-Media del Patrón)

Este instrumento fue calibrado usando patrones trazables al SI (Sistema Internacional) por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST EE.UU.) o (CENAM-México). La Evaluación de la incertidumbre incluye el instrumento bajo prueba y se calcula de acuerdo con la Guía para la expresión de incertidumbre en la medición ISO (GUM). Una relación de incertidumbre de prueba de al menos 4:1 se mantiene a menos que se indique lo contrario y se calcula utilizando la incertidumbre expandida de medición. La incertidumbre representa una incertidumbre expandida utilizando un factor de cobertura $k = 2$ para aproximarse a un nivel de confianza de un 95.45%.

Los resultados contenidos en este documento se refieren únicamente al elemento calibrado. Este certificado no podrá ser reproducido, excepto en su totalidad, sin el consentimiento por escrito de SIDEC

La tolerancia reportada en este certificado fue calculada a partir de las especificaciones de exactitud provenientes de norma JIS B 7507

Patrón utilizado	Gauge Block Set	Gauge Block	Termohigrobarómetro
Trazabilidad	CENAM	CENAM	CENAM
Número de certificado:	LMD-3747-25	LDI252752	3.2-38003/3.1-38003
Vigencia	2026-12-30	2027-05-07	2027-07-13/2027-07-13
Identificación:	EPD-117	EPD-31	EPT-55

Fin del certificado

FIC-RCC Rev 0