

PRUEBAS DE PALPADOR

Especificación del fabricante de la CMM

MPE* PALPADO (mm)	0.0018
-------------------	--------

Las siguientes desviaciones de las mediciones fueron medidas por el probador según los procedimientos de la norma ISO 10360-5 :2020



Resultados para la evaluación del desempeño del sistema de palpación con un solo palpador

Longitud del palpador (mm)	PSTU* (mm)	PFTU* (mm)	MPE* PALPADO (mm)	Incertidumbre del error de palpado k=2 (mm)
50.0000	0.0001	0.0001	0.0018	0.0003

Resultados para la evaluación del desempeño del sistema de palpación con múltiples palpadores

Longitud del palpador (mm)	PSTE* (mm)	PFTE* (mm)	PLTE* (mm)	MPE* PALPADO (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
50.0000	0.0000	0.0018	0.0006	0.0018	0.0003

* Ver última hoja de este certificado

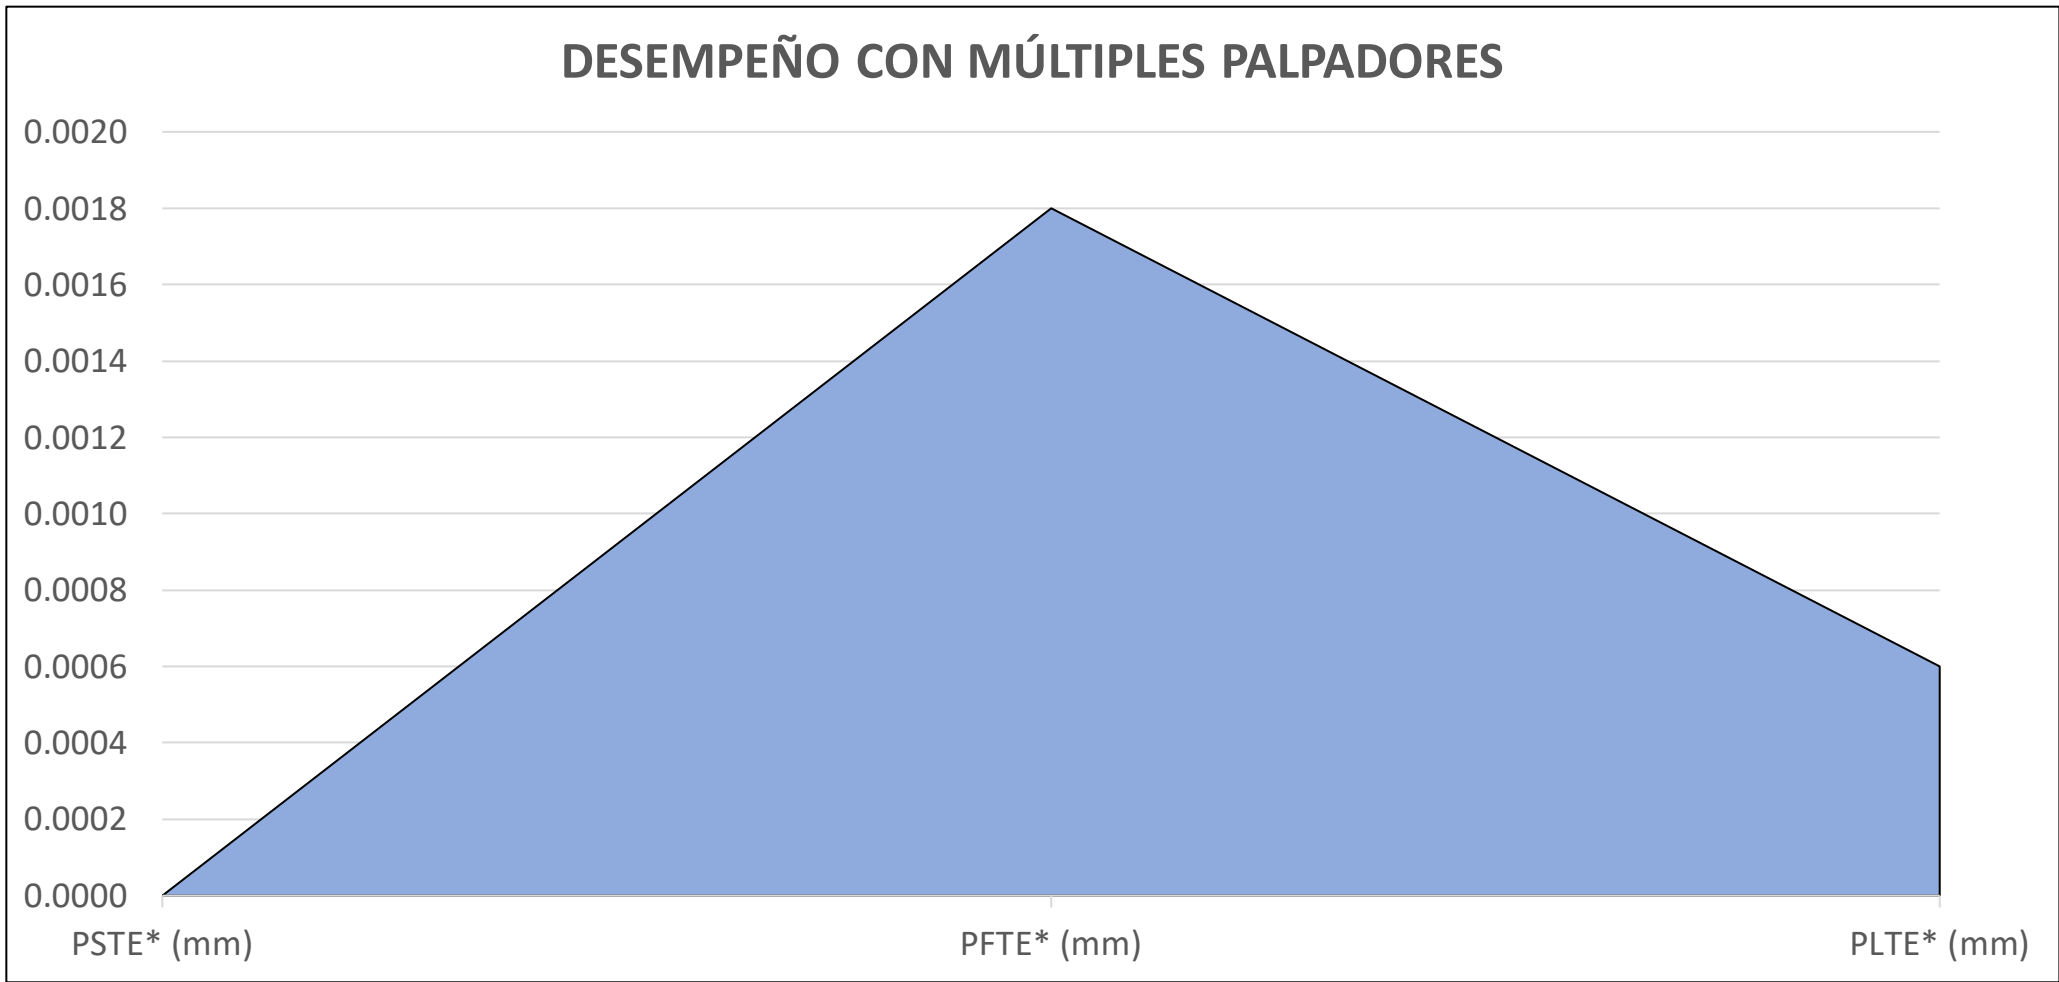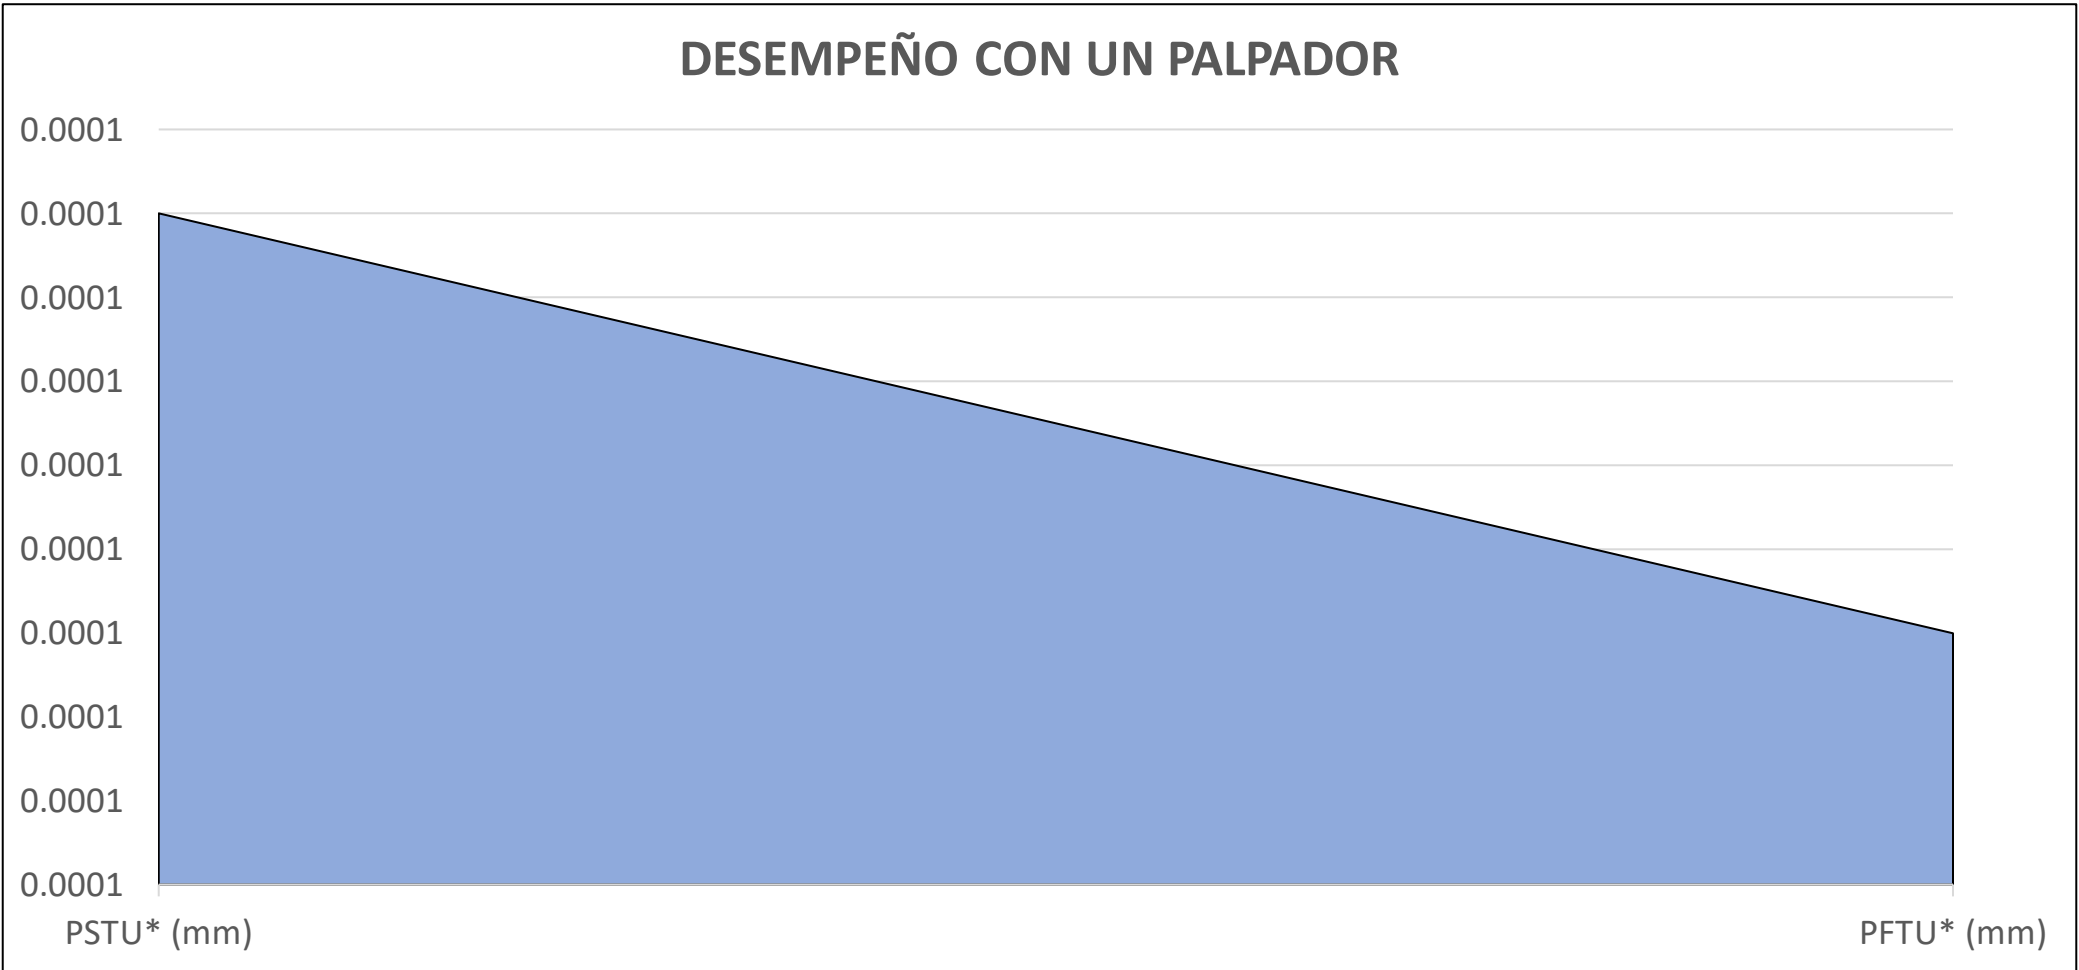

ESTA GRÁFICA MUESTRA LOS ERRORES DE PALPADO PARA TAMAÑO, FORMA Y LOCALIZACIÓN, PARA LAS PRUEBAS CON UNA POSICIÓN DEL PALPADOR, Y PARA 5 POSICIONES DE PALPADOR LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DEL PATRÓN FUE CALCULADA SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE LA NMX-CH-140 IMNC-2002.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2

HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE PALPADOR, k=2
U= ± 0.0003 mm

Lineal del Eje X


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3307	100.3306	100.3306	-0.0008	-0.0009	-0.0009	100.3306	-0.0009	0.0021	0.0001	0.0015
200.1601	200.1599	200.1598	200.1598	-0.0002	-0.0003	-0.0003	200.1598	-0.0003	0.0024	0.0001	0.0016
400.2628	400.2624	400.2625	400.2625	-0.0004	-0.0003	-0.0003	400.2625	-0.0003	0.0030	0.0001	0.0018
599.9786	599.9790	599.9787	599.9793	0.0004	0.0001	0.0007	599.9790	0.0004	0.0036	0.0006	0.0020
700.3705	700.3704	700.3703	700.3704	-0.0001	-0.0002	-0.0001	700.3704	-0.0001	0.0039	0.0001	0.0021

* Ver última hoja de este certificado

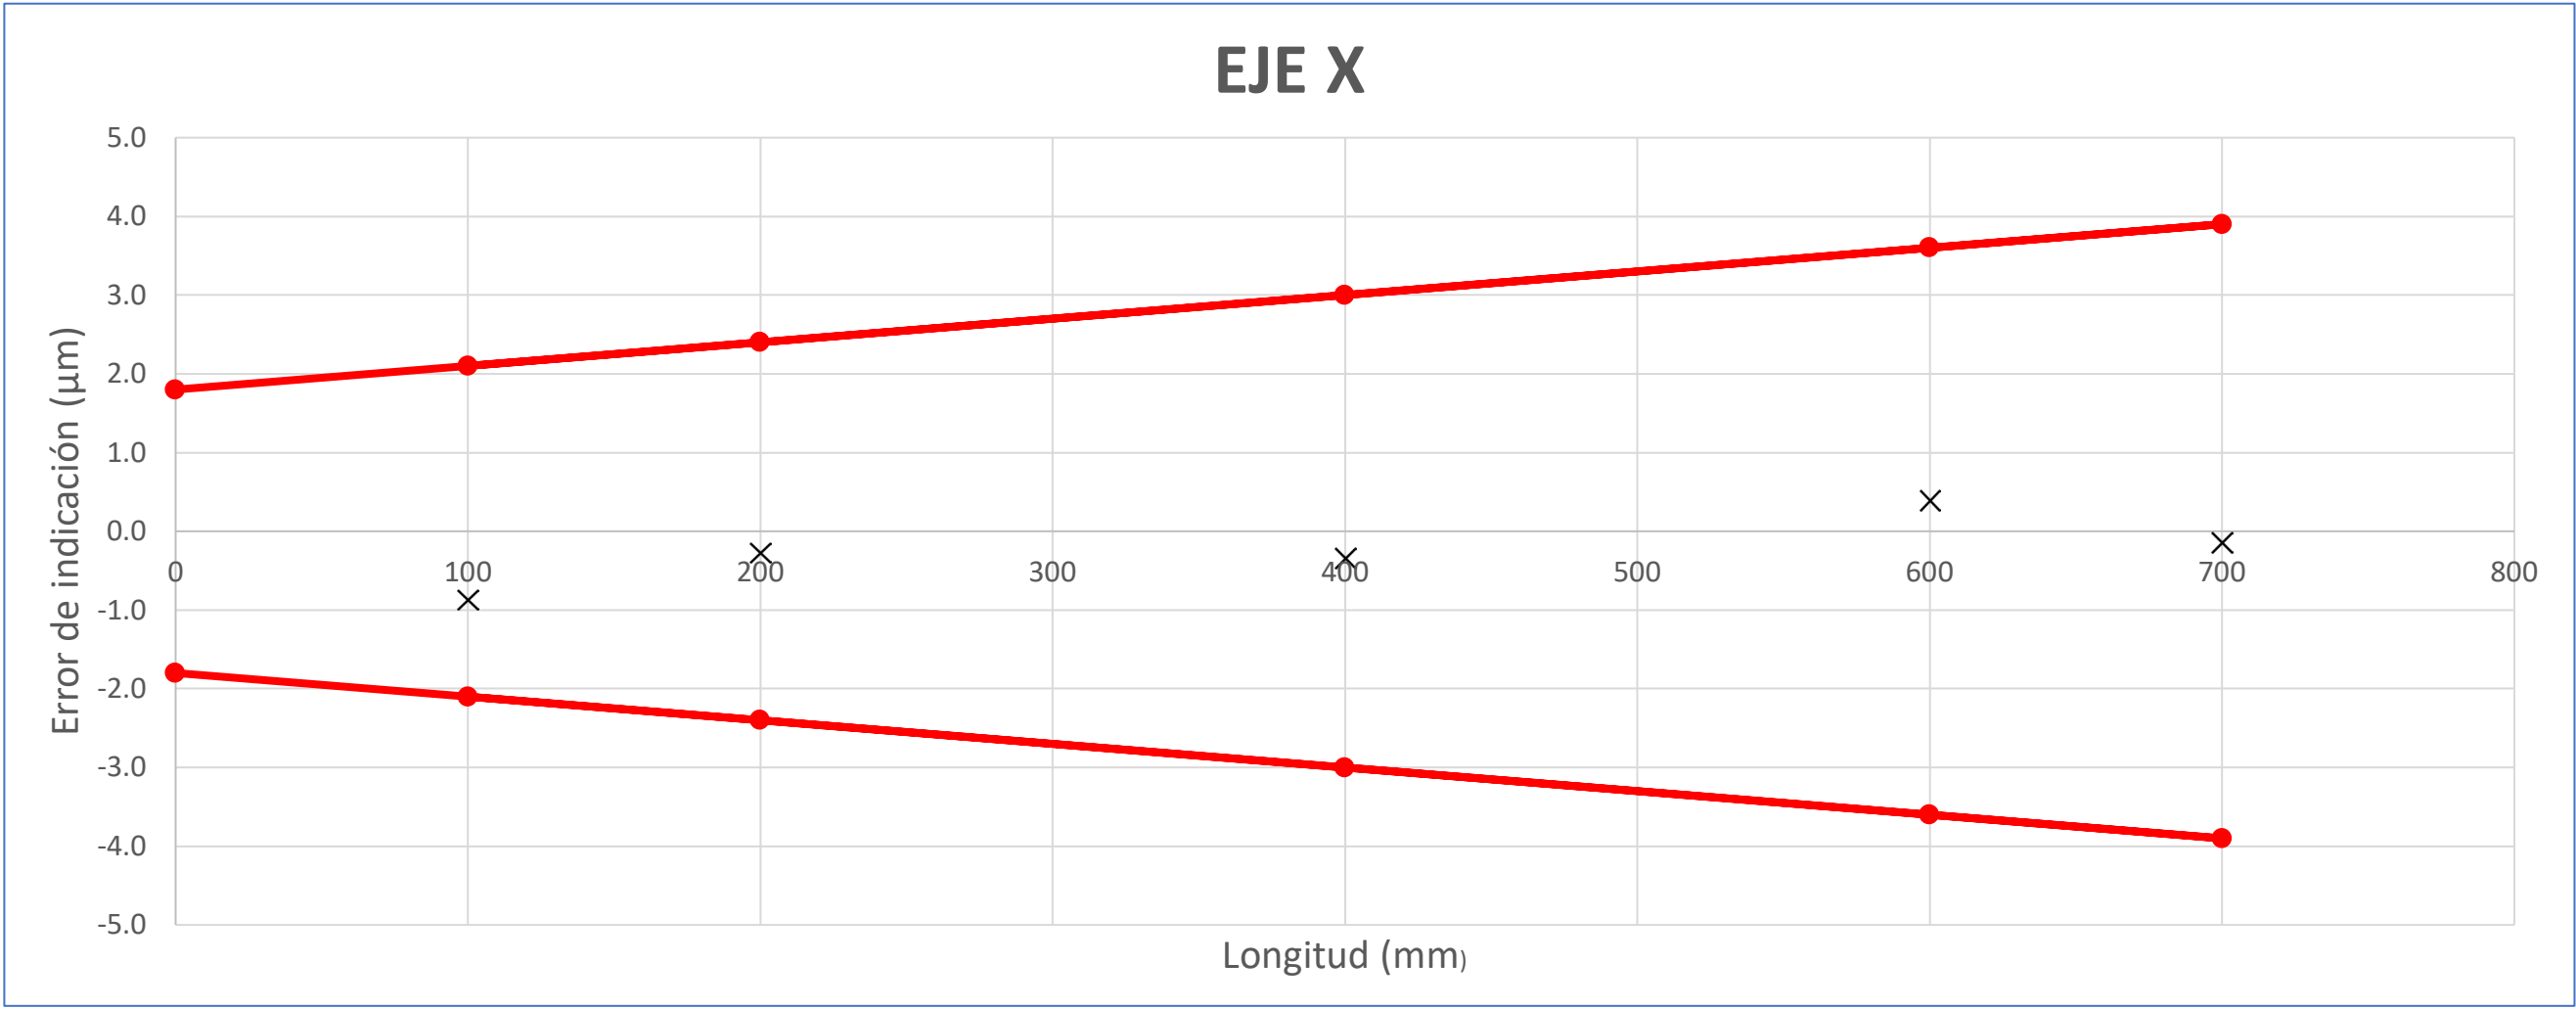

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

Lineal del Eje Y


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3311	100.3310	100.3312	-0.0004	-0.0005	-0.0003	100.3311	-0.0004	0.0021	0.0002	0.0015
300.3099	300.3089	300.3087	300.3086	-0.0010	-0.0012	-0.0013	300.3087	-0.0012	0.0027	0.0003	0.0017
599.9786	599.9814	599.9815	599.9817	0.0028	0.0029	0.0031	599.9815	0.0029	0.0036	0.0003	0.0020
900.1928	900.1908	900.1907	900.1907	-0.0020	-0.0021	-0.0021	900.1907	-0.0021	0.0045	0.0001	0.0023
1250.0770	1250.0744	1250.0747	1250.0746	-0.0026	-0.0023	-0.0024	1250.0746	-0.0024	0.0056	0.0003	0.0027

* Ver última hoja de este certificado

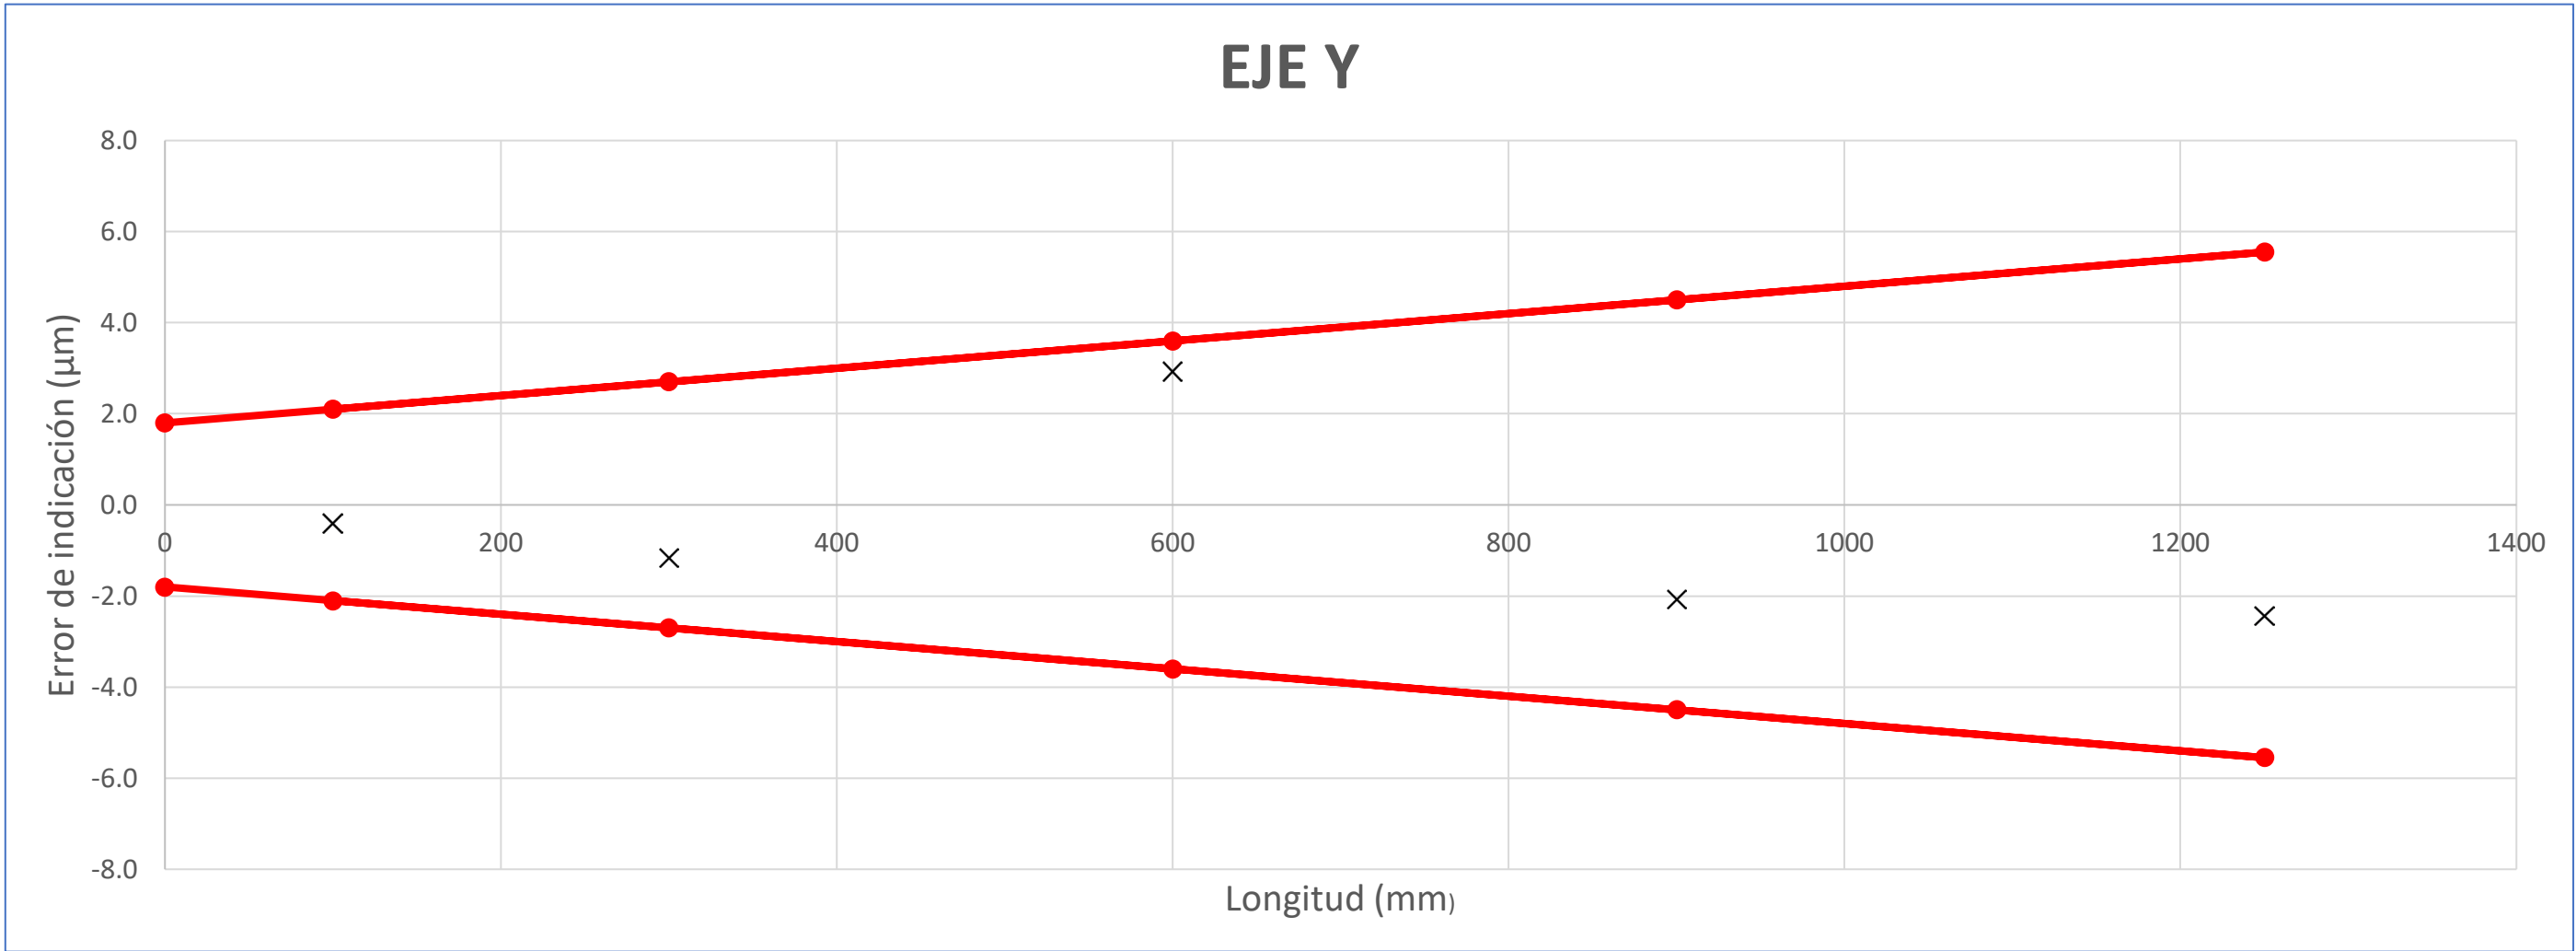

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

Lineal del Eje Z


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3308	100.3307	100.3307	-0.0007	-0.0008	-0.0008	100.3307	-0.0008	0.0021	0.0001	0.0015
200.1601	200.1589	200.1589	200.1588	-0.0012	-0.0012	-0.0013	200.1589	-0.0012	0.0024	0.0001	0.0016
400.2628	400.2613	400.2614	400.2614	-0.0015	-0.0014	-0.0014	400.2614	-0.0014	0.0030	0.0001	0.0018
500.2956	500.2941	500.2940	500.2939	-0.0015	-0.0016	-0.0017	500.2940	-0.0016	0.0033	0.0002	0.0019
599.9786	599.9766	599.9766	599.9767	-0.0020	-0.0020	-0.0019	599.9766	-0.0020	0.0036	0.0001	0.0020

* Ver última hoja de este certificado

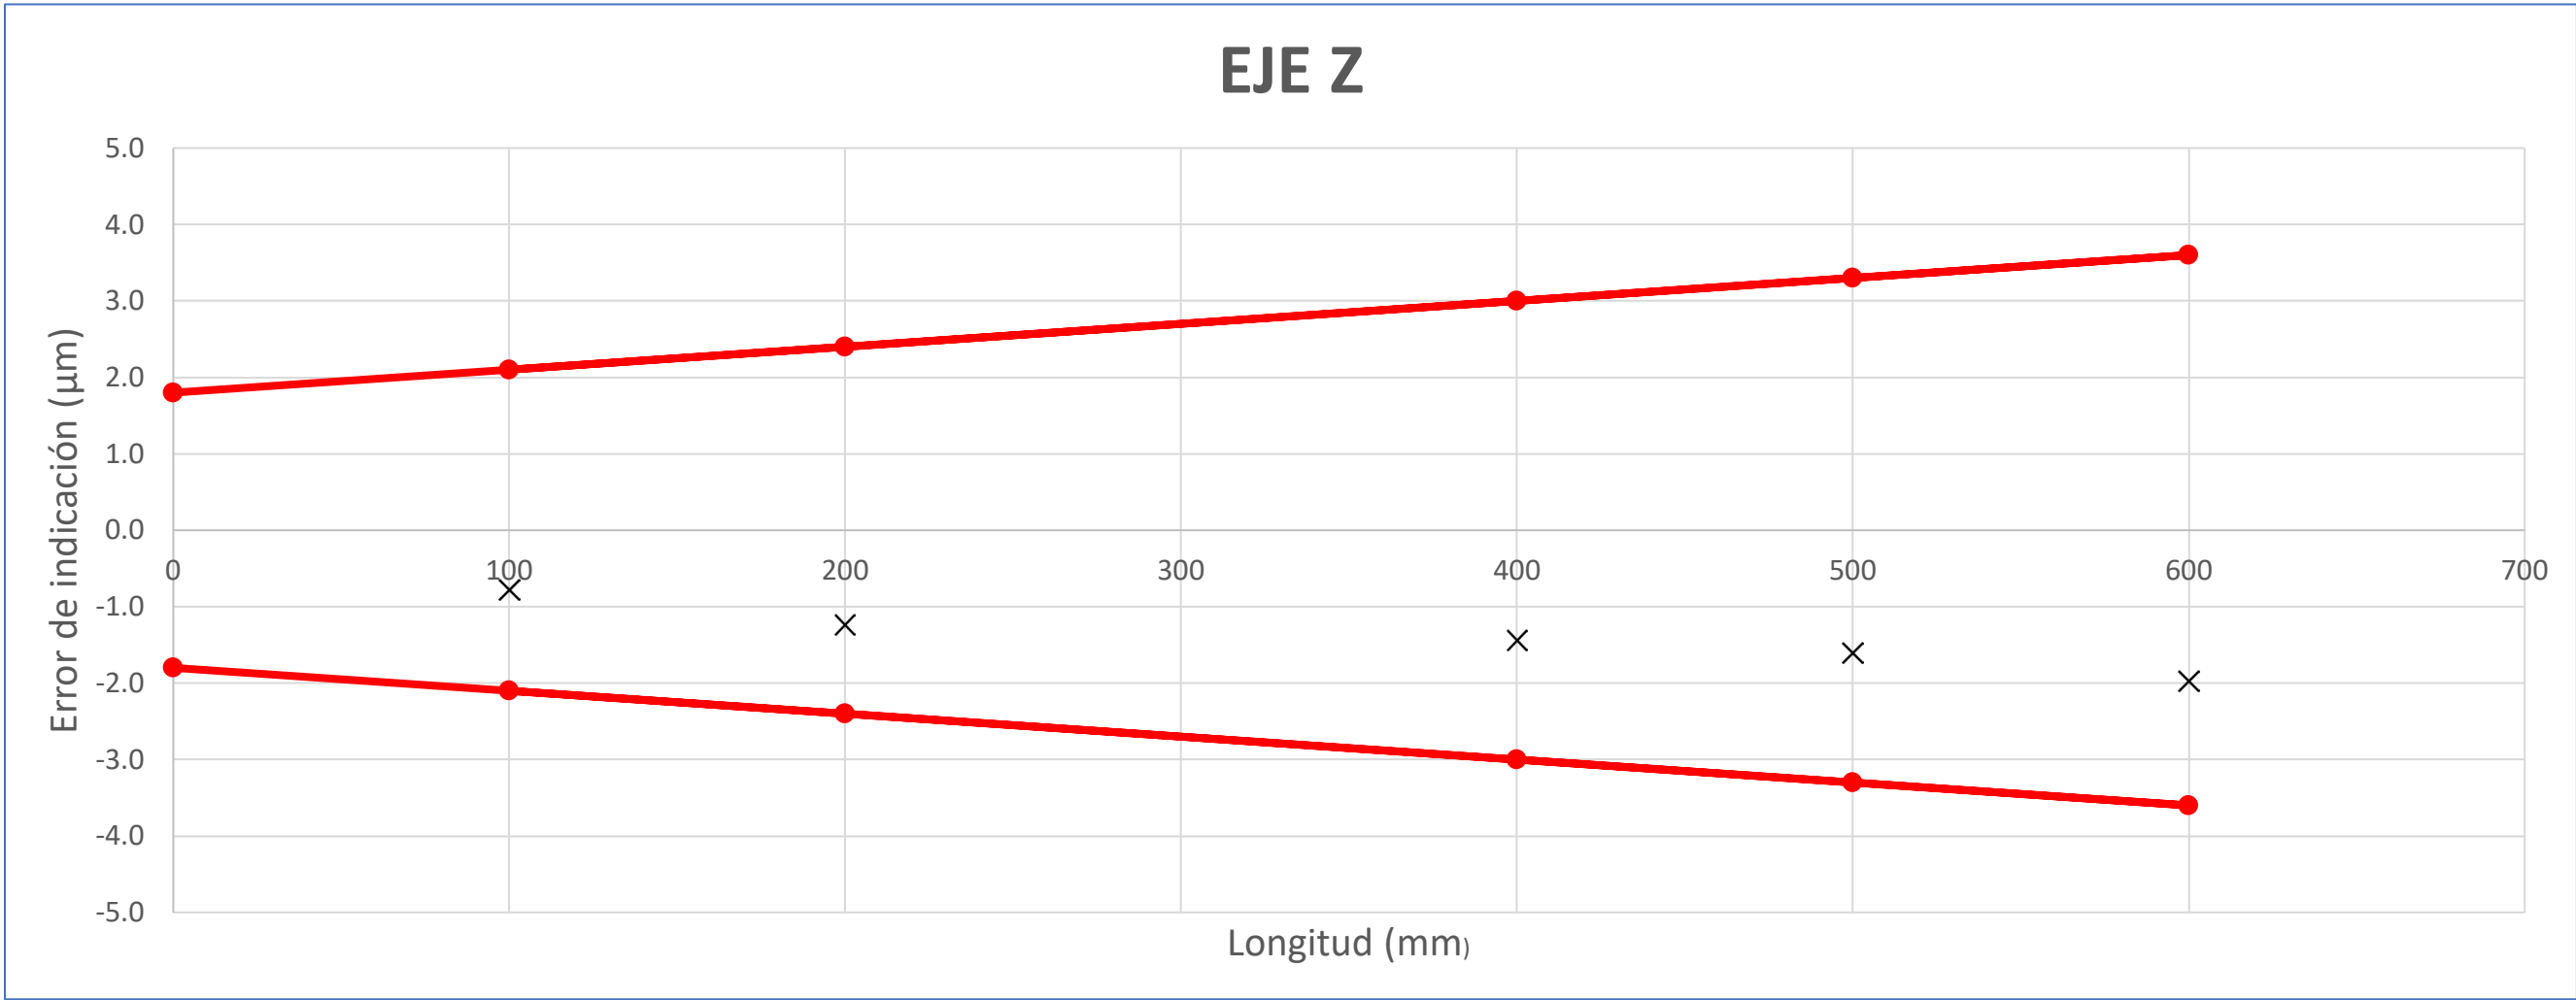

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

DIAGONAL R3D FR DIRECTION


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3309	100.3309	100.3309	-0.0006	-0.0006	-0.0006	100.3309	-0.0006	0.0021	0.0000	0.0015
300.3099	300.3090	300.3091	300.3090	-0.0009	-0.0008	-0.0009	300.3090	-0.0009	0.0027	0.0001	0.0017
599.9786	599.9767	599.9768	599.9769	-0.0019	-0.0018	-0.0017	599.9768	-0.0018	0.0036	0.0002	0.0020
900.1928	900.1904	900.1905	900.1907	-0.0024	-0.0023	-0.0021	900.1905	-0.0023	0.0045	0.0003	0.0023
1250.0770	1250.0738	1250.0740	1250.0740	-0.0032	-0.0030	-0.0030	1250.0739	-0.0031	0.0056	0.0002	0.0027

* Ver última hoja de este certificado

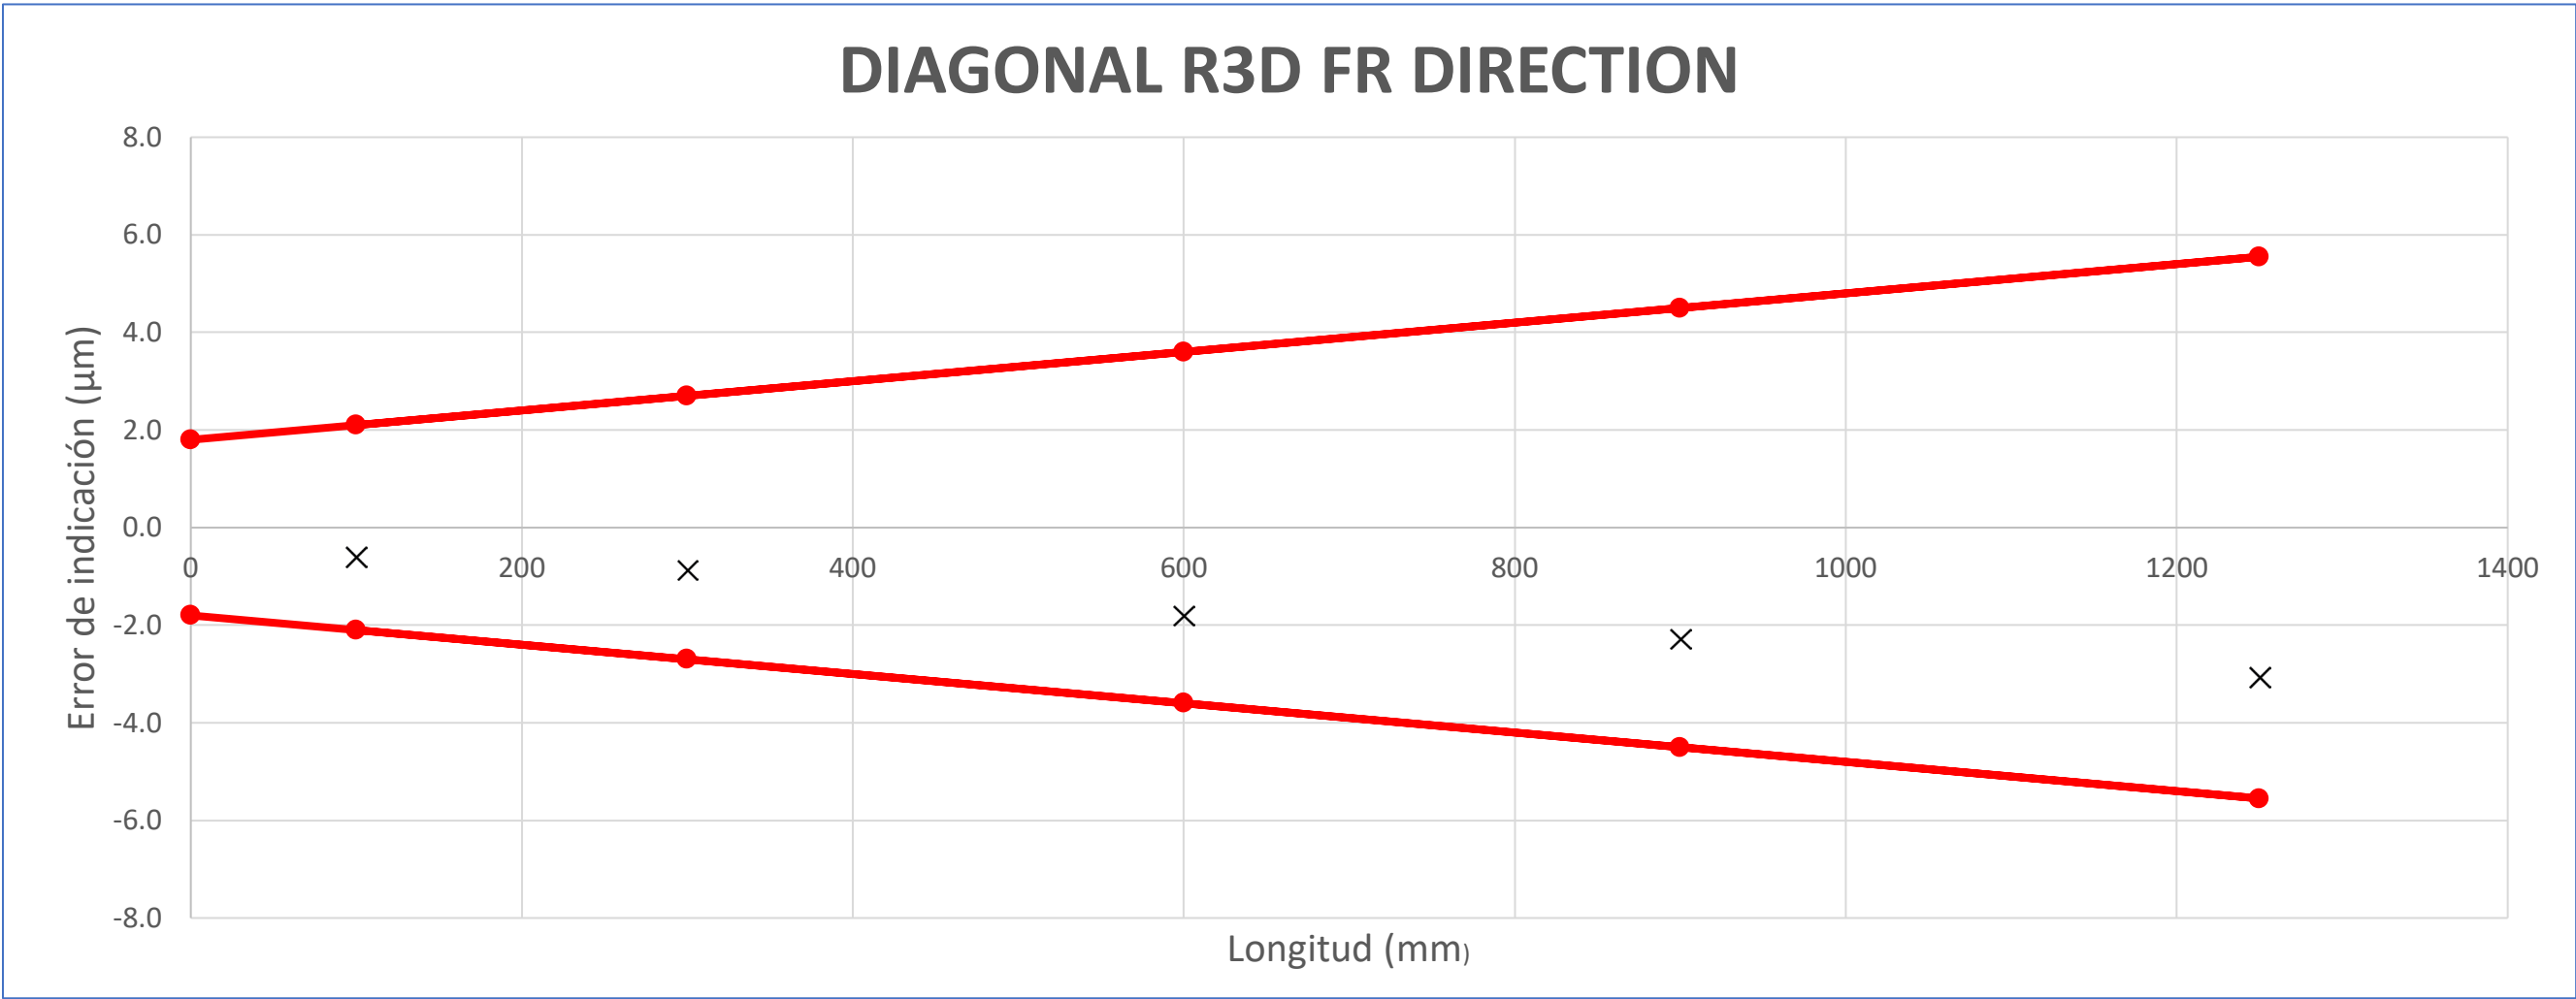

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
UMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
UMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

DIAGONAL R3D FL DIRECTION


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3313	100.3312	100.3313	-0.0002	-0.0003	-0.0002	100.3313	-0.0002	0.0021	0.0001	0.0015
300.3099	300.3090	300.3089	300.3088	-0.0009	-0.0010	-0.0011	300.3089	-0.0010	0.0027	0.0002	0.0017
599.9786	599.9780	599.9778	599.9776	-0.0006	-0.0008	-0.0010	599.9778	-0.0008	0.0036	0.0004	0.0020
900.1928	900.1918	900.1916	900.1916	-0.0010	-0.0012	-0.0012	900.1917	-0.0011	0.0045	0.0002	0.0023
1250.0770	1250.0742	1250.0743	1250.0797	-0.0028	-0.0027	0.0027	1250.0761	-0.0009	0.0056	0.0055	0.0027

* Ver última hoja de este certificado

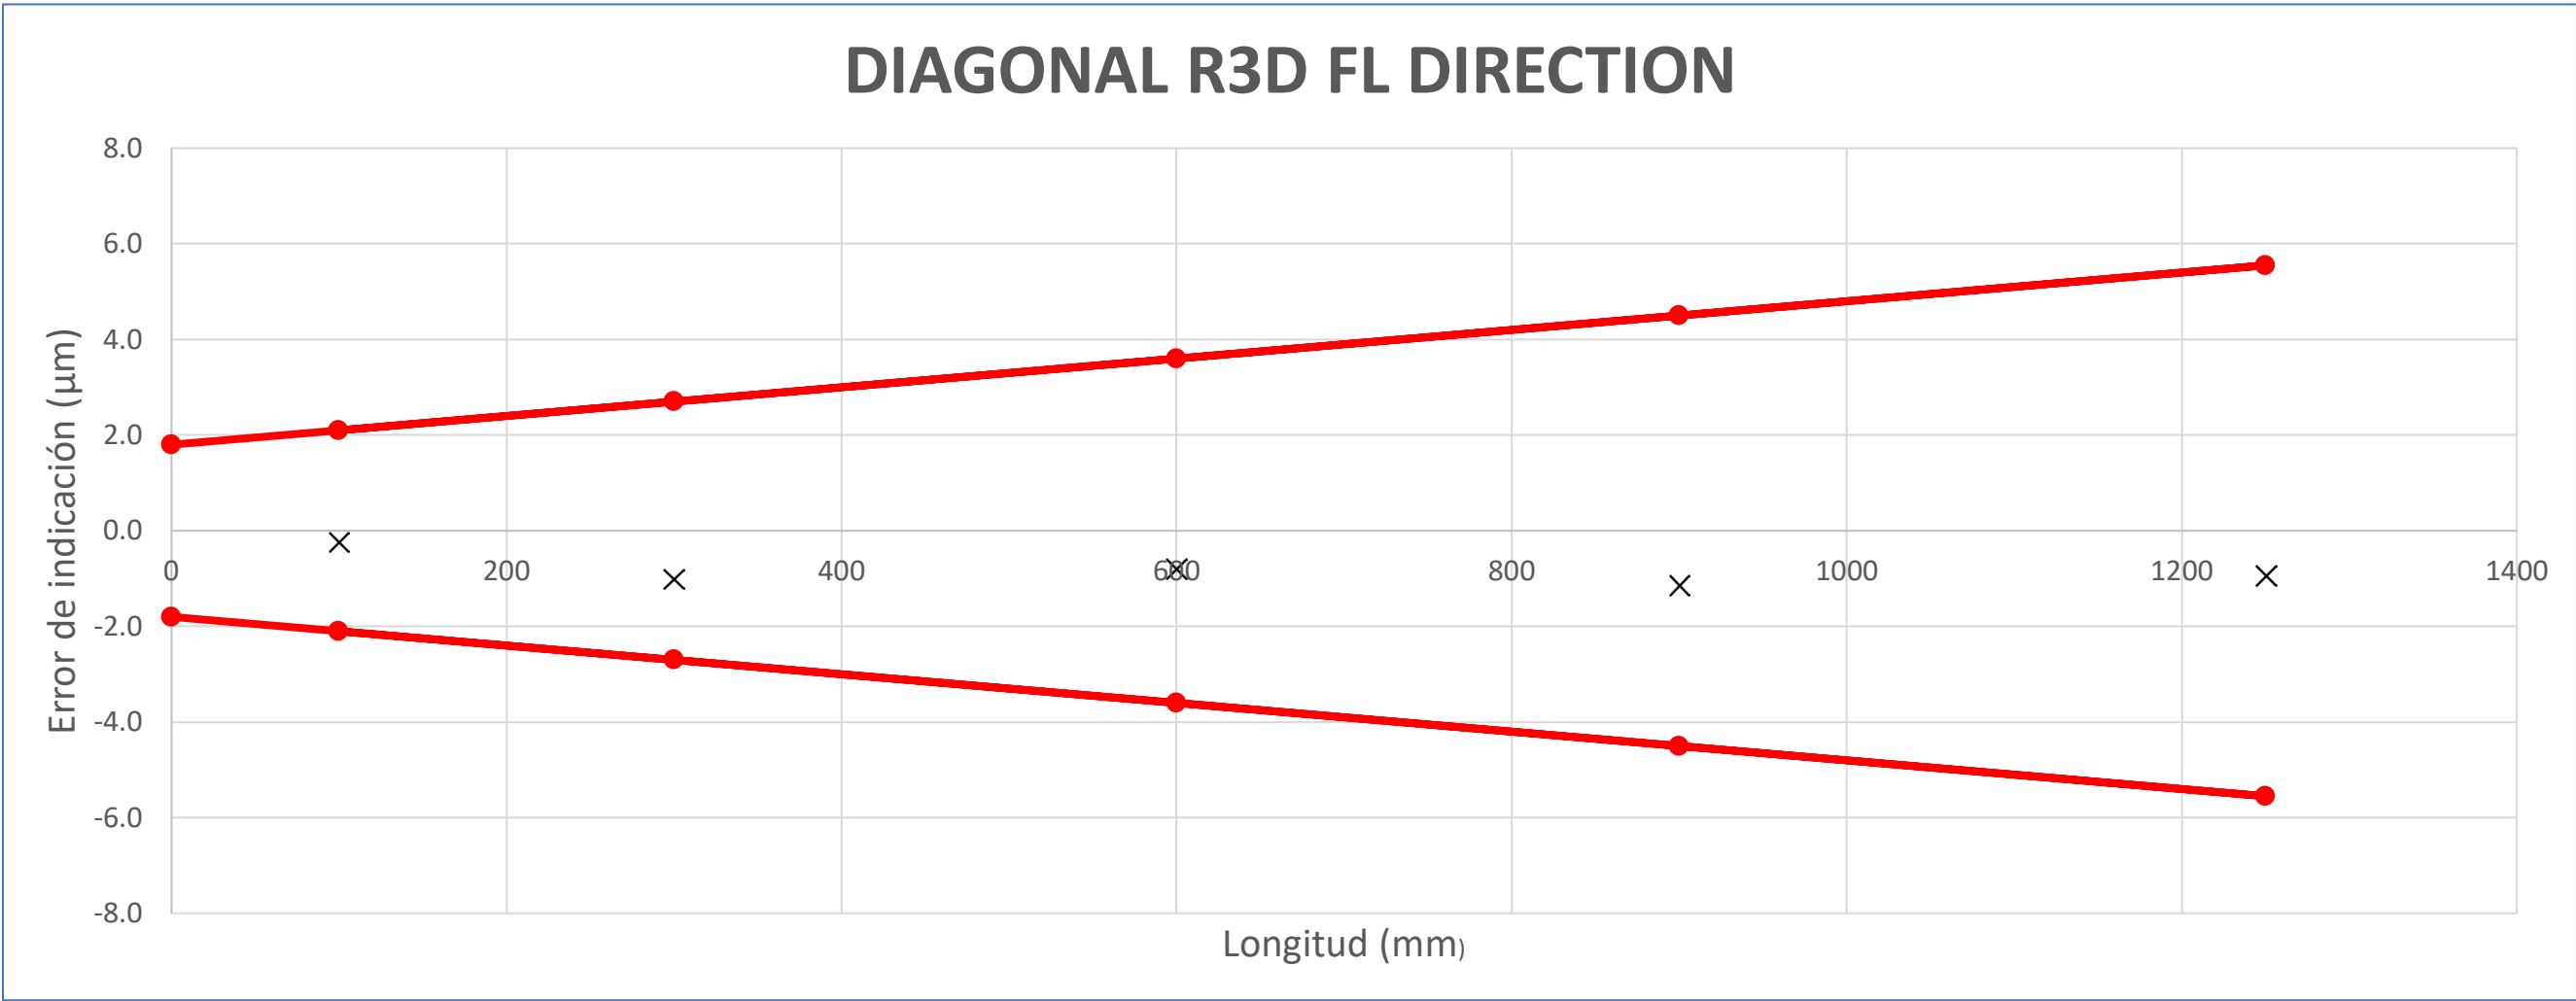

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

DIAGONAL R3D RL DIRECTION


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3315	100.3314	100.3312	0.0000	-0.0001	-0.0003	100.3314	-0.0001	0.0021	0.0003	0.0015
300.3099	300.3109	300.3111	300.3111	0.0010	0.0012	0.0012	300.3110	0.0011	0.0027	0.0002	0.0017
599.9786	599.9803	599.9804	599.9804	0.0017	0.0018	0.0018	599.9804	0.0018	0.0036	0.0001	0.0020
900.1928	900.1951	900.1954	900.1954	0.0023	0.0026	0.0026	900.1953	0.0025	0.0045	0.0003	0.0023
1250.0770	1250.0806	1250.0808	1250.0808	0.0036	0.0038	0.0038	1250.0807	0.0037	0.0056	0.0002	0.0027

* Ver última hoja de este certificado

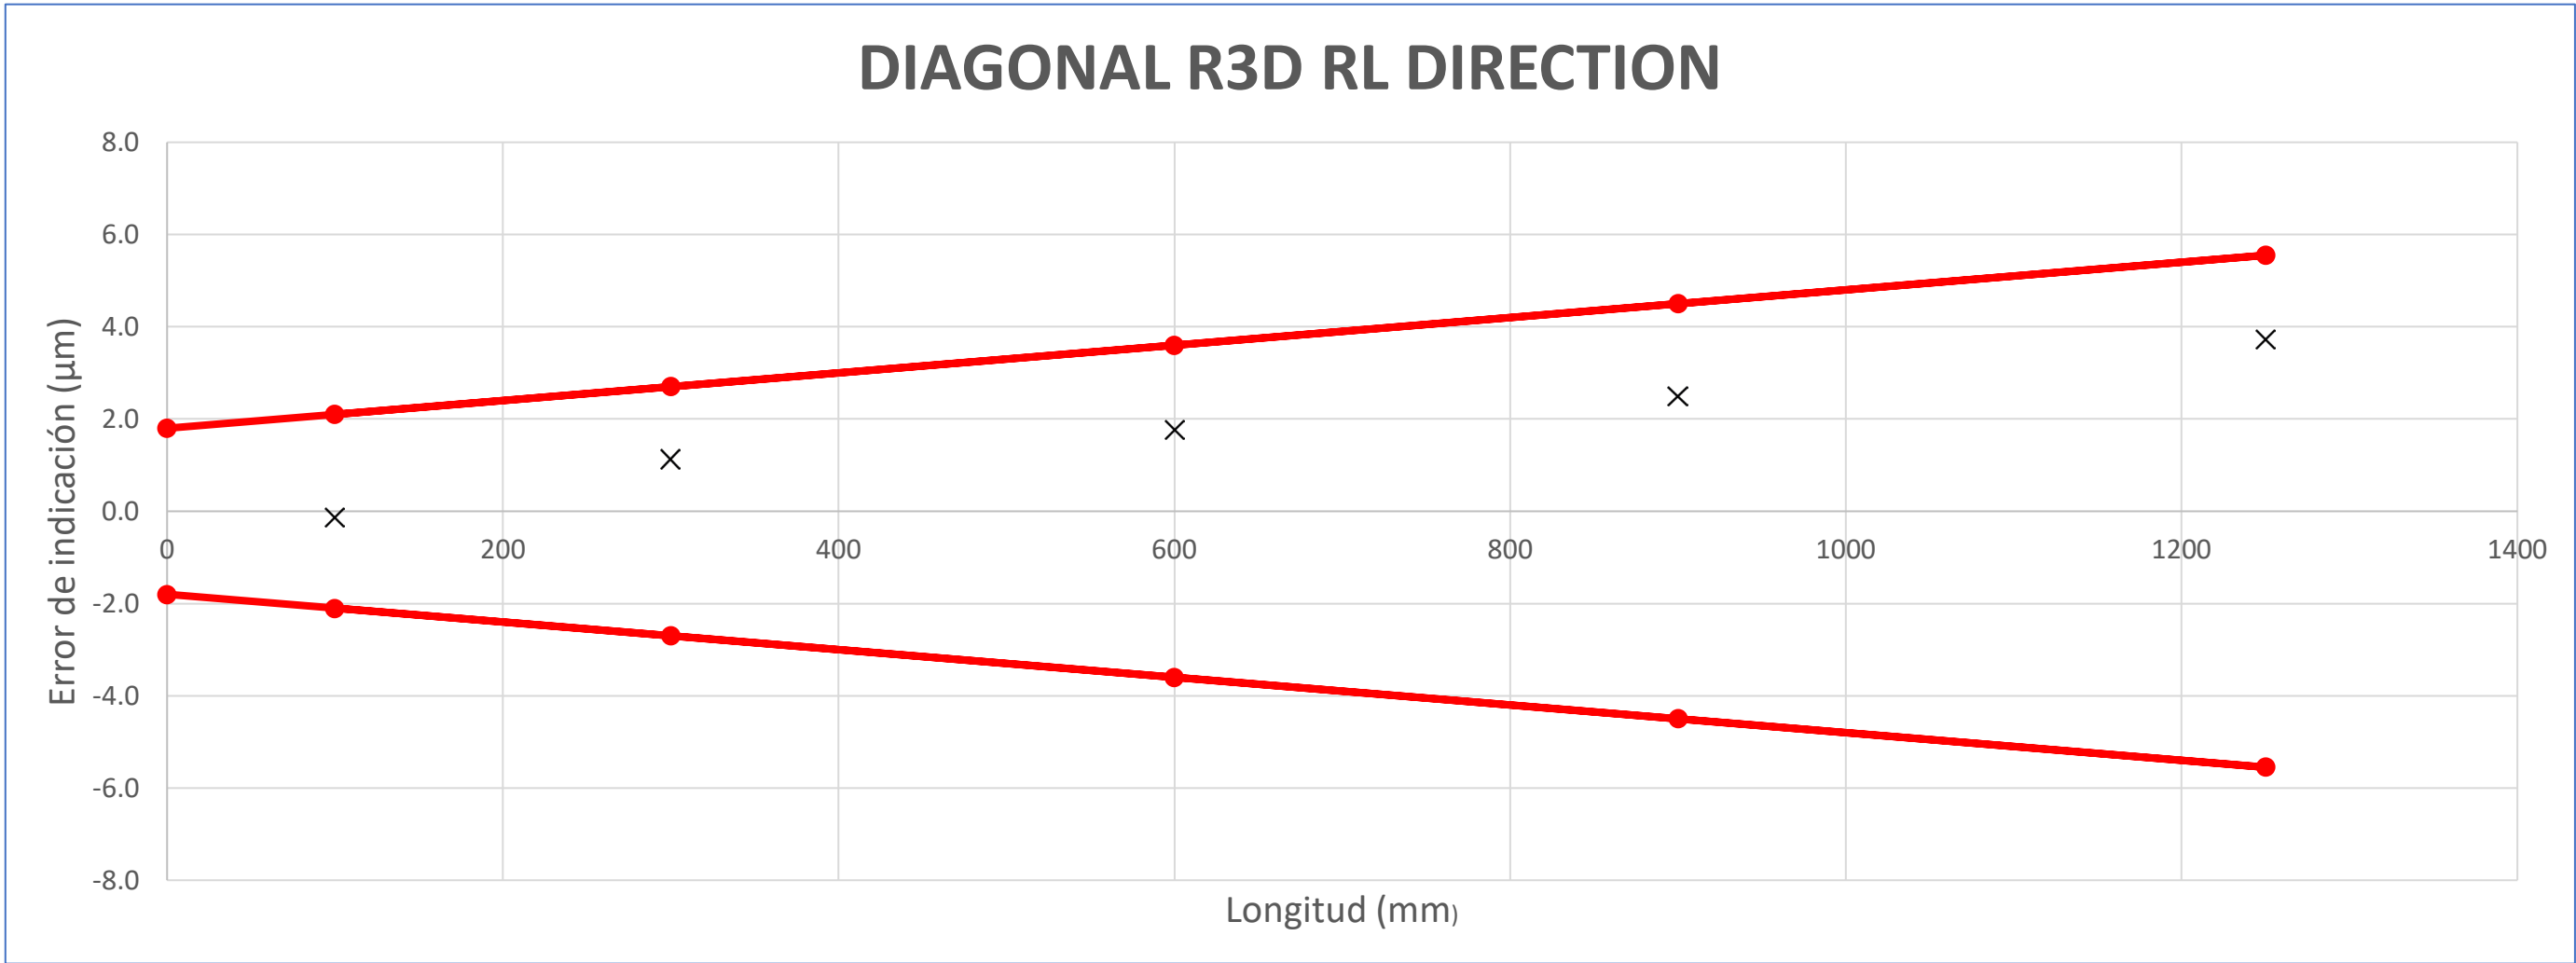

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

DIAGONAL R3D RR DIRECTION


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3320	100.3319	100.3320	0.0005	0.0004	0.0005	100.3320	0.0005	0.0021	0.0001	0.0015
300.3099	300.3107	300.3111	300.3111	0.0008	0.0012	0.0012	300.3110	0.0011	0.0027	0.0004	0.0017
599.9786	599.9808	599.9809	599.9810	0.0022	0.0023	0.0024	599.9809	0.0023	0.0036	0.0002	0.0020
900.1928	900.1953	900.1955	900.1955	0.0025	0.0027	0.0027	900.1954	0.0026	0.0045	0.0002	0.0023
1250.0770	1250.0798	1250.0800	1250.0799	0.0028	0.0030	0.0029	1250.0799	0.0029	0.0056	0.0002	0.0027

* Ver última hoja de este certificado

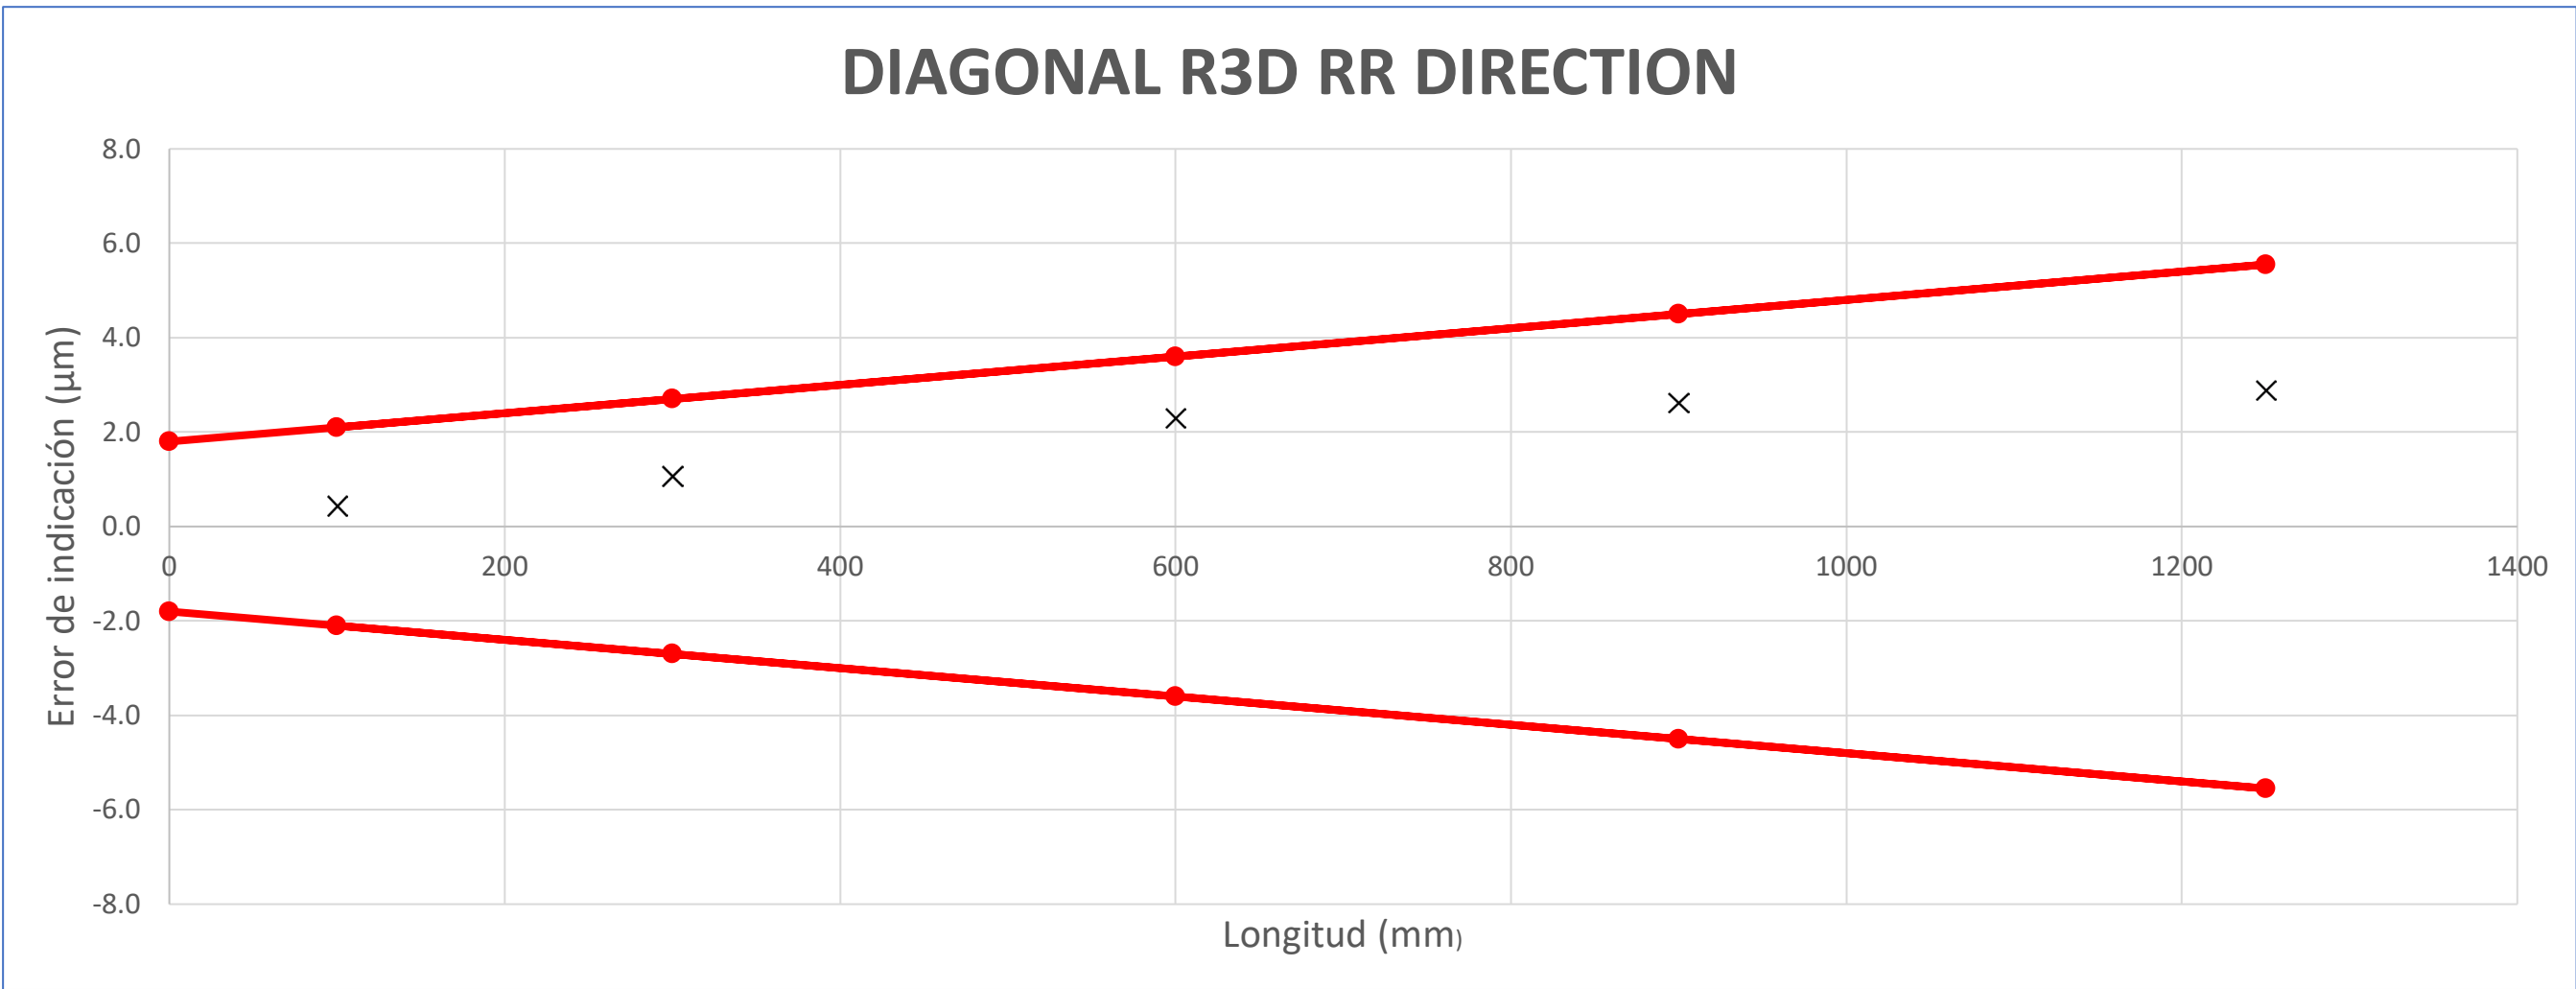

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

E150 R2D V DIRECTION


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3310	100.3309	100.3310	-0.0005	-0.0006	-0.0005	100.3310	-0.0005	0.0021	0.0001	0.0015
300.3099	300.3087	300.3087	300.3088	-0.0012	-0.0012	-0.0011	300.3087	-0.0012	0.0027	0.0001	0.0017
599.9786	599.9765	599.9768	599.9766	-0.0021	-0.0018	-0.0020	599.9766	-0.0020	0.0036	0.0003	0.0020
900.1928	900.1895	900.1895	900.1894	-0.0033	-0.0033	-0.0034	900.1895	-0.0033	0.0045	0.0001	0.0023
1250.0770	1250.0730	1250.0733	1250.0727	-0.0040	-0.0037	-0.0043	1250.0730	-0.0040	0.0056	0.0006	0.0027

* Ver última hoja de este certificado

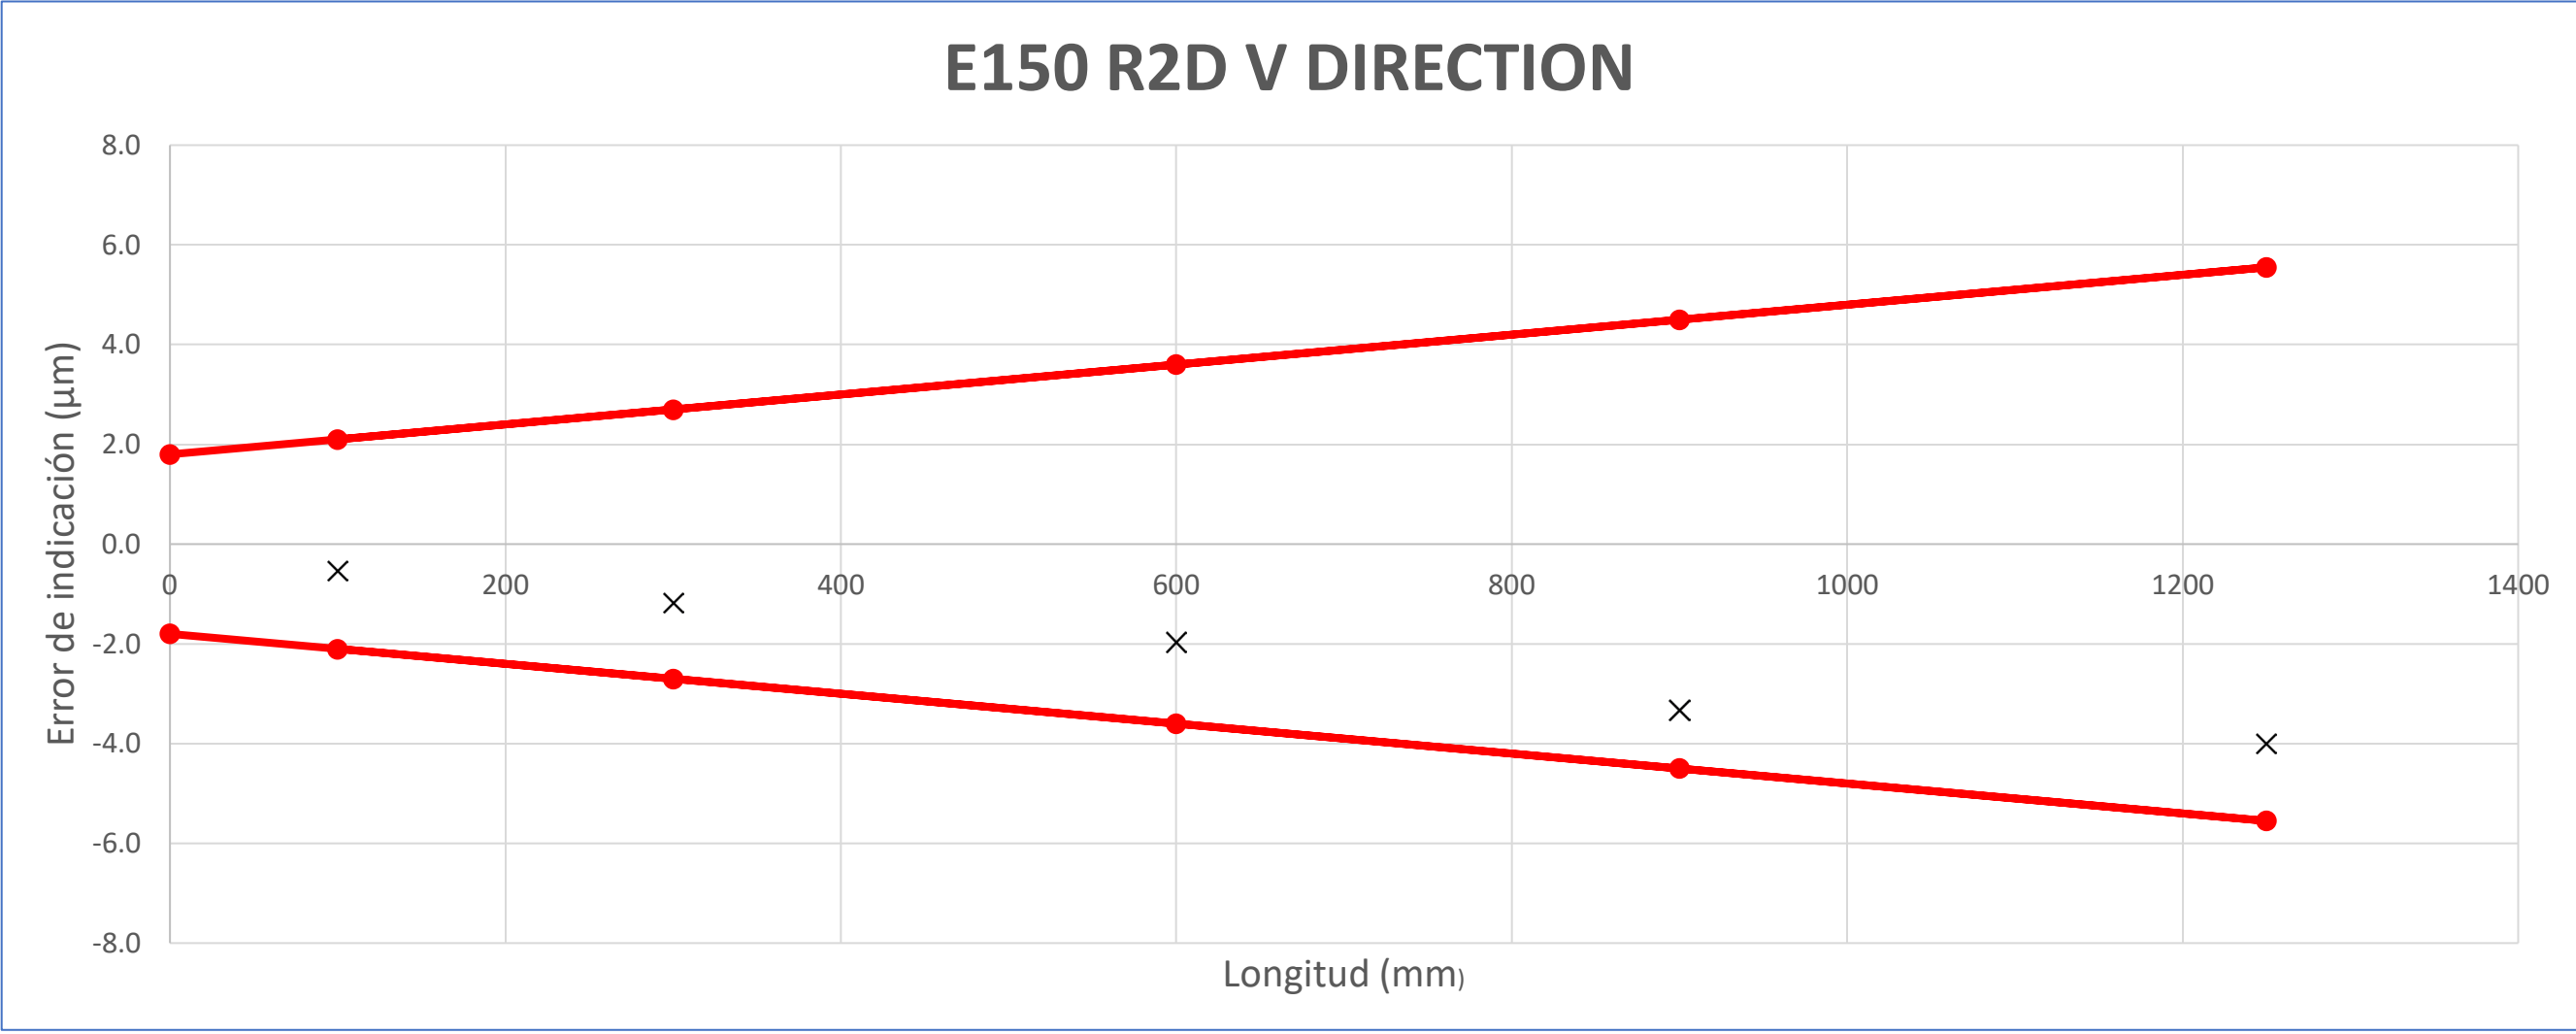

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
HUMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
HUMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm

E150 R2D H DIRECTION


Especificación del fabricante de la CMM

MPE* Pendiente (mm)	0.0030
MPE* Intersecto Y (mm)	0.0018

Las siguientes desviaciones de las longitudes fueron medidas por el palpador conforme lo establecido en la norma ISO 10360-2:2009

Valor nominal del mensurando (mm)	Lectura 1 (mm)	Lectura 2 (mm)	Lectura 3 (mm)	Error de indicación 1 (mm)	Error de indicación 2 (mm)	Error de indicación 3 (mm)	Promedio Lecturas (mm)	Promedio Error (mm)	MPE* (mm)	Valor de Repetibilidad R0 (mm)	Incertidumbre del error de indicación k=2 (mm)
100.3315	100.3312	100.3313	100.3313	-0.0003	-0.0002	-0.0002	100.3313	-0.0002	0.0021	0.0001	0.0015
300.3099	300.3091	300.3093	300.3090	-0.0008	-0.0006	-0.0009	300.3091	-0.0008	0.0027	0.0003	0.0017
599.9786	599.9768	599.9766	599.9766	-0.0018	-0.0020	-0.0020	599.9767	-0.0019	0.0036	0.0002	0.0020
900.1928	900.1897	900.1895	900.1897	-0.0031	-0.0033	-0.0031	900.1896	-0.0032	0.0045	0.0002	0.0023
1250.0770	1250.0738	1250.0743	1250.0739	-0.0032	-0.0027	-0.0031	1250.0740	-0.0030	0.0056	0.0005	0.0027

* Ver última hoja de este certificado

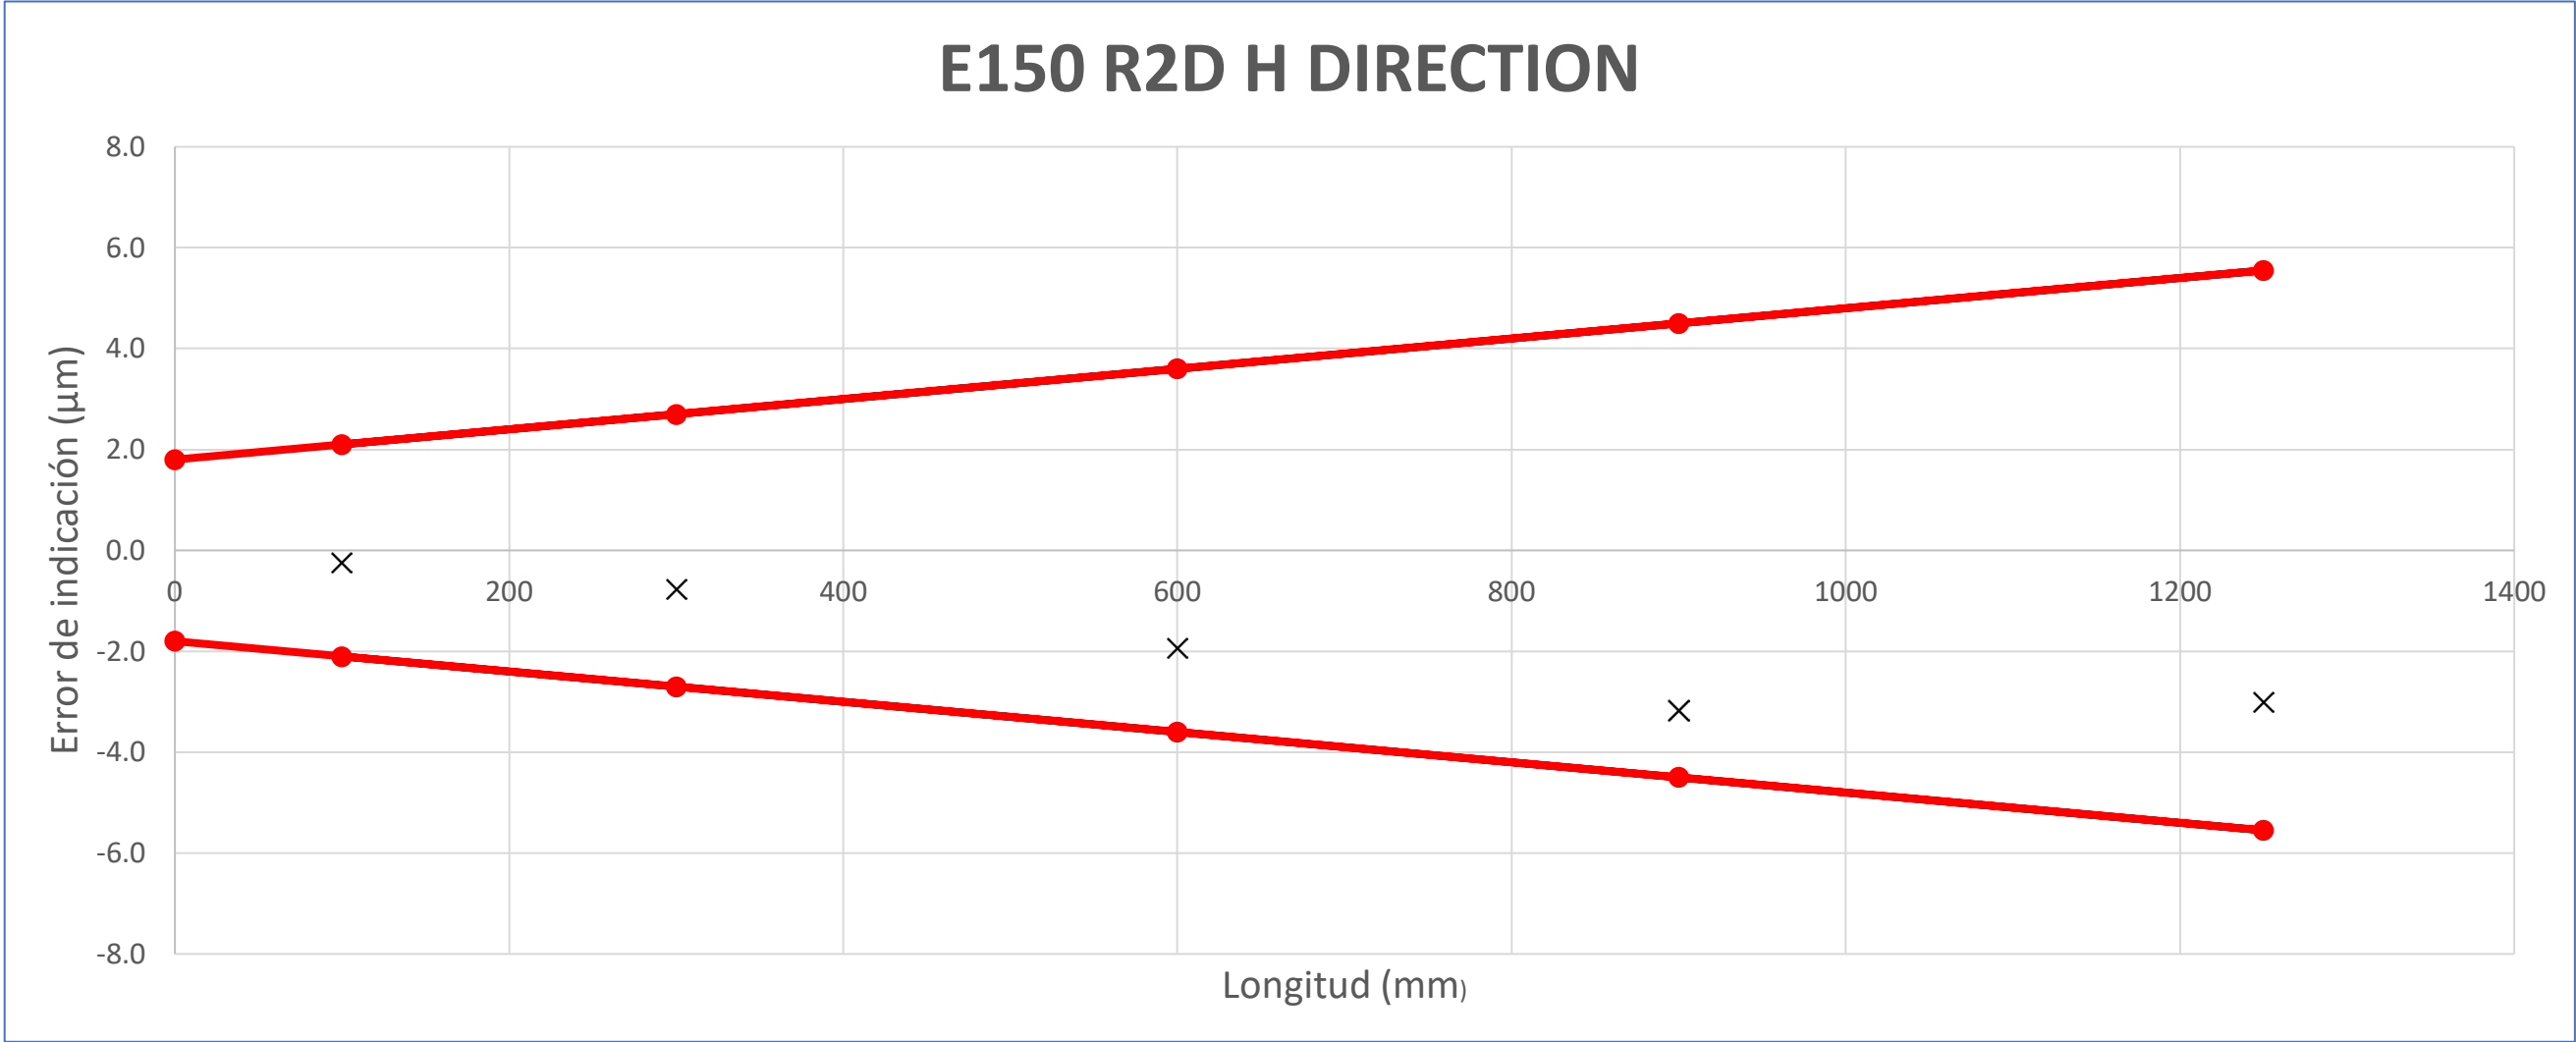

ESTA GRÁFICA MUESTRA EL PROMEDIO DEL ERROR DE LAS 5 LONGITUDES CALIBRADAS (MEDIDAS 3 VECES CADA UNA)

LAS LINEAS ROJAS REPRESENTAN EL ERROR MÁXIMO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE DE LA CMM.

TEMPERATURA INICIAL (°C)	19.1
TEMPERATURA FINAL (°C)	19.2
UMEDAD RELATIVA INICIAL (%)	34.1
UMEDAD RELATIVA FINAL (%)	32.4

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DEL ERROR DE INDICACIÓN, k=2
U= ± (0.0010L + 1.44) µm, L en mm



No. Certificado: DT-26005-CC-C1



NOTAS

ADDITIONAL NOTES

LA INCERTIDUMBRE DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO FUE CALCULADA DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-CH-140-IMNC-2002 GUÍA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES. SE REPORTA LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA CON UN FACTOR DE COBERTURA $k = 2$ PARA UN INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95.45% ($\pm 2s$).

THE UNCERTAINTY OF MEASUREMENT WAS CALCULATED ACCORDING TO THE STANDARD NMX-CH-140-IMNC-2002 GUIDE FOR THE EXPRESSION OF UNCERTAINTY IN MEASUREMENTS.

EXPANDED UNCERTAINTY IS REPORTED WITH A COVERAGE FACTOR $k = 2$ FOR A CONFIDENCE INTERVAL OF 95.45% ($\pm 2s$).

SI EL VALOR MEDIDO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESPECIFICACIÓN Y AL SUMARLE LA INCERTIDUMBRE EXPANDIDA EL VALOR COMBINADO ESTUVIERA FUERA, SE CONSIDERA COMO NO CUMPLE. SI AL SUMARLE LA INCERTIDUMBRE ESTÁ TODO DENTRO DEL ÁREA DE ACEPTACIÓN, SE CONSIDERA COMO CUMPLE.

IF THE MEASUREMENT IS CLOSE TO THE SPECIFICATION AND ADDING THE UNCERTAINTY, THE COMBINED VALUE WAS OUT, IT IS CONSIDERED NON-COMPLIANT.

RESULT WITH THE UNCERTAINTY ADDED IS ALL WITHIN THE ACCEPTANCE AREA, THEN IT IS CONSIDERED AS COMPLIANT.

ESTE INFORME SÓLO AMPARA LOS RESULTADOS REPORTADOS CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CARACTERÍSTICAS PRESENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN.

THIS REPORT ONLY COVERS THE REPORTED RESULTS WITH THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND THE CHARACTERISTICS AT THE TIME THE MEASUREMENT WAS MADE.

EL LABORATORIO ES RESPONSABLE DE LOS RESULTADOS EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CLIENTE.

THE LABORATORY IS RESPONSIBLE FOR THE RESULTS ACCORDING TO THE INFORMATION PRESENTED BY THE CLIENT.

EL USO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE DEJA A CRITERIO DEL USUARIO.

THE USE OF THE OBTAINED RESULTS ARE LEFT TO THE USER'S DISCRETION.

NO SE REALIZARON ADICIONES, DESVIACIONES O EXCLUSIONES DEL MÉTODO UTILIZADO.

NO ADDITIONS, DEVIATIONS OR EXCLUSIONS WERE MADE OF THE USED METHOD.

SE ADJUNTA A ESTE INFORME LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, CUANDO APLIQUE.

THE INFORMATION PROVIDED BY THE CUSTOMER, WHEN APPLICABLE, IS ATTACHED TO THIS REPORT.

EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

THE CUSTOMER IS RESPONSIBLE OF PROVIDING PROPER AMBIENTAL CONDITION IN ACCORDANCE TO MANUFACTURER SPECIFICATIONS.

EL PRESENTE CERTIFICADO CORRESPONDE A UNA VERIFICACIÓN INTERMEDIA DEL EQUIPO.

THIS CERTIFICATE CORRESPONDS TO AN INTERMEDIATE VERIFICATION OF THE EQUIPMENT.

GLOSARIO

GLOSSARY

MPE: MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR

PSTU: SINGLE-STYLUS SIZE ERROR (PROBING SIZE TACTILE UNIQUE STYLUS ERROR)

PFTU: SINGLE-STYLUS FORM ERROR (PROBING FORM TACTILE UNIQUE STYLUS ERROR)

PSTE: MULTI-STYLUS SIZE ERROR (PROBING SIZE TACTILE ERROR WITH AN EMPIRICAL QUALIFICATION OF THE ARTICULATING-BASED MULTI-STYLUS PROBING SYSTEM)

PFTE: MULTI-STYLUS FORM ERROR (PROBING FORM TACTILE ERROR WITH AN EMPIRICAL QUALIFICATION OF THE ARTICULATING-BASED MULTI-STYLUS PROBING SYSTEM)

PLTE: MULTI-STYLUS LOCATION VALUE (PROBING LOCATION TACTILE ERROR WITH AN EMPIRICAL QUALIFICATION OF THE ARTICULATING-BASED MULTI-STYLUS PROBING SYSTEM)

DT TECHNIQUES, S.A. DE C.V. Jesús Nuncio # 303, González Cepeda, Saltillo, Coahuila, México, C.P. 25030

Este documento ha sido emitido por DT Techniques S.A. de C.V., acreditado por ema, a.c. (Entidad Mexicana de Acreditación, a.c.), organismo signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la Cooperación Asia-Pacífico para la Acreditación de Laboratorios (APLAC). El(los) resultado(s) de la calibración declarado(s) en este certificado de calibración puede(n) ser aceptado(s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.

This document has been issued by DT Techniques, S.A. de C.V., accredited by ema, a.c. (Entidad Mexicana de Acreditación, a.c.), which is a signatory to the Mutual Recognition Arrangement (MRA) of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and the Asia Pacific Cooperation for Laboratory Accreditation (APLAC). The calibration result (s) declared in this calibration certificate may be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa de DT Techniques S.A. de C.V.

The total or partial reproduction of this document is prohibited without express authorization of DT Techniques S.A. de C.V.