


Лабораторная работа №3

Разработать приложение, на вход которого подается файл .wav, и выводится информация с заголовочной части файла (header), и строится нормированная гистограмма по следующим частотам: 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 500 Гц, 1КГц, 2к КГц, 5к КГц, 10к КГц, 20 КГц для интервала 1с. Также у пользователя есть возможность перемещаться по времени файла, то есть при нажатии определенных клавиш, идет смещение, и показывается нормированная гистограмма на 20 секунде, например.

Для дальнейшего использования лабораторной работы необходимо сделать так, чтобы запуск осуществлялся следующей командой (имя файла является аргументом командной строки):

CMD: <имя программы>.exe <имя файла>.wav

Пример гистограммы:

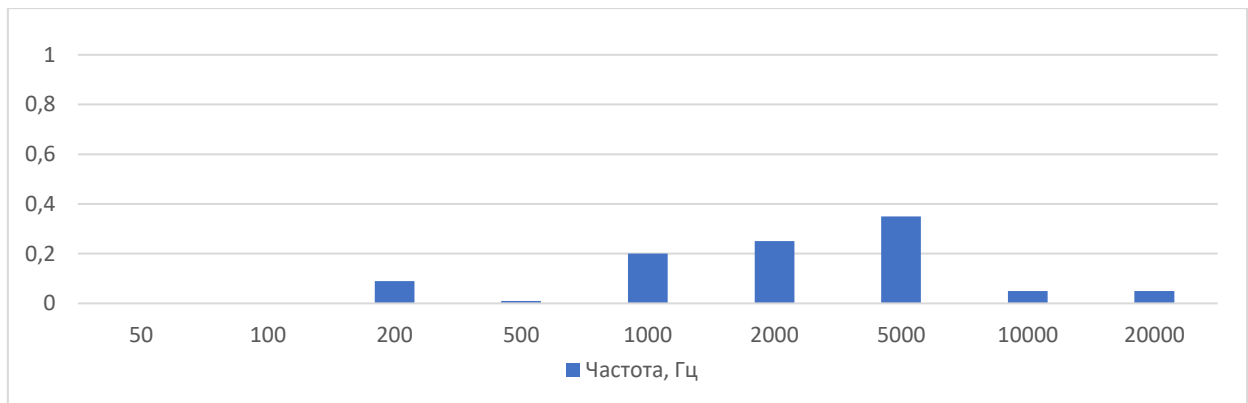

Все приложение должно быть CUI (console user interface)! Не допускается использование библиотек для создания GUI.