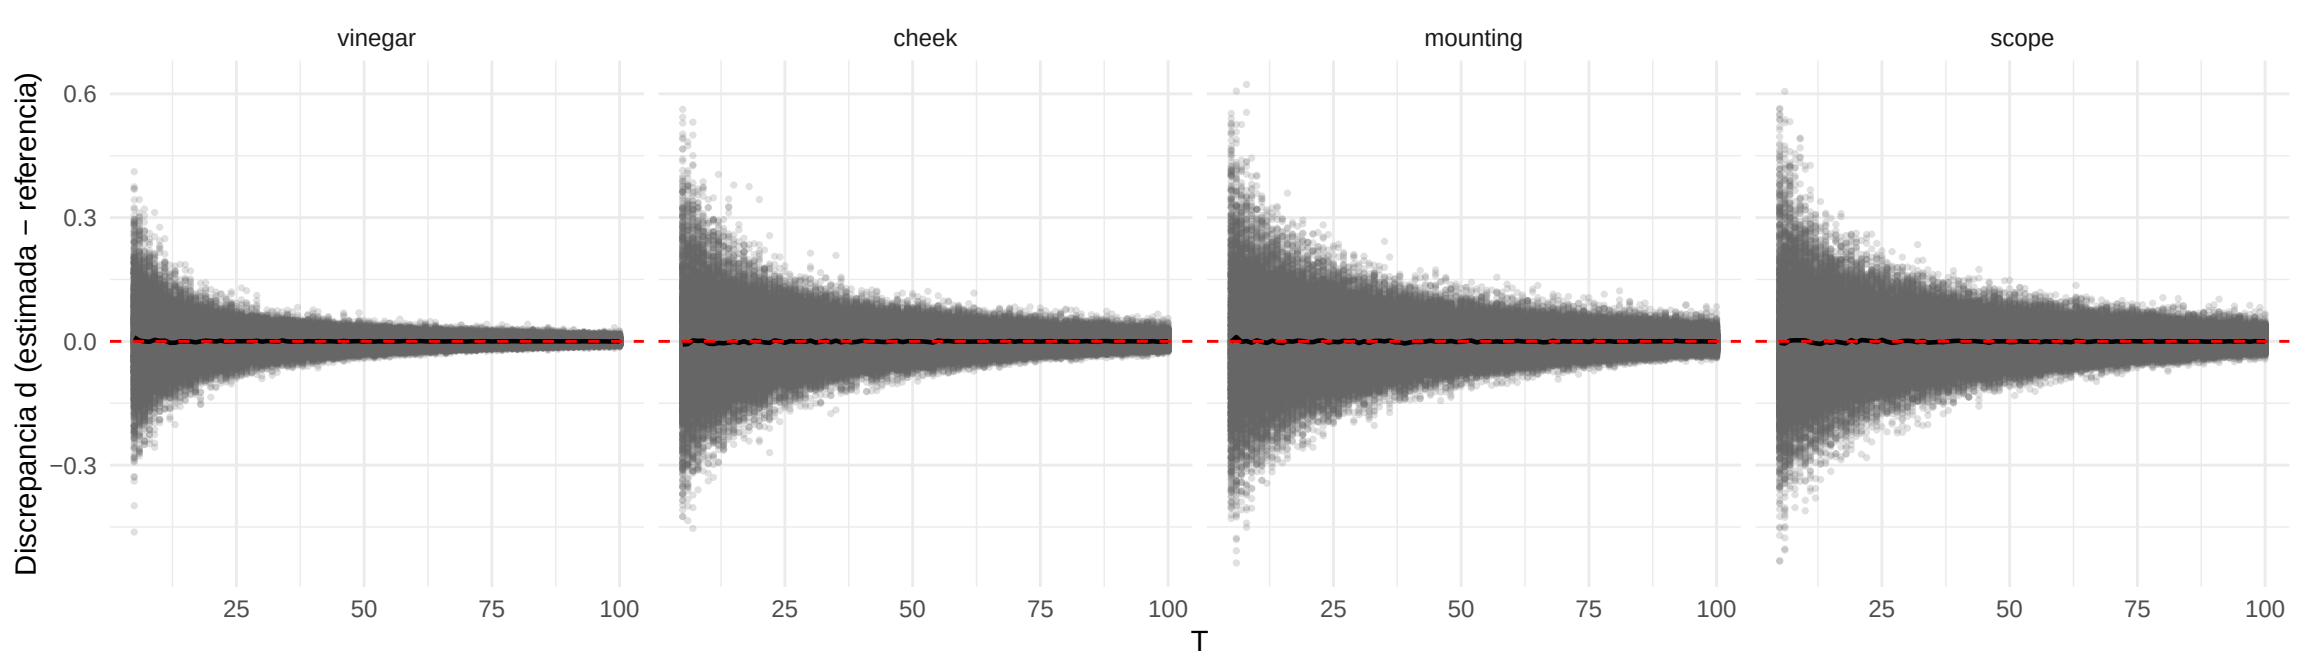

vinegar
cheek
mounting
scope
Discrepancia d (estimada − referencia)
0.6
0.3
0.0
−0.3
25
50
75
100
T