



1) 定义 DEFINE: 问题定义

问题描述:

问题是什么	自动密封试验机 BP83510 未建立或实施针对压力准确性的周期性确认或校准要求。该设备自 2021/03/18 完成压力进行准确性测试（Ref: EV21250 Rev01）后，未再对该项目进行周期性确认或校准。
与谁相关	与生产运营和验证相关
为何要解决这个问题	不符合医疗器械生产质量管理规范第四章 设备管理要求和 ISO13485:2016 EN ISO 13485:2016+A11:2021 GB/T 42061-2022: 6.3, 7.6
发生的时间	2025.10.13
在哪发生	ABON 内审（国内专项）
发生的频次和数量	1
产品受到的影响	没有产品收到影响
目标是什么	建立设备参数周期性确认的制度

团队成员：冯涛、黄康、杨淑琴、邵玢钢、



2) 测量 MEASURE: 当前状态

当前状态的实际情况是什么样的？

自动密封试验机 BP83510 未建立或实施针对压力准确性的周期性确认或校准要求

是否重发？如果是，请详细描述

是, 6 台同类型自动密封试验机也未参数准确性确认

哪些历史数据是可用的？

设备清单

数据告诉我们哪些信息？

需要现有的 269 台实验室设备和 1075 台非实验室设备的参数进行回顾和评估，输出需要进行周期性确认的参数和执行计划

附加信息



3) 分析 ANALYSE: 根本原因分析 (5WHY)

Why1	为什么自动密封试验机 BP83510 无《实验室仪器（设备）参数评估表》
	QSC-M27-JL-02 《实验室仪器（设备）参数评估表》（版本：AA，生效日期：2023/12/29）依据 QSB-A00《文件控制程序》（版本：AP，有效期：2023/12/20至 2024/ 03/20）在 Agile 系统创建 CO-10150151 流程进行审批并生效第一版，且在执行计划中制定了对现有设备的参数评估行动项，但实际未执行。
Why2	为什么制定了行动项，但实际并未执行？
	因为仅在 CO-10150151 的执行计划中描述行动项，而 CO-10150151 审批完成后 QA 依据 QSB-A00《文件控制程序》（版本：AP）章节 8 对文件进行生效，文件正式实施 CO 流程结束，但是没有制定其他流程有效跟进措施，导致该计划未完成。
Why3	为什么没有制定其他流程有效跟进措施？
	QSB-A00《文件控制程序》（版本：AP） 章节 6.1.6 中仅明确评估是否涉及相关文件的更改要求，未明确行动项执行具体要求，导致实际未创建流程跟踪，即文件新增或变更时对需要跟进的措施无明确跟踪要求。
Why4	
Why5	

Why1	/
	/
Why2	/
	/
Why3	/
	/
Why4	/
	/
Why5	/
	/

根本原因:

保留文件新增或变更要求时对需要跟进的措施缺乏明确跟踪要求为根本原因，保留现有设备管理文件中未明确如何有效管理和跟踪这些需要周期性确认参数的管理模式为间接原因。



4) 改进 IMPROVE: 目标状况&行动

那些行动方案可以改进或防止此类问题发生

行动计划	负责人	计划完成日期	实际完成日期
对工厂内部 6 台同类型自动密封试验机进行参数准确性确认（包含压力和时间参数），确认参数均符合准确度要求	黄康	2025-11-14	2025-11-14
对工厂内现有 1344 台设备参数进行评估，并通过 CAPAAC-00022154 跟踪完成。	黄康	2026-04-20	2026-04-20
回顾过往 2 年所有文件新增和变更流程，识别是否存在未落实的执行计划，并制定相应改进措施计划。	朱洁娜	2026-04-15	2026-04-15
据 CAPA-00007228_Investigation_Appendix5_Lab_Equipment_list 和 CAPA-00007228_Investigation_Appendix6_Non-Lab_Equipment_list，回顾工厂现有设备的参数，确认是否具备对应评估表；如缺失，执行评估并建立周期性确认计划。	黄康	2026-04-20	2026-04-20
N/A	N/A	N/A	N/A




5) 控制 CONTROL: 绩效监控

您将如何获悉改善是有效的，需要长期吗？考虑“新”过程将如何被测量/监控。确保有足够的时间来准确地监控您的改进的有效性。



3) 分析 ANALYSE：根本原因分析（鱼骨图）

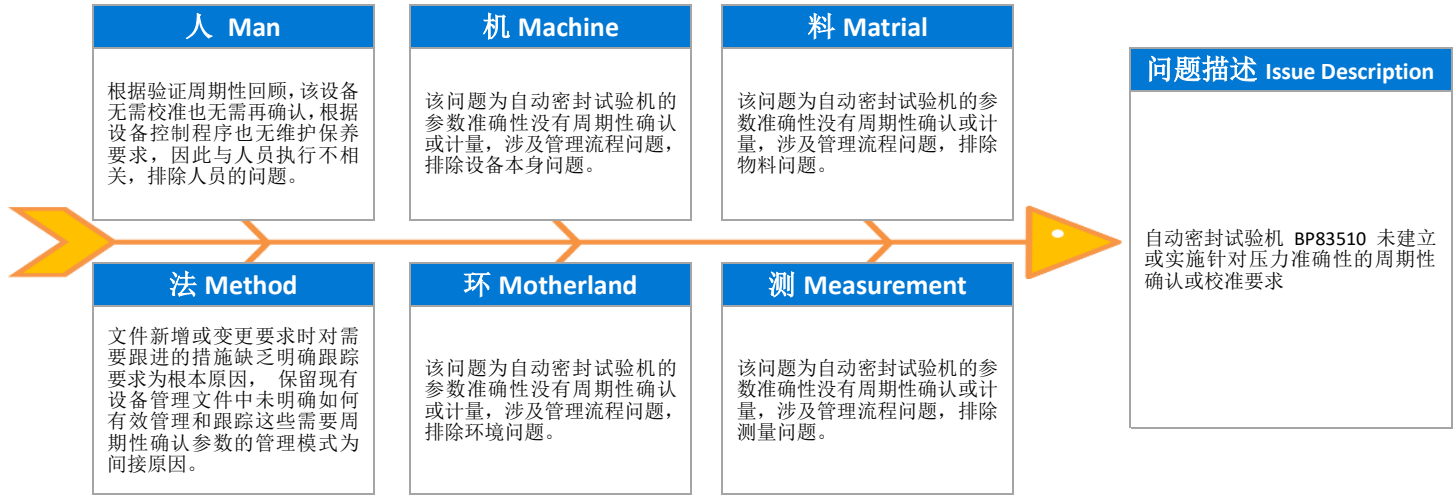

衡量指标	改善前指标	改善后指标	监控持续时间	节约/改善
设备参数准确性确认	生产设备和实验室设备没有进行周期管理	生产设备和实验室设备都纳入 maximo 系统管理，定期自动发起任务	2026-02-25 ↓ 2026-04-25	生产设备和实验室设备都纳入 maximo 系统管理，当前参数准确性确认都在有效期内。
				收益(RMB):

是否可以复制到相似的区域或流程中？有什么经验收获？

☒是

其他涉及周期性监控的流程都可以自产是否存在可改进的地方，如验证周期评审，测量仪器校验管理