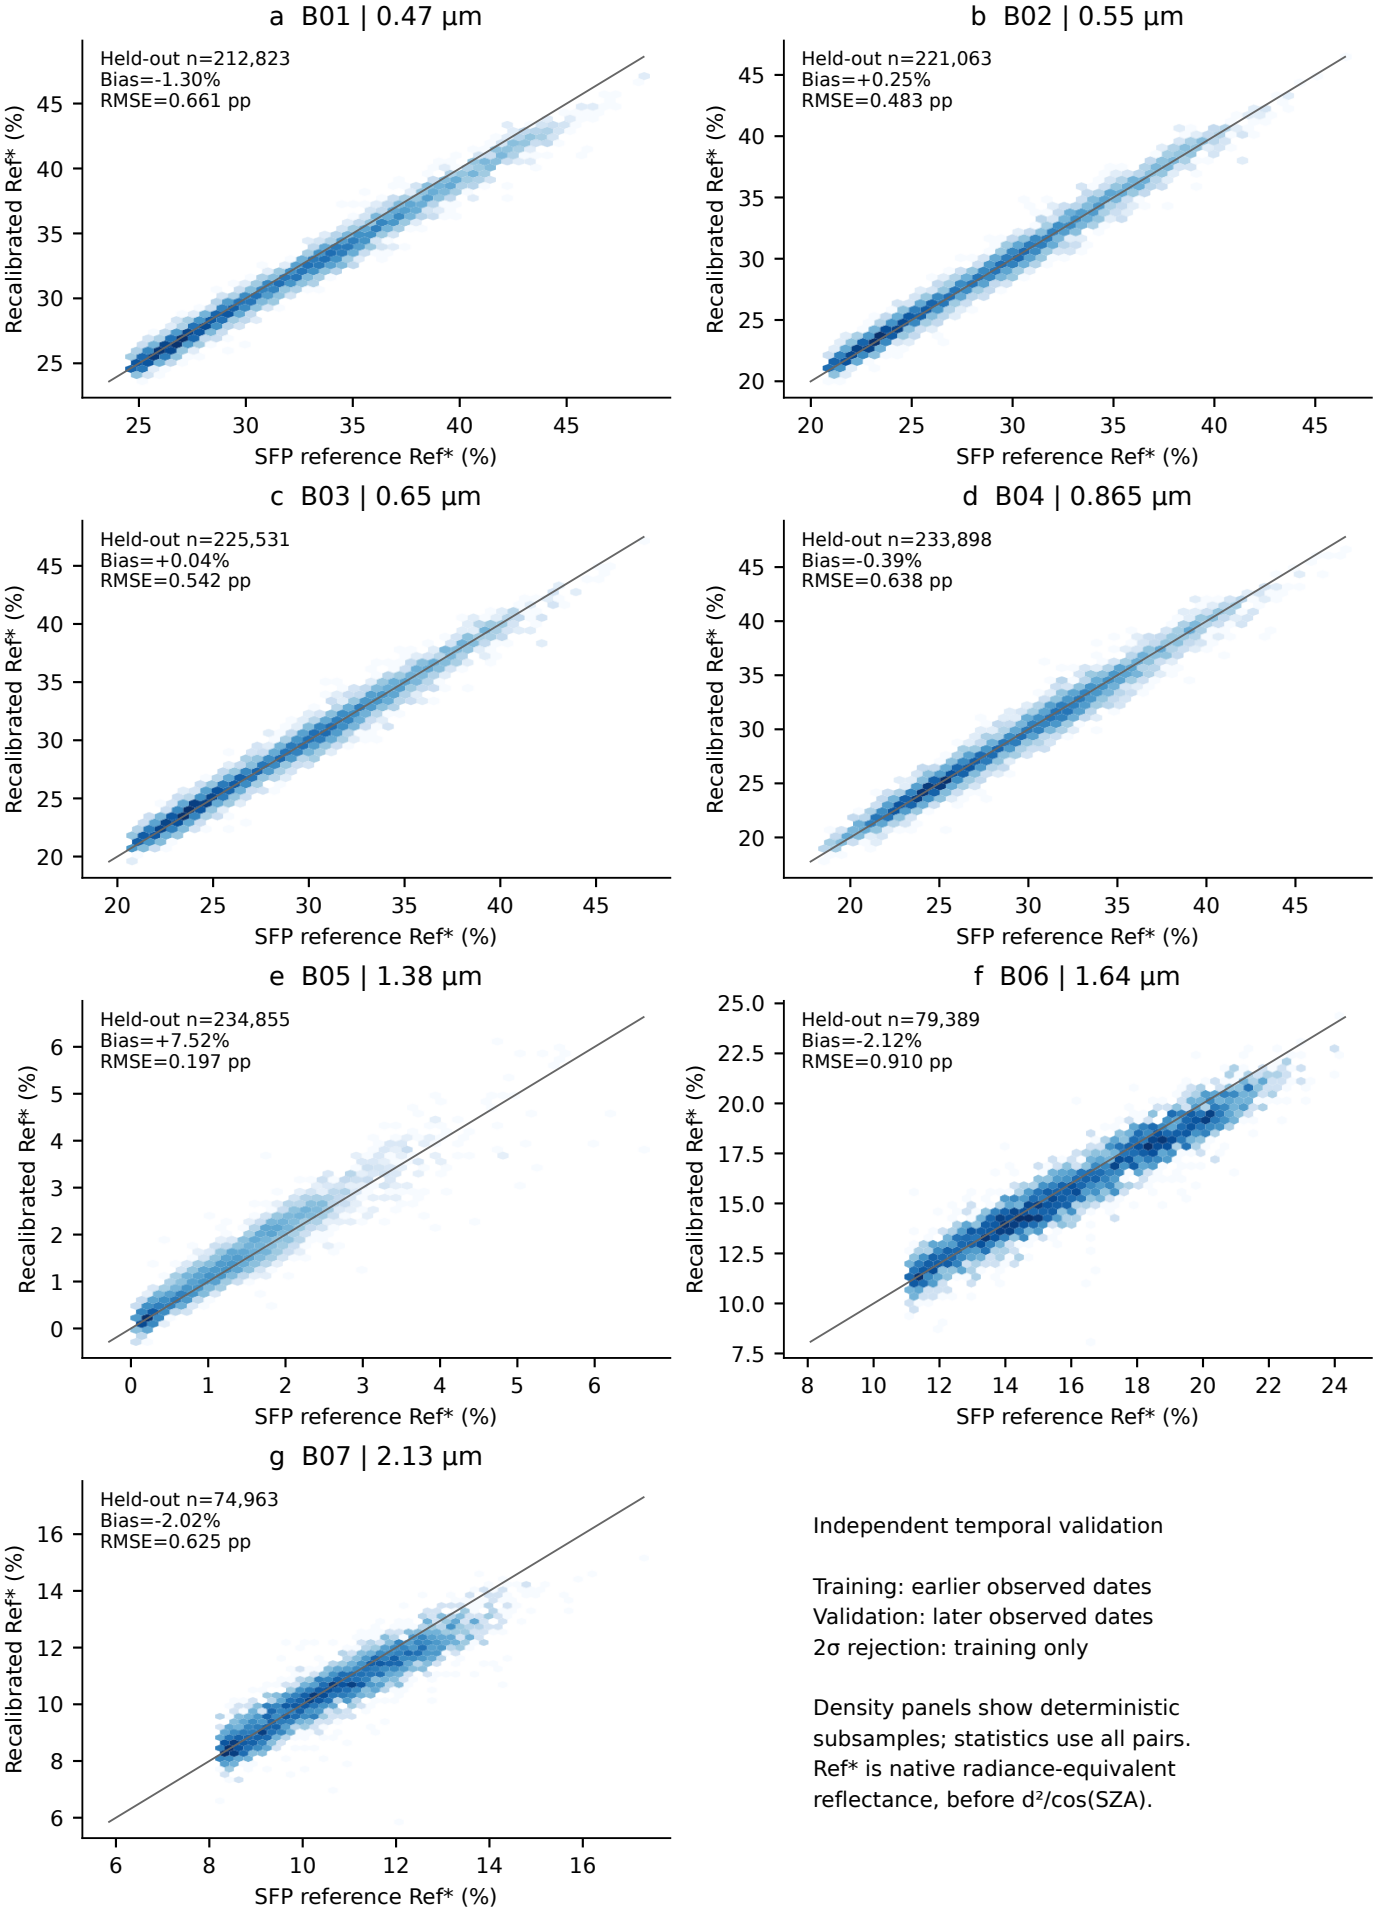

a B01 | 0.47 µm
Held-out n=212,823
Bias=-1.30%
RMSE=0.661 pp
b B02 | 0.55 µm
Held-out n=221,063
Bias=+0.25%
RMSE=0.483 pp
c B03 | 0.65 µm
Held-out n=225,531
Bias=+0.04%
RMSE=0.542 pp
d B04 | 0.865 µm
Held-out n=233,898
Bias=-0.39%
RMSE=0.638 pp
e B05 | 1.38 µm
Held-out n=234,855
Bias=+7.52%
RMSE=0.197 pp
f B06 | 1.64 µm
Held-out n=79,389
Bias=-2.12%
RMSE=0.910 pp
g B07 | 2.13 µm
Held-out n=74,963
Bias=-2.02%
RMSE=0.625 pp
Recalibrated Ref* (%)
SFP reference Ref* (%)
Independent temporal validation
Training: earlier observed dates
Validation: later observed dates
2σ rejection: training only
Density panels show deterministic subsamples; statistics use all pairs.
Ref* is native radiance-equivalent reflectance, before d²/cos(SZA).