


**Confusion matrix — kalibrovaný model záchytu FiS
(testovací sada, n = 377, práh = 0.041 — Youdenovo optimum)**

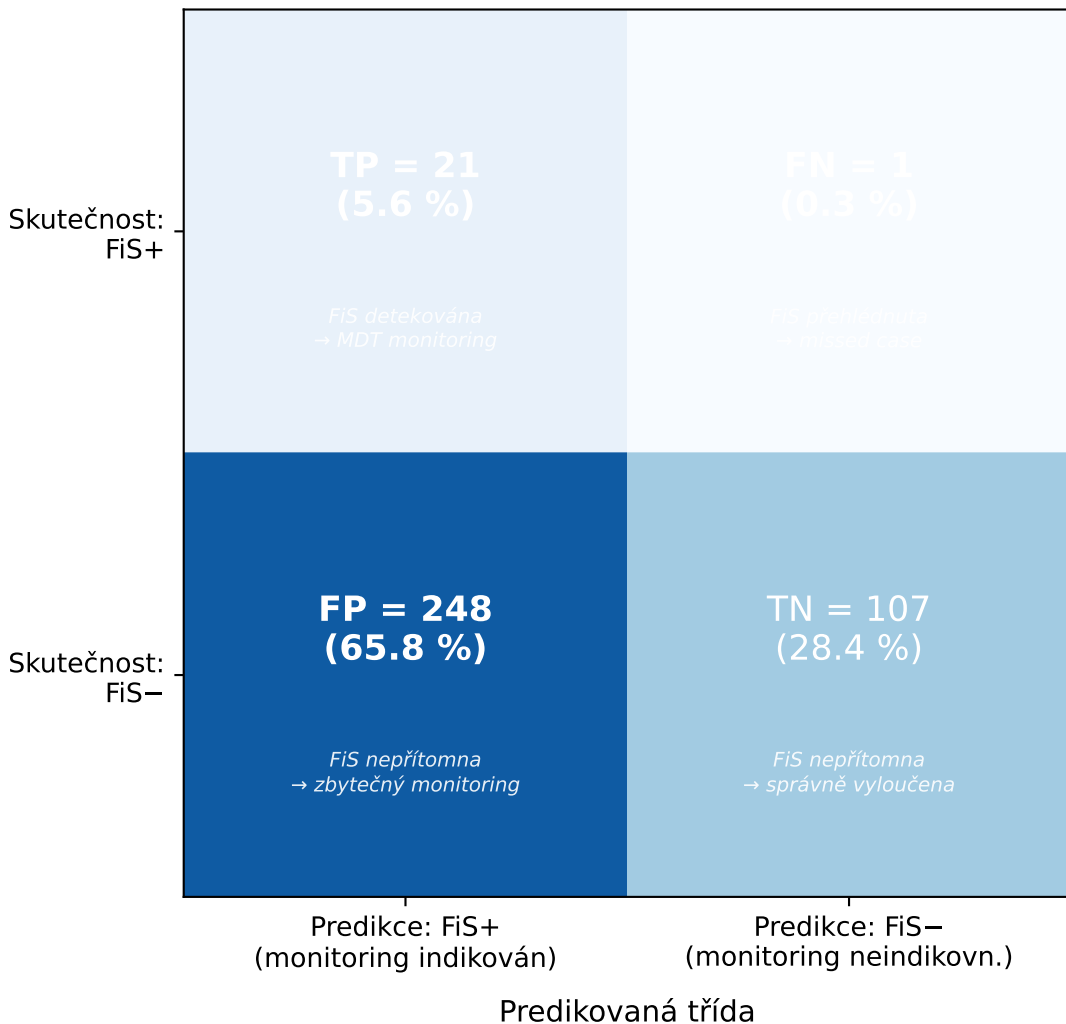

TP = 21 — správně detekovaná FiS	FP = 248 — zbytečný monitoring
TN = 107 — správně vyloučená FiS	FN = 1 — přehlédnutá FiS

Senzitivita = 95.5 % Specificita = 30.1 % PPV = 7.8 % NPV = 99.1 %