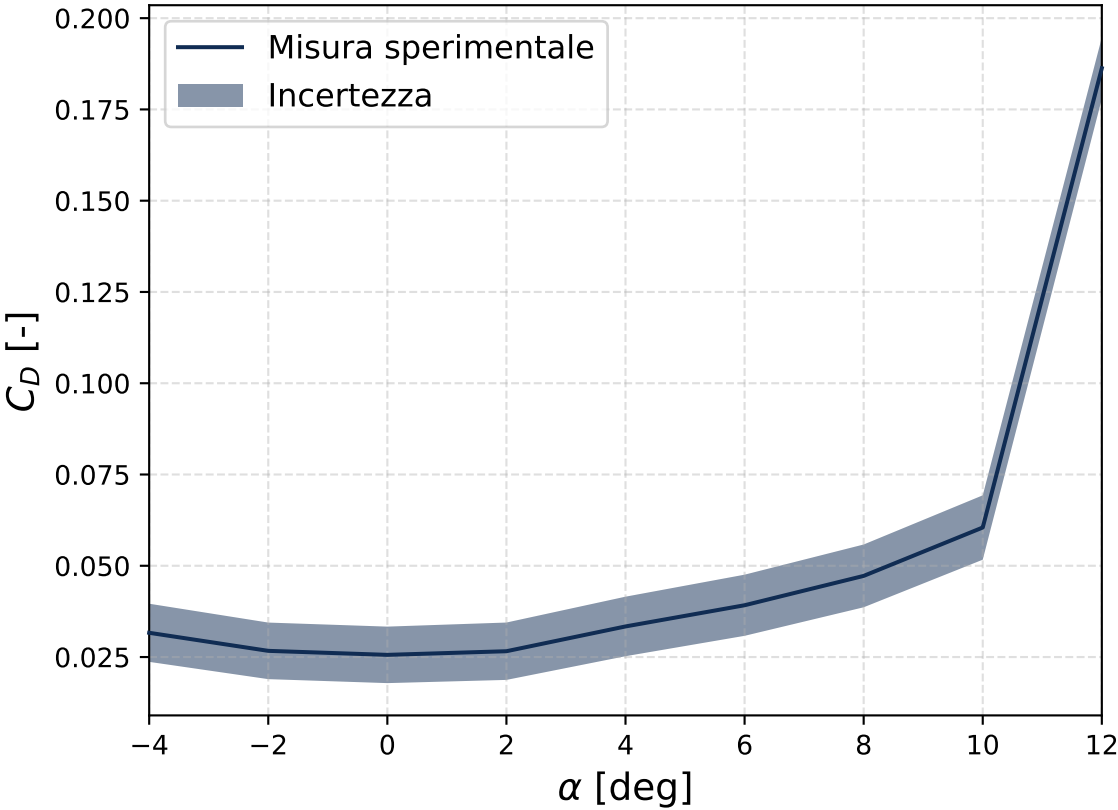
Misura sperimentale
Incertezza
C_D [-]
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
−4
−2
0
2
4
6
8
10
12
α [deg]