โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
KASEMRAD HOSPITAL
RATTANATHIBETH

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

58 หมู่ 15 ถ. รัตนาธิเบศร์ ต. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9213400-9 Fax.029213400 ต่อ 1119

58 Moo. 15 Ratanathibeth Rd., Bangrakpatana, Bangbuathong, Nonthaburi. 11110 Tel: 02-9213400-9 Fax.029213400 Ext.1119

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เลขที่รับ ๑๑๗๑๖
ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่ อ.376/2567

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เลขที่รับ 4209
วันที่ 18 มิย 67
เวลา

เรื่อง แจ้งกำหนดการออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพบริษัท

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่แนบมาด้วย สพ. 7, สพ. 19, ใบประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลป์, บัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ออกหน่วย เอกสารแบบแจ้ง สพ.อ ๔

เนื่องจาก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ มีความประสงค์จะขออนุญาตจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ บ.ปูนซีเมนต์ แก่งคอย ขอนแก่น ตามใบสั่งจ้างของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่	ชื่อบริษัท	ที่อยู่	เวลาตรวจ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567	บ.ปูนซีเมนต์ แก่งคอย ขอนแก่น	เลขที่ 357 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	เวลา 07.00-16.00 น.

ออกตรวจโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลป์ เป็นผู้ให้บริการ (ตามเอกสาร แนบ สพ.อ ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ
มอบ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
- ด้วย รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ขอนำรถเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ บริษัท วันที่ 27 มิ.ย. 67
- มอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดำเนินการต่อไป
เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวีรวรรณ รุจิจนากุล)
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH

(นายแพทย์ยอร์น จิระนคร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

(นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
21 มิ.ย. 2567

แบบแจ้ง สพ.อ. ๔

เลขรับที่ E714/2567
วันที่ 19/06/67
ลงชื่อ ..... ผู้รับคำขอ

แบบแจ้งสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่ออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม การป้องกันโรค หรือการรักษาพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียนหรือนักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น

เขียนที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โดย นาย/นาง/นางสาว นายแพทย์ยอร์น จิระนคร

อายุ 57 ปี สัญชาติ ไทย อยู่เลขที่ 2/1 ซอย - ตรอก -
ถนน สฤษดิ์ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง สะพานรัง อำเภอ/เขต เมืองปัตตานี
จังหวัด ปัตตานี โทรศัพท์ 02-594-0020-65 ต่อ 1938

ขอแจ้งวัน เวลา สถานที่และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการสำหรับสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ชื่อโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ประเภท รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ เลขที่ ..... ที่ใช้ยานพาหนะ เป็นที่ให้บริการและออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการตรวจดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล การส่งเสริมหรือการป้องกันโรคแก่พนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น ดังนี้

(๑) วัน เวลาในการออกให้บริการ ระหว่าง..... ถึงวันที่ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 07.00-16.00
(๒) สถานที่ในการออกให้บริการ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ แก่งคอย ขอนแก่น
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที่ออกไปให้บริการ ที่อยู่ 357 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

๓.๒ วิชาชีพเวชกรรม 1 คน ได้แก่
(๑) พญ.ปิยดา ธรรมปาโล ว.35330
(๒).....

๓.๒ วิชาชีพอื่นๆ 1 คน ได้แก่
(๑) น.ส.ปาริชาติ ประทีศ ทน.17405
(๒).....

๓.๓ ผู้ประกอบโรคศิลปะ 1 คน ได้แก่
(๑) ~~นางปวริสา กิติศรัทธานนท์ รส.1050~~ น.ส. ดวงใจ วรรณโอชน์ ร.ส. 910
(๒).....

* หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้นำใบที่แจ้งมาแสดงและแจ้งการเปลี่ยนแปลงในวันที่ออกให้บริการด้วย

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้ยื่นคำขอ
(นายแพทย์ยอร์น จิระนคร)
ผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานนั้น/
ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการ

(ลายมือชื่อ) ..... ผู้รับแจ้ง
((นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล))
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อนุญาต
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ใบอนุญาตที่ ๓๕๓๓๐

ปิยดา ธรรมปาโล

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

สำหรับ สาขาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตนี้แก่

นางสาวปิยดา ธรรมปาโล อายุ ๓๒ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

นายกแพทยสภา

เลขาธิการแพทยสภา

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สนท.๒๒

ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑/..

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ใบอนุญาตที่ ท.น.๑๗๔๐๕

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗

สภาเทคนิคการแพทย์

ออกใบอนุญาตนี้ให้แก่

นางสาว ปาริชาติ ประทิศ อายุ ๒๙ ปี

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
และข้อบังคับของสภาเทคนิคการแพทย์

ออกให้ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
หมดอายุ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๗๑

(นางสมจิตร์ จินาภักดิ์)
เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์

(นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์)
นายกสภาเทคนิคการแพทย์

บริษัท บางกอก เชน สยมบิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 6097 00057 94 1
ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ดวงใจ วรรณโภชน์
Name Miss Duangjai
Last name Wannaphot
เกิดวันที่ 13 เม.ย. 2505
Date of Birth 13 Apr. 1962
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 36 ซ.มาลัย 1 ต.ลาดสี อ.ลาดสี
จ.นครสวรรค์
5 ต.ค. 2561 วันออกบัตร 5 Oct. 2018 Date of Issue
(นายสุพจน์ ไชยพูลโสภณ) เจ้าพนักงานออกบัตร
12 เม.ย. 2570 วันบัตรหมดอายุ 12 Apr. 2027 Date of Expiry
0004-03-19980800

ใบสำเนาใช้ออกใบประกอบวิชาชีพ เท่านั้น

ใบอนุญาตที่ ร.ส.๔๑๐

ภายใต้อำนาจตามความในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

คณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

ออกใบอนุญาตฉบับนี้แก่

นางสาว ดวงใจ วรรณโภชน์ อายุ ๔๓ ปี

ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพได้จับขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
และมีสิทธิประกอบโรคศิลปะตามสาขา ดังกล่าวได้ ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมาย

ใบอนุญาตออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายแพทย์ [illegible])
กรรมการและเลขานุการ

(นาย[illegible]ชาการ)
ประธานกรรมการวิชาชีพ

ใบอนุญาตเลขที่/License No.
RSO-ML-5223-000030/2
เลขประจำตัวประชาชน/ID No.
3-6097-00057-94-1

วันที่ออกใบอนุญาต: 1 ต.ค. 2562
Date of Issue: 1 Oct. 2019
วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ: 30 ก.ย. 2567
Date of Expiry: 30 Sep. 2024

ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
Radiation Safety Officer License
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
This license is given to
นางสาวดวงใจ วรรณโภชน์
Miss Duangjai Wannaphot
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
Has successfully qualified to be a Radiation Safety Officer
ระดับกลาง (วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี)
Intermediate Level (Radioactive Sources and Radiation Generators)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ๋อย)
(Miss Vilaivan Tanjoy)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
Secretary General

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ พ.บ.ธ.ฉ.ศ.-๒

รหัสหน่วยงาน GX 35-131

ใบอนุญาตเลขที่ 4XM0794/62RF

ใบอนุญาต

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์)

โดย นางสาวหรสุดา หาญพาณิชย์ กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท อายุ - ปี สัญชาติ -

ที่อยู่ เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

สถานที่ทำการ บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด

เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน การแพทย์

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 27-14-62 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

จำนวน 13 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เลขที่ 4XM0794/62RF จำนวน 2 หน้า

สถานที่ติดตั้งใช้งาน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส.4ค-2 เลขที่ 4XM0794/62RF

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด (โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์)

ชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี

รายที่ 1 นางสาวภูริชญา ครุฑธาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 09-5405-0123

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี

รายการ	ประเภท	สถานะ	ชนิด	แบบ	กลุ่ม	ผู้ผลิต	หมายเลขรุ่น	หมายเลขเครื่อง	กำลังสูงสุด	การใช้ประโยชน์
1	Medical	ครอบครอง/ใช้	Intra Oral Dental Radiography	Fixed	2	J.MORITA	MAX-F	H3004	60 kV 10 mA	วินิจฉัยโรคฟัน
2	Medical	ครอบครอง/ใช้	Mobile Radiography	Mobile	2	SHIMADZU	MobileArt eco	0462P84202	125 kV 100 mAs	วินิจฉัยโรคทั่วไป
3	Medical	ครอบครอง/ใช้	Panoramic Dental Radiography	Fixed	2	SIRONA	Orthophos 3	14357	80 kV 11 mA	วินิจฉัยโรคฟัน
4	Medical	ครอบครอง/ใช้	Stationary Radiography & Fluoroscopy	Stationary	2	TOSHIBA	KXO-15E	C 1573314	150 kV 640 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
5	Medical	ครอบครอง/ใช้	Stationary Radiography & Fluoroscopy	Stationary	2	TOSHIBA	KXO-80XP	L4A13X2288	150 kV 640 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
6	Medical	ครอบครอง/ใช้	Radiographic Bus	Fixed	2	TOSHIBA	KXO-25SC	VKB1252091	125 kV 320 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
7	Medical	ครอบครอง/ใช้	Mammography	Fixed	2	HOLOGIC	LORAD Selenia	28403137701W	39 kV 400 mAs	วินิจฉัยเต้านม
8	Medical	ครอบครอง/ใช้	Mobile Radiography & Fluoroscopy (C-arm)	Mobile	2	G.E.	OEC 7900	79-S10285	110 kV 20 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
9	Medical	ครอบครอง/ใช้	Computerized Tomography	Fixed	2	PHILIPS	Brilliance iCT	85049	140 kV 1000 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
10	Medical	ครอบครอง/ใช้	Cardiac Catheterization Equipment (Bi-plane)	Stationary	2	PHILIPS	Allura Xper FD20/10	106	125 kV 1000 mA	ตรวจระบบเส้นเลือดหัวใจ
11	Medical	ครอบครอง/ใช้	Mobile Radiography	Mobile	2	SHIMADZU	Mobile DaRt Evolution	MPE09C15B001	133 kV 320 mAs	วินิจฉัยโรคทั่วไป
12	Medical	ครอบครอง/ใช้	Bone Mineral Densitometry	Fixed	2	HOLOGIC	Discovery Wi	88897	140 kV 5 mA	วินิจฉัยความหนาแน่นของกระ

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBET

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี

รายการ	ประเภท	สถานะ	ชนิด	แบบ	กลุ่ม	ผู้ผลิต	หมายเลขรุ่น	หมายเลขเครื่อง	กำลังสูงสุด	การใช้ประโยชน์
13	Medical	ครอบครอง/ใช้	Radiographic Bus	Fixed	2	DRGEM	GXR-C40	GA/17B0863	150 kV 500 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป

(นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย)
เลขาธิการสำนักงานประมาณเพื่อสันติ

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ 99854 โทรสาร 02951 1028
http://radiation.dmsc.moph.go.th

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

ilac-MRA

QUALITY ASSURANCE DMSc หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพห้องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์

หนังสือนำส่งที่	กร.รธบ. 1298/2566	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด
ลงวันที่	17 สิงหาคม 2566	**ที่อยู่**	60 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
วันที่รับตัวอย่าง	22 สิงหาคม 2566		
หมายเลขตัวอย่าง	0466-354509	**ชนิดตัวอย่าง**	ห้องเอกซเรย์บนรถเอกซเรย์
ชื่อตัวอย่าง	N/A		หมายเลขทะเบียนรถ : 83-5177 นนทบุรี

ลักษณะตัวอย่าง

เครื่องเอกซเรย์ที่ติดตั้งยี่ห้อ : DRGEM Model : GXR-C40 S/N : GAI17B0863

สถานที่ทดสอบ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
60 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เครื่องมือที่ใช้ Fluke Survey Meter Model : 451P-DE-SI-RYR S/N : 8123

เทคนิค 80 kV 100 mA 0.64 sec

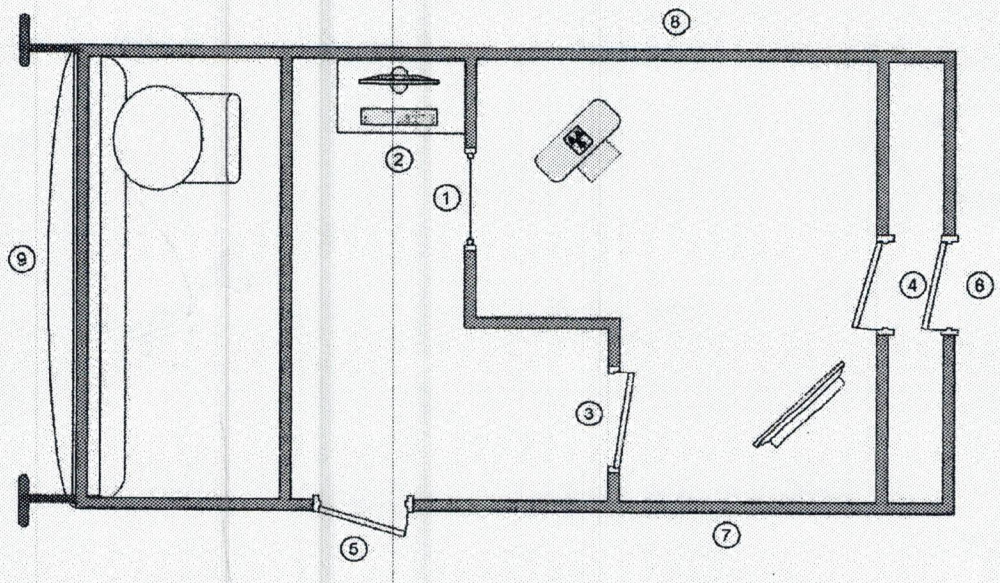

แผนผังแสดงตำแหน่งที่วัดปริมาณรังสีกระเจิง

..... **ผู้ตรวจสอบ**
(นายยุทธพร เลี่ยมแก้ว)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

..... **ผู้รับรองรายงาน**
(นายสุรชัย ตุ้ยด้วง)
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ

วันที่ทดสอบ : 31 ตุลาคม 2566

วันที่ออกรายงาน : 10 พฤศจิกายน 2566

Approved by.....

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง คัดลอก หรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน) BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ 99854 โทรสาร 02951 1028
http://radiation.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพห้องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์

หมายเลขตัวอย่าง : 0466-354509

รายการทดสอบ	ความเข้มรังสีกระเจิง (μGy ใน 1 ชั่วโมง)	ผลการทดสอบ (μGy ใน 1 สัปดาห์)	สรุปผล
ห้องเอกซเรย์หรือห้องถ่ายภาพรังสี			
1. เทคนิคการถ่ายภาพ Chest มีระยะจากจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์ถึงตัวรับภาพ (SID)	ไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร	1.30 เมตร	ไม่ได้มาตรฐาน
พื้นที่ควบคุม (controlled area)			
1. กระจกช่องมองผู้ป่วย	2	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
2. บริเวณควบคุมเครื่องเอกซเรย์	1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
3. ประตูห้องเอกซเรย์ ตำแหน่งที่ 1 (ปิด)	1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
4. ประตูห้องเอกซเรย์ ตำแหน่งที่ 2 (ปิด)	1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
พื้นที่ไม่ควบคุม (uncontrolled area)			
5. ประตูรถเอกซเรย์ ตำแหน่งที่ 1 (ปิด)	น้อยกว่า 1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
6. ประตูรถเอกซเรย์ ตำแหน่งที่ 2 (ปิด)	น้อยกว่า 1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
7. ผนังรถเอกซเรย์ ตำแหน่งที่ 1	1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
8. ผนังรถเอกซเรย์ ตำแหน่งที่ 2	1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน
9. ด้านหน้ารถเอกซเรย์	น้อยกว่า 1	น้อยกว่า 1	ได้มาตรฐาน

Approved by.....

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง คัดลอก หรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท กรุงเทพ คาร์ดิแอค โรงพยาบาล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CARDIAC HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ 99854 โทรสาร 02951 1028
http://radiation.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพห้องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์

หมายเลขตัวอย่าง : 0466-354509

สัญลักษณ์และข้อความเตือนภัยทางรังสี

1. สัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีตามมาตรฐานสากล	☑ มี	☐ ไม่มี
2. ข้อความแจ้งเตือนสตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่ามีครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่	☑ มี	☐ ไม่มี
3. สัญญาณไฟเตือนหรือข้อความแสดงการห้ามเข้าในขณะมีการฉายรังสี	☐ มี	☑ ไม่มี
4. อุปกรณ์ป้องกันรังสี (เช่น ฉากกำบังรังสี และเสื้อตะกั่ว เป็นต้น)	☑ มี	☐ ไม่มี

ข้อแนะนำ :
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องติดอุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสี
2. ควรมีสัญญาณไฟเตือนหรือข้อความแสดงการห้ามเข้าในขณะมีการฉายรังสี

หมายเหตุ :
1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. วิธีทดสอบ/มาตรฐานอ้างอิง : มาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
3. ค่าปริมาณรังสีกระเจิงคำนวณจากค่าภาระงานของเครื่องเอกซเรย์ 240 mA-min ใน 1 สัปดาห์
4. พื้นที่ควบคุม : ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านรังสี ต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 100 μGy ใน 1 สัปดาห์
5. พื้นที่ไม่ควบคุม : ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับบุคคลทั่วไป ต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 20 μGy ใน 1 สัปดาห์
6. N/A : ไม่มีหรือไม่ปรากฏข้อมูล

Approved by.....

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง คัดลอก หรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท บางกอก เวชการโรงพยาบาล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ 99854 โทรสาร 02951 1028
http://radiation.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์

หนังสือนำส่งที่	กร.รธบ. 1298/2566	**ผู้ส่งตัวอย่าง**	บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด
ลงวันที่	17 สิงหาคม 2566	**ที่อยู่**	60 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
วันที่รับตัวอย่าง	22 สิงหาคม 2566		
หมายเลขตัวอย่าง	0466-354508	**ชนิดตัวอย่าง**	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
ชื่อตัวอย่าง	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปบนรถเอกซเรย์		หมายเลขทะเบียนรถ : 83-5177 นนทบุรี

ลักษณะตัวอย่าง

เครื่องเอกซเรย์ยี่ห้อ : DRGEM	Model : GXR-C40	S/N : GAI17B0863	วันที่ผลิต : Dec 2017
หลอดเอกซเรย์ยี่ห้อ : DRGEM	Model : DXT-12	S/N : M1710007	วันที่ผลิต : Oct 2017
Max. kV : 150	Max. mA : 500	Type of Generator : แบบความถี่สูง	
Machine Code : RBF31319		ระบบภาพ : DR	Visit : 7

สถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
60 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เครื่องมือที่ใช้

1. RTI Electronics	Model : Piranha 657	S/N : CB2-19070508
2. RTI Electronics (Luxmeter)	Model : RTI Light probe LUX	S/N : 1704201
3. Fluke Survey Meter	Model : 451P-DE-SI-RYR	S/N : 8123

..... **ผู้ตรวจสอบ**
(นายยุทธพร เลี่ยมแก้ว)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

..... **ผู้รับรองรายงาน**
(นายสุรชัย ตุ้ยด้วง)
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ

วันที่ทดสอบ : 31 ตุลาคม 2566
วันที่ออกรายงาน : 17 พฤศจิกายน 2566

Approved by.....

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ที่ได้ทดสอบเท่านั้น
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง คัดลอก หรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ 99854 โทรสาร 02951 1028
http://radiation.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์

หมายเลขตัวอย่าง : 0466-354508

รายการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ	สรุปผล
1. ค่าความต่างศักย์หลอด (Tube Potential)			
1.1 ความแม่น (accuracy)	ไม่เกิน ± 10%	-5.52%	ได้มาตรฐาน
1.2 ความทำซ้ำ (reproducibility) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบความถี่สูง หรือ แบบสามเฟส	ไม่เกิน 2%	0.04%	ได้มาตรฐาน
1.3 ความทำซ้ำ (reproducibility) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหนึ่งเฟสเต็มคลื่น หรือ แบบครึ่งคลื่น	-	-	-
2. ค่าเวลาในการฉายรังสี (Exposure Time)			
2.1 ความแม่น (accuracy)			
2.1.1 กรณีที่เวลามากกว่าหรือเท่ากับ 0.1 s	ไม่เกิน ± 10%	0.50%	ได้มาตรฐาน
2.1.2 กรณีที่เวลาน้อยกว่า 0.1 s	-	-	-
2.2 ความทำซ้ำ (reproducibility)	ไม่เกิน 5%	0.00%	ได้มาตรฐาน
3. ปริมาณรังสี (Radiation Output)			
3.1 ความทำซ้ำ (reproducibility)	ไม่เกิน 5%	0.16%	ได้มาตรฐาน
3.2 ความเป็นเชิงเส้น (linearity)			
3.2.1 กรณีที่เครื่องเอกซเรย์เป็นระบบตั้งค่ากระแสผ่านหลอดเอกซเรย์ (mA)	ไม่เกิน 10%	3.42%	ได้มาตรฐาน
3.2.2 กรณีที่เครื่องเอกซเรย์เป็นระบบตั้งค่าผลคูณระหว่างกระแสกับเวลา (mAs)	-	-	-
3.3 ค่าระดับปริมาณรังสี (magnitude) ที่ 80 kV ระยะ 1 เมตร	ไม่น้อยกว่า 20 μGy/mAs	40.31 μGy/mAs	ได้มาตรฐาน
4. การกรองรังสี (Filtration) มีค่าความหนาครึ่งค่า (HVL) ที่ 80 kV	ไม่น้อยกว่า 2.9 mm Al	3.49 mm Al	ได้มาตรฐาน
5. อุปกรณ์จำกัดลำรังสี (Beam Limiting Device)			
5.1 อุปกรณ์จำกัดลำรังสีต้องเป็นแบบปรับได้	ปรับได้	ปรับได้	ได้มาตรฐาน
5.2 ความสว่างแสงไฟที่ระยะ 1 เมตร จากตำแหน่งอ้างอิงจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์	ไม่น้อยกว่า 100 lux	143 lux	ได้มาตรฐาน
5.3 การเหลื่อมล้ำระหว่างลำรังสีกับลำแสงไฟ	ไม่เกิน 1 % SID	0.8 % SID	ได้มาตรฐาน
5.4 ความตรงแนวของลำรังสีกับตัวรับภาพ (beam alignment)	-	-	-
6. ปริมาณรังสีรั่วจากหลอดเอกซเรย์ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากจุดโฟกัสของหลอดเอกซเรย์	ไม่เกิน 876 μGy ใน 1 ชั่วโมง	6 μGy ใน 1 ชั่วโมง	ได้มาตรฐาน

Approved by.....

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ที่ได้ทดสอบเท่านั้น
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง คัดลอก หรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท บางกอก เดย์ สูรยปิทล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ 99854 โทรสาร 02951 1028
http://radiation.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์

หมายเลขตัวอย่าง : 0466-354508

Tube Potential

- kVp Accuracy

kV Nominal	50	60	70	80	90	100
kVp Measured	48.76	58.51	68.03	76.22	85.03	94.62

- kVp Reproducibility at 80 kV

kVp Measured	76.22	76.24	76.25	76.24	76.16	76.23

Exposure Time

- Time Accuracy

Time Nominal (sec)	0.10	0.20	0.32	0.40	0.50	0.64
Time Measured (sec)	0.100	0.201	0.320	0.400	0.500	0.640

- Time Reproducibility at 0.10 sec

Time Measured (sec)	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100

Exposure Reproducibility at 80 kV 200 mA 0.10 sec FCD 125 cm

Measured Exposure (μGy)	517	517	515	517	516	516

Linearity at 80 kV 0.10 sec

Nominal (mA)	50	100	160	200	250	320
Measured (μGy/mAs)	27.60	27.70	27.63	25.80	25.96	26.19

Filtration at 80 kV 200 mA 0.10 sec FCD 125 cm

Add filter (mm Al)	0	1	2	3	4
Measured Exposure (μGy)	516	406	331	278	238

Approved by.....

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ที่ได้ทดสอบเท่านั้น
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง คัดลอก หรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02951 0000 ต่อ 99854 โทรสาร 02951 1028
http://radiation.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4050/50

รายงานผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์

หมายเลขตัวอย่าง : 0466-354508

Leakage Radiation at 80 kV 100 mA 0.64 sec

ปริมาณรังสีรั่ว ที่ตำแหน่ง	ความเข้มรังสีรั่ว µGy ใน 1 ชั่วโมง	ปริมาณรังสีที่ได้รับต่ออัตราการใช้งาน ใน 1 ชั่วโมง (µGy)
1.ด้านขวาหลอดเอกซเรย์	110	6
2.ด้านล่างหลอดเอกซเรย์	22	1

หมายเหตุ :
1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2. วิธีการทดสอบ/มาตรฐานอ้างอิง : มาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
3. N/A หมายถึง ไม่มีหรือไม่ปรากฏข้อมูล
4. - หมายถึง รายการทดสอบที่ไม่สามารถทดสอบหรือไม่สามารถสรุปผลได้

Approved by.....

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ที่ได้ทดสอบเท่านั้น
ห้ามนำรายงานฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง คัดลอก หรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Product : Xeta Serial No : 320039

Calibration Date : 3/1/2024

Calibration Due : 3/1/2025

Calibration ID : MC240041

This document certifies that the above instrument has been calibrated to meet the accepted international standards, and/or Manufacturer Specifications ANSI S3.6 (2018), by Maroongroge Co., Ltd.

Calibrator

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

Adjustment & Control

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

gsi Grason-Stadler

otometrics a division of natus

Otodynamics

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CALIBRATION CERTIFICATE

Instrument Model	Xeta	Sound Level Meter: LD 824A5/N: A4728	
Serial Nurnber	320039	Microphone Model: 2559 S/N: 3537	
Headphone Model	☐DD45☑TDH39	Preamplifier Model: PRM902 S/N: 5887	
Left S/N	C418663	Reference Standard: ANSI S3.6 (2018)	
Right S/N	C440551		

Frequency		Tone Level					NB Level				THD		
Indicated	Actual	RETSPL	Test Level	Target Level*	Left Output	Right Output	Test Level	Target Level**	Left Output	Right Output	Test Level***	THD < 2.5%	THD < 2.5%
125	125	45.0	45	90.0	89.9	90.0	40	89.0	89.0	89.0	75	0.17	0.21
250	250	27.0	65	92.0	91.9	92.0	60	91.0	91.0	91.0	90	0.19	0.18
500	500	13.5	75	88.5	88.4	88.7	70	87.5	87.5	87.5	110	0.21	0.29
750	750	9.0	80	89.0	89.0	89.1	75	89.0	89.0	89.0	110	0.27	0.30
1,000	1,000	7.5	80	87.5	87.4	87.6	75	88.5	88.5	88.5	110	0.30	0.32
1,500	1,500	7.5	80	87.5	87.5	87.4	75	88.5	88.5	88.5	110	0.32	0.42
2,000	2,000	9.0	80	89.0	88.9	89.1	75	90.0	90.0	90.0	110	0.36	0.30
3,000	3,000	11.5	80	91.5	91.7	91.6	70	87.5	87.5	87.5	110	0.35	0.72
4,000	4,000	12.0	80	92.0	92.0	92.0	75	92.0	92.0	92.0	110	0.40	0.54
6,000	6,000	16.0	75	91.0	90.9	90.8	70	91.0	91.0	91.0	90	0.51	0.60
8,000	8,000	15.5	75	90.5	90.6	90.8	70	90.5	90.5	90.5	90	0.76	0.62

Input	RETSPL	Test Level	Target Level	Left Output	Right Output
White Noise	0.0	90	90.0	90.0	90.0
Speech Noise	20.0	70	90.0	90.0	90.0
Speech (Mic)****	20.0	70	90.0	-	-

Linearity(dBHL)*****	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
CH1 (Left)	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
CH2 (Right)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Tone Target level is RETSPL + Test Level
** NB Target level is RETSPL + Ref. NB Level (ISO 389-4) + Test Level
*** Or maximum output level of the audiometer, whichever is lower
**** At 0 VU 1kHz
*****At 1kHz

Tolerance Frequency : ±1% Type 1&2 Audiometers and ±2% Type 3&4 Audiometers
Output Level : ±3dB from 125 to 4kHz and ±5dB for 6kHz and higher
THD : Less than 2.5% on all frequencies from 125Hz to 16kHz all Air Conduction
: Less than 3.0% @250Hz, 500Hz and 1kHz for Free Field Speaker
: Less than 5.5% @500Hz, 1kHz, 2kHz and 4kHz for Bone Conduction

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

otometrics a division of natus

gsi Grason-Stadler

Calibrated By:
Date: 03-01-2024
Exp Date: 03-01-2025

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

CALIBRATED BY: MAROONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL 02-378-1180 FAX 02-378-1181

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CALIBRATION CERTIFICATE

Instrument Model	Xeta		Sound Level Meter: LD 824A S/N: A4728
Serial Number	320039		Artificial Mastoid: B&K 4930 S/N:3109516
Bone Model	☐B71 ☑B81		Preamplifier Model: PRM902 S/N: 5887
Bone S/N	10255		Reference Standard: ANSI S3.6 (2018)

Frequency		Tone Level					NB Level			THD	
Indicated	Actual	RETFL	Mastoid Correction	Test Level	Target Level*	Output	Test Level	Target Level**	Output	Test Level	THD < 5.5%
250	250	67.0	-17.4	15	64.6	64.9	10	63.6	63.6		
500	500	58.0	-19.0	20	59.0	59.3	20	63.0	63.0	50	1.68
750	750	48.5	-18.0	30	60.5	60.8	25	60.5	60.5		
1,000	1,000	42.5	-18.7	40	63.8	63.8	30	59.8	59.8	60	1.70
1,500	1,500	36.5	-17.6	45	63.9	63.8	40	64.9	64.9		
2,000	2,000	31.0	-16.6	50	64.4	64.6	45	65.4	65.4	60	1.80
3,000	3,000	30.0	-17.0	50	63.0	63.3	45	64.0	64.0		
4,000	4,000	35.5	-20.2	45	60.3	60.6	40	60.3	60.3	60	2.46
6,000	6,000	40.0	-30.8	40	49.2	49.3	35	49.2	49.2		
8,000	8,000	40.0	-28.8	40	51.2	51.5	35	51.2	51.2		

Input	RETFL	Test Level	Mastoid Correction****	Target Level	Output
White Noise	42.5	40	-18.7	63.8	63.8
Speech Noise	55.0	25	-18.7	61.3	61.3
Speech (Mic)***	55.0	25	-18.7	61.3	-

* Tone Target level is RETFL +Mastoid Correction + Test Level
** NB Target level is RETFL + Mastoid Correction + Ref. NB Level (ISO 389-4) + Test Level
*** At 0 VU 1kHz
****Correction at 1kHz

Tolerance Frequency : ±1% Type 1&2 Audiometers and ±2% Type 3&4 Audiometers
Output Level : ±3dB from 125 to 4kHz and ±5dB for 6kHz and higher
THD : Less than 2.5% on all frequencies from 125Hz to 16kHz all Air Conduction
: Less than 3.0% @250Hz, 500Hz and 1kHz for Free Field Speaker
: Less than 5.5% @500Hz, 1kHz, 2kHz and 4kHz for Bone Conduction

otometrics a division of natus

gsi Grason-Stadler

Calibrated By:
Date: 03-01-2024
Exp Date: 03-01-2025

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

CALIBRATED BY: MAROONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL 02-378-1188(320 REV3.1)

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Product : Xeta Serial No : 320040

Calibration Date : 3/1/2024

Calibration Due : 3/1/2025

Calibration ID : MC240080

This document certifies that the above instrument has been calibrated to meet the accepted international standards, and/or Manufacturer Specifications ANSI S3.6 (2018), by Maroongroge Co., Ltd.

Calibrator

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

Adjustment & Control

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBET

gsi

otometrics

Otodynamics

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CALIBRATION CERTIFICATE

Instrument Model	Xeta
Serial Number	320040
Headphone Model	☐DD45☑TDH39
Left S/N	C398878
Right S/N	C398885

Sound Level Meter: LD 824A S/N: A4728
Microphone Model: 2559 S/N: 3537
Preamplifier Model: PRM902 S/N: 5887
Reference Standard: ANSI S3.6 (2018)

Frequency		Tone Level					NB Level				THD		
Indicated	Actual	RETSPL	Test Level	Target Level*	Left Output	Right Output	Test Level	Target Level**	Left Output	Right Output	Test Level***	THD < 2.5%	THD < 2.5%
125	125	45.0	45	90.0	90.1	90.1	40	89.0	89.0	89.0	75	0.72	0.67
250	250	27.0	65	92.0	92.1	91.9	60	91.0	91.0	91.0	90	0.70	0.61
500	500	13.5	75	88.5	88.5	88.9	70	87.5	87.5	87.5	110	0.66	0.52
750	750	9.0	80	89.0	89.0	89.2	75	89.0	89.0	89.0	110	0.60	0.40
1,000	1,000	7.5	80	87.5	87.4	87.7	75	88.5	88.5	88.5	110	0.79	0.46
1,500	1,500	7.5	80	87.5	87.4	87.6	75	88.5	88.5	88.5	110	0.50	0.59
2,000	2,000	9.0	80	89.0	89.1	89.0	75	90.0	90.0	90.0	110	0.48	0.67
3,000	3,000	11.5	80	91.5	91.4	91.6	70	87.5	87.5	87.5	110	0.51	0.61
4,000	4,000	12.0	80	92.0	92.2	92.1	75	92.0	92.0	92.0	110	0.67	0.65
6,000	6,000	16.0	75	91.0	91.1	91.2	70	91.0	91.0	91.0	90	0.80	0.83
8,000	8,000	15.5	75	90.5	90.7	90.7	70	90.5	90.5	90.5	90	0.85	0.91

Input	RETSPL	Test Level	Target Level	Left Output	Right Output
White Noise	0.0	90	90.0	90.0	90.0
Speech Noise	20.0	70	90.0	90.0	90.0
Speech (Mic)****	20.0	70	90.0	-	-

Linearity(dBHL)*****	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
CH1 (Left)	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
CH2 (Right)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

* Tone Target level is RETSPL + Test Level
** NB Target level is RETSPL + Ref. NB Level (ISO 389-4) + Test Level
*** Or maximum output level of the audiometer, whichever is lower
**** At 0 VU 1kHz
*****At 1kHz

Tolerance Frequency : ±1% Type 1&2 Audiometers and ±2% Type 3&4 Audiometers
Output Level : ±3dB from 125 to 4kHz and ±5dB for 6kHz and higher
THD : Less than 2.5% on all frequencies from 125Hz to 16kHz all Air Conduction
: Less than 3.0% @250Hz, 500Hz and 1kHz for Free Field Speaker
: Less than 5.5% @500Hz, 1kHz, 2kHz and 4kHz for Bone Conduction

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

otometrics a division of natus

gsi Grason-Stadler

Calibrated By:
Date: 03-01-2024
Exp Date: 03-01-2025

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

CALIBRATED BY: MAROONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL 02-378-1188(110 REV3.1)

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CALIBRATION CERTIFICATE

Instrument Model	Xeta
Serial Number	320040
Bone Model	☑B71 ☐B81
Bone S/N	A40167

Sound Level Meter: LD 824A S/N: A4728
Artificial Mastoid: B&K 4930 S/N:3109516
Preamplifier Model: PRM902 S/N: 5887
Reference Standard: ANSI S3.6 (2018)

Frequency		Tone Level					NB Level			THD	
Indicated	Actual	RETFL	Mastoid Correction	Test Level	Target Level*	Output	Test Level	Target Level**	Output	Test Level	THD < 5.5%
250	250	67.0	-17.4	15	64.6	64.5	10	63.6	63.6		
500	500	58.0	-19.0	20	59.0	58.9	20	63.0	63.0	50	2.76
750	750	48.5	-18.0	30	60.5	60.5	25	60.5	60.5		
1,000	1,000	42.5	-18.7	40	63.8	63.8	30	59.8	59.8	60	3.09
1,500	1,500	36.5	-17.6	45	63.9	63.8	40	64.9	64.9		
2,000	2,000	31.0	-16.6	50	64.4	64.3	45	65.4	65.4	60	0.17
3,000	3,000	30.0	-17.0	50	63.0	62.9	45	64.0	64.0		
4,000	4,000	35.5	-20.2	45	60.3	60.5	40	60.3	60.3	60	0.20
6,000	6,000	40.0	-30.8	40	49.2	49.2	35	49.2	49.2		
8,000	8,000	40.0	-28.8	40	51.2	46.2	35	51.2	51.2		

Input	RETFL	Test Level	Mastoid Correction****	Target Level	Output
White Noise	42.5	40	-18.7	63.8	63.8
Speech Noise	55.0	25	-18.7	61.3	61.3
Speech (Mic)***	55.0	25	-18.7	61.3	-

* Tone Target level is RETFL +Mastoid Correction + Test Level
** NB Target level is RETFL + Mastoid Correction + Ref. NB Level (ISO 389-4) + Test Level
*** At 0 VU 1kHz
****Correction at 1kHz

Tolerance Frequency : ±1% Type 1&2 Audiometers and ±2% Type 3&4 Audiometers
Output Level : ±3dB from 125 to 4kHz and ±5dB for 6kHz and higher
THD : Less than 2.5% on all frequencies from 125Hz to 16kHz all Air Conduction
: Less than 3.0% @250Hz, 500Hz and 1kHz for Free Field Speaker
: Less than 5.5% @500Hz, 1kHz, 2kHz and 4kHz for Bone Conduction

otometrics a division of natus

gsi Grason-Stadler

Calibrated By:
Date: 03-01-2024
Exp Date: 03-01-2025

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL

CALIBRATED BY: MAROONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL 02-378-1188(320 REV3.1)

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Product : GSI18 Serial No : GS0067438

Calibration Date : 3/1/2024

Calibration Due : 3/1/2025

Calibration ID : MC240043

This document certifies that the above instrument has been calibrated to meet the accepted international standards, and/or Manufacturer Specifications ANSI S3.6 (2018), by Maroongroge Co., Ltd.

Calibrator

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

Adjustment & Control

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

gsi Grason-Stadler

otometrics a division of natus

Otodynamics

MAROONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL: 02-378-1189 (REV4.0)

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY

CALIBRATION CERTIFICATE

Instrument Model	GSI18	Sound Level Meter: LD 824AS/N: A4728	
Serial Number	GS0067438	Microphone Model: 2559 S/N: 3537	
Headphone Model	☐DD45☑TDH39	Preamplifier Model: PRM902 S/N: 5887	
Left S/N	C416536	Reference Standard: ANSI S3.6 (2018)	
Right S/N	C416518		

Frequency		Tone Level					NB Level				THD		
Indicated	Actual	RETSPL	Test Level	Target Level*	Left Output	Right Output	Test Level	Target Level**	Left Output	Right Output	Test Level***	THD < 2.5%	THD < 2.5%
125	125	45.0	45	90.0	90.1	90.0	40	89.0	-	-	75	0.14	0.16
250	250	27.0	65	92.0	92.1	92.5	60	91.0	-	-	90	0.02	0.03
500	500	13.5	75	88.5	88.7	88.4	70	87.5	-	-	110	0.03	0.02
750	750	9.0	80	89.0	89.4	89.5	75	89.0	-	-	110	0.03	0.02
1,000	1,000	7.5	80	87.5	87.8	87.5	75	88.5	-	-	110	0.04	0.03
1,500	1,500	7.5	80	87.5	87.8	87.6	75	88.5	-	-	110	0.08	0.07
2,000	2,000	9.0	80	89.0	89.3	89.1	75	90.0	-	-	110	0.05	0.06
3,000	3,000	11.5	80	91.5	91.8	91.4	70	87.5	-	-	110	0.02	0.03
4,000	4,000	12.0	80	92.0	92.5	92.2	75	92.0	-	-	110	0.03	0.03
6,000	6,000	16.0	75	91.0	91.1	91.1	70	91.0	-	-	90	0.04	0.05
8,000	8,000	15.5	75	90.5	90.6	90.3	70	90.5	-	-	90	0.19	0.18

Input	RETSPL	Test Level	Target Level	Left Output	Right Output
White Noise	0.0	90	90.0	-	-
Speech Noise	20.0	70	90.0	-	-
Speech (Mic)****	20.0	70	90.0	-	-

Linearity(dBHL)*****	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
CH1 (Left)	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
CH2 (Right)	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* Tone Target level is RETSPL + Test Level
** NB Target level is RETSPL + Ref. NB Level (ISO 389-4) + Test Level
*** Or maximum output level of the audiometer, whichever is lower
**** At 0 VU 1kHz
*****At 1kHz

Tolerance Frequency : ±1% Type 1&2 Audiometers and ±2% Type 3&4 Audiometers
Output Level : ±3dB from 125 to 4kHz and ±5dB for 6kHz and higher
THD : Less than 2.5% on all frequencies from 125Hz to 16kHz all Air Conduction
: Less than 3.0% @250Hz, 500Hz and 1kHz for Free Field Speaker
: Less than 5.5% @500Hz, 1kHz, 2kHz and 4kHz for Bone Conduction

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

otometrics a division of natus

gsi Grason-Stadler

Calibrated By:

Date: 03-01-2024

Exp Date: 03-01-2025

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

CALIBRATED BY: MAROONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL 02-378-1188(110 REV3.1)

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Product : GSI18 Serial No : GS0067439

Calibration Date : 3/1/2024

Calibration Due : 3/1/2025

Calibration ID : MC240123

This document certifies that the above instrument has been calibrated to meet the accepted international standards, and/or Manufacturer Specifications ANSI S3.6 (2018), by Maroongroge Co., Ltd.

Calibrator

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

Adjustment & Control

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL

gsi

otometrics

Otodynamics

MAROONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL. 02-378-1188 (REV4.0)

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

CALIBRATION CERTIFICATE

Instrument Model	GSI18	Sound Level Meter: LD 824AS/N: A4728	
Serial Number	GS0067439	Microphone Model: 2559 S/N: 3537	
Headphone Model	☑DD45☐TDH39	Preamplifier Model: PRM902 S/N: 5887	
Left S/N	C399183	Reference Standard: ANSI S3.6 (2018)	
Right S/N	C385730		

Frequency		Tone Level					NB Level				THD		
Indicated	Actual	RETSPL	Test Level	Target Level*	Left Output	Right Output	Test Level	Target Level**	Left Output	Right Output	Test Level***	THD < 2.5%	THD < 2.5%
125	125	45.0	45	90.0	89.9	90.0	40	89.0	-	-	75	0.15	0.15
250	250	27.0	65	92.0	91.9	92.0	60	91.0	-	-	90	0.04	0.04
500	500	13.5	75	88.5	88.7	88.6	70	87.5	-	-	110	0.03	0.03
750	750	9.0	80	89.0	89.1	88.9	75	89.0	-	-	110	0.03	0.03
1,000	1,000	7.5	80	87.5	87.4	87.4	75	88.5	-	-	110	0.04	0.03
1,500	1,500	7.5	80	87.5	87.5	87.4	75	88.5	-	-	110	0.08	0.06
2,000	2,000	9.0	80	89.0	89.0	88.9	75	90.0	-	-	110	0.08	0.06
3,000	3,000	11.5	80	91.5	91.6	91.8	70	87.5	-	-	110	0.04	0.04
4,000	4,000	12.0	80	92.0	91.8	92.0	75	92.0	-	-	110	0.03	0.03
6,000	6,000	16.0	75	91.0	90.8	91.2	70	91.0	-	-	90	0.03	0.02
8,000	8,000	15.5	75	90.5	90.4	90.4	70	90.5	-	-	90	0.40	0.03

Input	RETSPL	Test Level	Target Level	Left Output	Right Output
White Noise	0.0	90	90.0	-	-
Speech Noise	20.0	70	90.0	-	-
Speech (Mic)****	20.0	70	90.0	-	-

Linearity(dBHL)*****	110	105	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
CH1 (Left)	-	-	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	-	-
CH2 (Right)	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.2	-	-

* Tone Target level is RETSPL + Test Level
** NB Target level is RETSPL + Ref. NB Level (ISO 389-4) + Test Level
*** Or maximum output level of the audiometer, whichever is lower
**** At 0 VU 1kHz
*****At 1kHz

Tolerance Frequency : ±1% Type 1&2 Audiometers and ±2% Type 3&4 Audiometers
Output Level : ±3dB from 125 to 4kHz and ±5dB for 6kHz and higher
THD : Less than 2.5% on all frequencies from 125Hz to 16kHz all Air Conduction
: Less than 3.0% @250Hz, 500Hz and 1kHz for Free Field Speaker
: Less than 5.5% @500Hz, 1kHz, 2kHz and 4kHz for Bone Conduction

KASEMRAD
BETHANIA FRIENDS HOSPITAL
"KRITHANATHEETH"

otometrics
a division of natus

gsi
Grason-Stadler

Calibrated By:
Date: 03-01-2024
Exp Date: 03-01-2025

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

CALIBRATED BY: MARDONGROGE CO., LTD, 1201 RAMKHAMHAENG ROAD, HUAMAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL 02-378-1188(110 REV3.1)

BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sound Room Certificate of Measurement

This is to certify on January 9, 2024

Make and Model Maroongroge Co., Ltd.

Serial Number 1/52-9284

Time and Location 9.48 a.m. /Hearing.Service and Supplies Co.,Ltd.

was measured with the following interior octave band center sound pressure levels by Maroongroge Co., Ltd.

Octave Band Center Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Measured SPL (Inside)	4.4	10.7	13.3	7.2	9.6	4.2	5.1
Measured SPL (Outside)	17.2	20.4	23.2	26.1	26.0	19.3	13.5

To determine compliance with the following specifications, refer to the next page of this certificate :

OSHA Table D-1, 1983 Specifications,

ANSI S3.1 - 1999 Maximum Permissible Ambient Noise Levels for Sound Rooms

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

Signature : .....

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Sound Room Certificate of Measurement

This is to certify on January 9, 2024

Make and Model Maroongroge Co., Ltd.

Serial Number 2/52-9284

Time and Location 9.57 a.m. /Hearing Service and Supplies Co.,Ltd.

was measured with the following interior octave band center sound pressure levels by Maroongroge Co., Ltd.

Octave Band Center Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Measured SPL (Inside)	5.0	10.2	13.8	8.1	9.4	4.7	5.3
Measured SPL (Outside)	17.2	20.4	23.2	26.1	26.0	19.3	13.5

To determine compliance with the following specifications, refer to the next page of this certificate :

OSHA Table D-1, 1983 Specifications,

ANSI S3.1 - 1999 Maximum Permissible Ambient Noise Levels for Sound Rooms

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETR

Signature : .....

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL

Sound Room Certificate of Measurement

This is to certify on January 9, 2024

Make and Model Maroongroge Co., Ltd.

Serial Number 3/52-9284

Time and Location 10.15 a.m. /Hearing Service and Supplies Co.,Ltd.

was measured with the following interior octave band center sound pressure levels by Maroongroge Co., Ltd.

Octave Band Center Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Measured SPL (Inside)	4.2	2.0	6.8	3.6	8.6	4.0	4.3
Measured SPL (Outside)	17.2	20.4	23.2	26.1	26.0	19.3	13.5

To determine compliance with the following specifications, refer to the next page of this certificate :

OSHA Table D-1, 1983 Specifications,

ANSI S3.1 - 1999 Maximum Permissible Ambient Noise Levels for Sound Rooms

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL RATTANATHIBETH

Signature : .....

บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด

BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Maximum Permissible Ambient Noise Levels

ANSI S3.1-1999 (R2003) and OSHA 1983 Specifications

ANSI S3.1-1999 Specification	Desired Frequency Testing Range Hz	Octave Band Center Frequency (Hz) Values in dB SPL						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Insert Earphone	125 - 8000	59	53	50	47	49	50	56
Insert Earphone	250 - 8000	67	53	50	47	49	50	56
Insert Earphone	500 - 8000	78	64	50	47	49	50	56
Supra-Aural Earphone	125 - 8000	35	25	21	26	34	37	37
Supra-Aural Earphone	250 - 8000	39	25	21	26	34	37	37
Supra-Aural Earphone	500 - 8000	49	35	21	26	34	37	37
Ears Not Covered	125 - 8000	29	21	16	13	14	11	14
Ears Not Covered	250 - 8000	35	21	16	13	14	11	14
Ears Not Covered	500 - 8000	44	30	16	13	14	11	14

OSHA, Table D-1, 1983	Desired Frequency Testing Range Hz	Octave Band Center Frequency (Hz) Values in dB SPL						
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Ears Covered	125 - 8000	N/A	N/A	40	40	47	57	62

Noise levels were derived by assuming that the slope for the upward spread of masking function is 14 dB/ octave below the lowest test frequency.

Ambient noise measurements shall be made annually or whenever any new noise source is operating within or in the vicinity of the audiometric test room.

Measurements shall include 125 Hz to 8000 Hz inclusive regardless of the test condition or test frequency range to be employed. The values for ears not covered are to be applied for bone or sound field testing.

IMPORTANT

Audiometry for OSHA hearing testing purposes is not recommended if one or more of the measured values exceed the values as shown in the above OSHA Table D.1.

Audiometry for hearing conservation (workers compensation) purposes is not recommended by ANSI if one or more of the measured values exceed the ANSI S3.1-1999 (R2003) Supra-Aural or Insert Earphone values as shown in the table for the test frequency range of 500 Hz to 8000 Hz.

Clinical audiometry testing for a particular frequency is not recommended if any measured ambient noise value exceeds the ANSI S3.1-1999 (R2003) value for the specific frequency and testing environment as shown in the above table.

KASEMRAD INTERNATIONAL HOSPITAL
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
58 หมู่ 15 ถ. รัตนาธิเบศร์ ต. บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9213400-9 Fax.029213400 ต่อ 1119
58 Moo. 15 Ratanathibeth Rd., Bangrakpatana, Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Tel: 02-9213400-9 Fax.029213400 Ext.1119

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ รพ.ทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์
58 หมู่ที่ 15 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
นนทบุรี 11110

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นางสาวพรลักษณ์ หาญพาณิชย์ และ นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ดำเนินการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 15 ตำบล/แขวง บางรักพัฒนา อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 "ผู้มอบอำนาจ"

ขอมอบอำนาจให้ นายแพทย์ยอร์น จิระนคร "ผู้รับมอบอำนาจ" ถือบัตรประชาชนเลขที่ 3-9098-00495-77-7 อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนน สฤษดิ์ ตำบล สะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000 ให้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า เพื่อการลงลายมือชื่อในสำเนาเอกสาร หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เท่านั้น

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอ รับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ
(นางสาวพรลักษณ์ หาญพาณิชย์)

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ
(นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(นายแพทย์ยอร์น จิระนคร)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางสาวณัสสมิตา สมคำนึง)

ลงชื่อ ..... พยาน
(นางสาวสุประภา ยำหาส)

ใช้สำหรับออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นเท่านั้น

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9098 00495 77 7

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ยอร์น จิระนคร

Name Mr. Yorn

Last name Chiranakhon

เกิดวันที่ 7 ธ.ค. 2505

Date of Birth 7 Dec. 1962

[redacted]

ที่อยู่ 2/1 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

12 มิ.ย. 2561 วันออกบัตร 12 Jun. 2018 Date of Issue

ออกให้ที่ (นายสิทธิ์ จุฬสุวโสภิต) เจ้าพนักงานออกบัตร

6 ธ.ค. 2569 วันบัตรหมดอายุ 6 Dec. 2026 Date of Expiry

9001-04-08121263

[redacted]

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9499-004902-1 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายยอร์น จิระนคร สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-9098-00495-77-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 7 ธ.ค. 2505

บิดาชื่อ แบรี 3-9098-00495-76-9 สัญชาติ ไทย

มารดาชื่อ กวี 3-9098-00005-45-[illegible] สัญชาติ ไทย

• เมื่อวัน ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 26 ธ.ค. 2549 (น.ส.ขวัญเรือน สงประสพ)

•• ไปที่ นายทะเบียน

[redacted]

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9499-004902-1 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปัตตานี

บ้านตั้งอยู่ที่ 2/1 ถนนสฤษดิ์

ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน "แทนฉบับเดิมที่สูญหาย"

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน

(น.ส.ขวัญเรือน สงประสพ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 2 กันยายน 2554

ใช้สำหรับออกหนังสือเดินทาง ป.ปัญญานันท์ แก้งคอนแก่น เท่านั้น

บริษัท บางกอก ชิน ฮอสปิตอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบอนุญาตที่ ๑๑๕๒

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตนี้แก่

นายชูชาติ จิระนคร อายุ ๒๙ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

ออกให้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

นายกแพทยสภา

เลขาธิการแพทยสภา

สำหรับออกใบรับรองเท่านั้น แก้งคอย ขอบแก้ว เท่านั้น

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY

ส.พ. ๑๙

233503

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ด.๑๐๒๐๑๐๐๔๓๖๑

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายแพทย์ยอร์น จิระนคร

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรม เลขที่ ๑๓๕๒๖

วันที่ออกใบอนุญาต ๑ เมษายน ๒๕๒๙ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ประเภท ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง ๑๑๙ เตียง ลักษณะสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๕

ซอย/ตรอก - ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล/แขวง บางรักพัฒนา

อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๒๑ ๓๔๐๐-๙ โทรสาร ๐ ๒๙๒๑ ๓๔๐๐ ต่อ ๑๑๑๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ -

วัน/เวลาทำการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อนุญาต

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ ศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

ใช้สำหรับออกใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพ บ.ปูนซีเมนต์ปากช่องคอย ขอนแก่น เท่านั้น

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส.พ. ๗

205008

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๒๒๖๐ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๐๙๕๘)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

โดย นายเฉลิม หาญพาณิชย์ และ นางสมพร หาญพาณิชย์

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**

ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป** จำนวนเตียง **๑๑๙** เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ **โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์**

ตั้งอยู่เลขที่ **๕๘** หมู่ที่ **๑๕**

ซอย/ตรอก **-** ถนน **รัตนาธิเบศร์**

ตำบล/แขวง **บางรักพัฒนา** อำเภอ/เขต **บางบัวทอง** จังหวัด **นนทบุรี**

รหัสไปรษณีย์ **๑๑๑๑๐** โทรศัพท์ **๖๒๙๒๑ ๓๔๐๐-๙**

วัน/เวลาเปิดทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม **บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. **๒๕๖๗** และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิศิษฏ์ ตั้งบุญกำกร)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้อนุญาต

ใช้สำหรับหน่วยตรวจสุขภาพ บ.ในเครือเมนต์ แก่งคอย ข้อมูลเก่า เท่านั้น

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ 12001220000447

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000401
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายเฉลิม หาญพาณิชย์
   2. นางสมพร หาญพาณิชย์
   3. นายพิภพ วีระพงษ์
   4. นายวิรัช อภิเมธีธำรง
   5. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
   6. นางสาวพรลักษณ์ หาญพาณิชย์
   7. นายธวัช สุนทราจารย์
   8. นายกันตพร หาญพาณิชย์
   9. นายพินิจ หาญพาณิชย์
   10. นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
   11. นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
   12. นายสุรพันธ์ ทวีวิกยการ/
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเฉลิม หาญพาณิชย์ หรือ นางสมพร หาญพาณิชย์ หรือ นางสาวพรลักษณ์ หาญพาณิชย์ หรือ นายกันตพร หาญพาณิชย์ หรือ นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท
   ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ คือ -ไม่มี-/
4. ทุน ทุนจดทะเบียน 2,493,748,115.00 บาท /
   (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
   ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,493,747,984.00 บาท /
   (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/
   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 586,588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร/
   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร/
   สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร/

ใช้สำหรับออกหนังสือรับรองสุขภาพ บ.ปูนซีเมนต์ นกเงคอย ขอนแก่น เท่านั้น

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ 12001220000447

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 58 หมู่ที่ 15 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 885 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 24 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางสาวนภาภรณ์ ภู่ทวี)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 12001220000447

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105536133470 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565

4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น บ.ปูนซีเมนต์ แกรนอย ขอนแก่น จำกัด

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
0107547000401
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1)

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ปิยนุช ซีเมนต์ แก้วคอย ขอมแก่น เท่านั้น

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
0107547000401

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1)

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยอาชีพอากร และกฎหมายอื่น

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

สำเนาเพื่อการใช้งานเท่านั้น บ.ปัญญาอินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
0107547000401
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 24 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1)

(16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเร็น รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

(23) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้

(24) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใดๆ ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลสำหรับองค์กรผู้ใช้งานเท่านั้น ตรวจสอบ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-1075-47000-40-1

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท บางกอก เวช สะดปิทอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสถานประกอบการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ (KASEMRAD HOSPITAL RATTANATHIBETH)

เป็น ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 00005

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 88

หมู่ที่ 15 ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง บางรักพัฒนา อำเภอ/เขต บางบัวทอง

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 1 เมษายน 2558

ใช้สำหรับออกหน่วยตรวจสุขภาพ บ.ปูนซีเมนต์ แก่งคอย ซูอนแก่น เท่านั้น

ออกให้เมื่อวันที่

ผู้ออกทะเบียน

( )

ตำแหน่ง

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

บริษัท บางกอก เวช สะดปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED