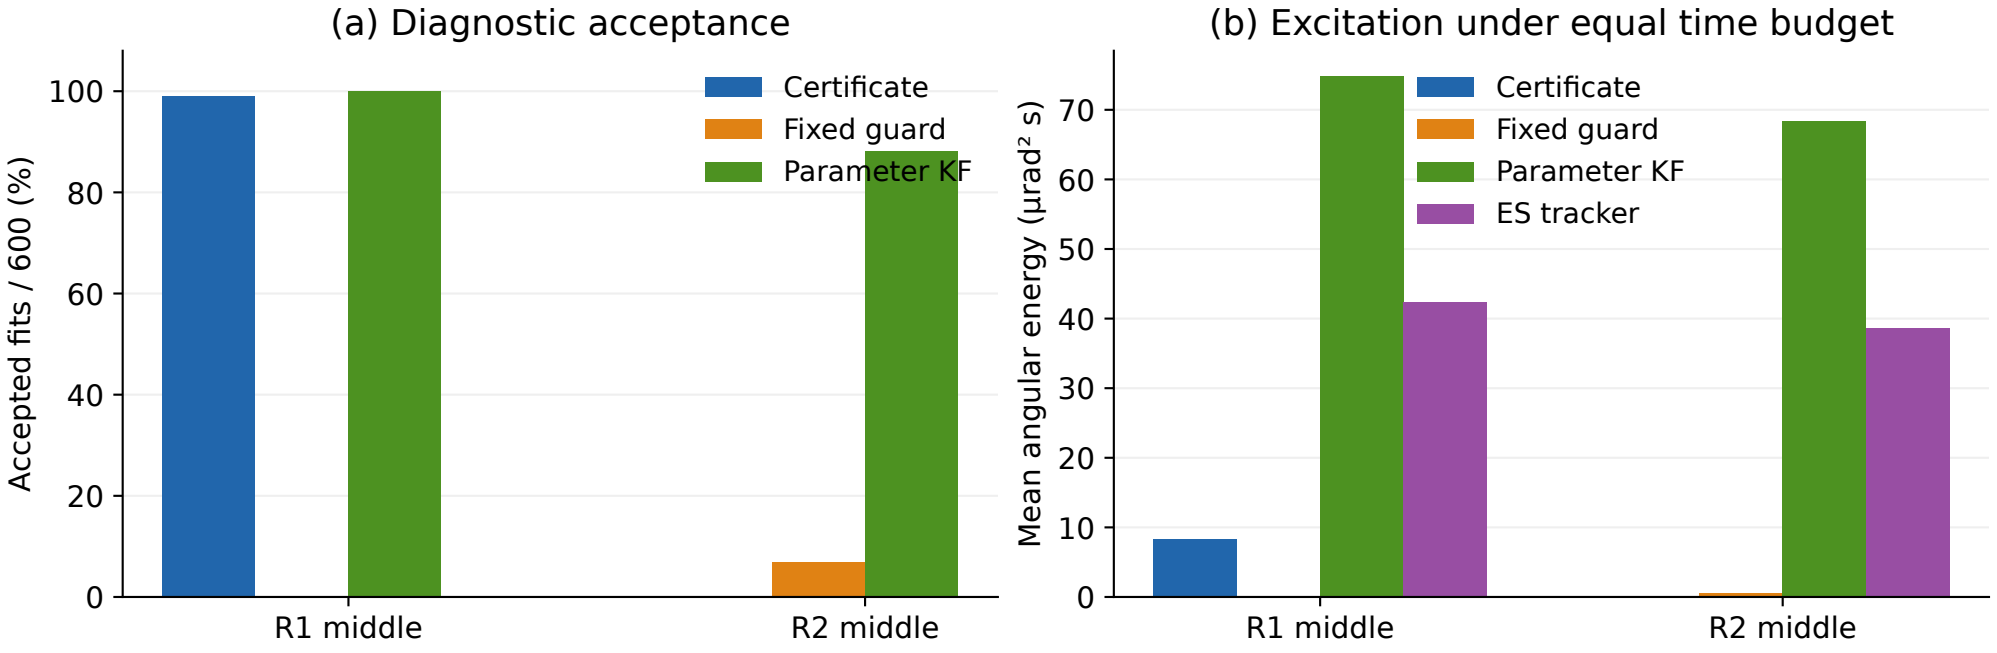
(a) Diagnostic acceptance
Accepted fits / 600 (%)
0
20
40
60
80
100
R1 middle
R2 middle
Certificate
Fixed guard
Parameter KF
(b) Excitation under equal time budget
Mean angular energy (μrad² s)
0
10
20
30
40
50
60
70
R1 middle
R2 middle
Certificate
Fixed guard
Parameter KF
ES tracker