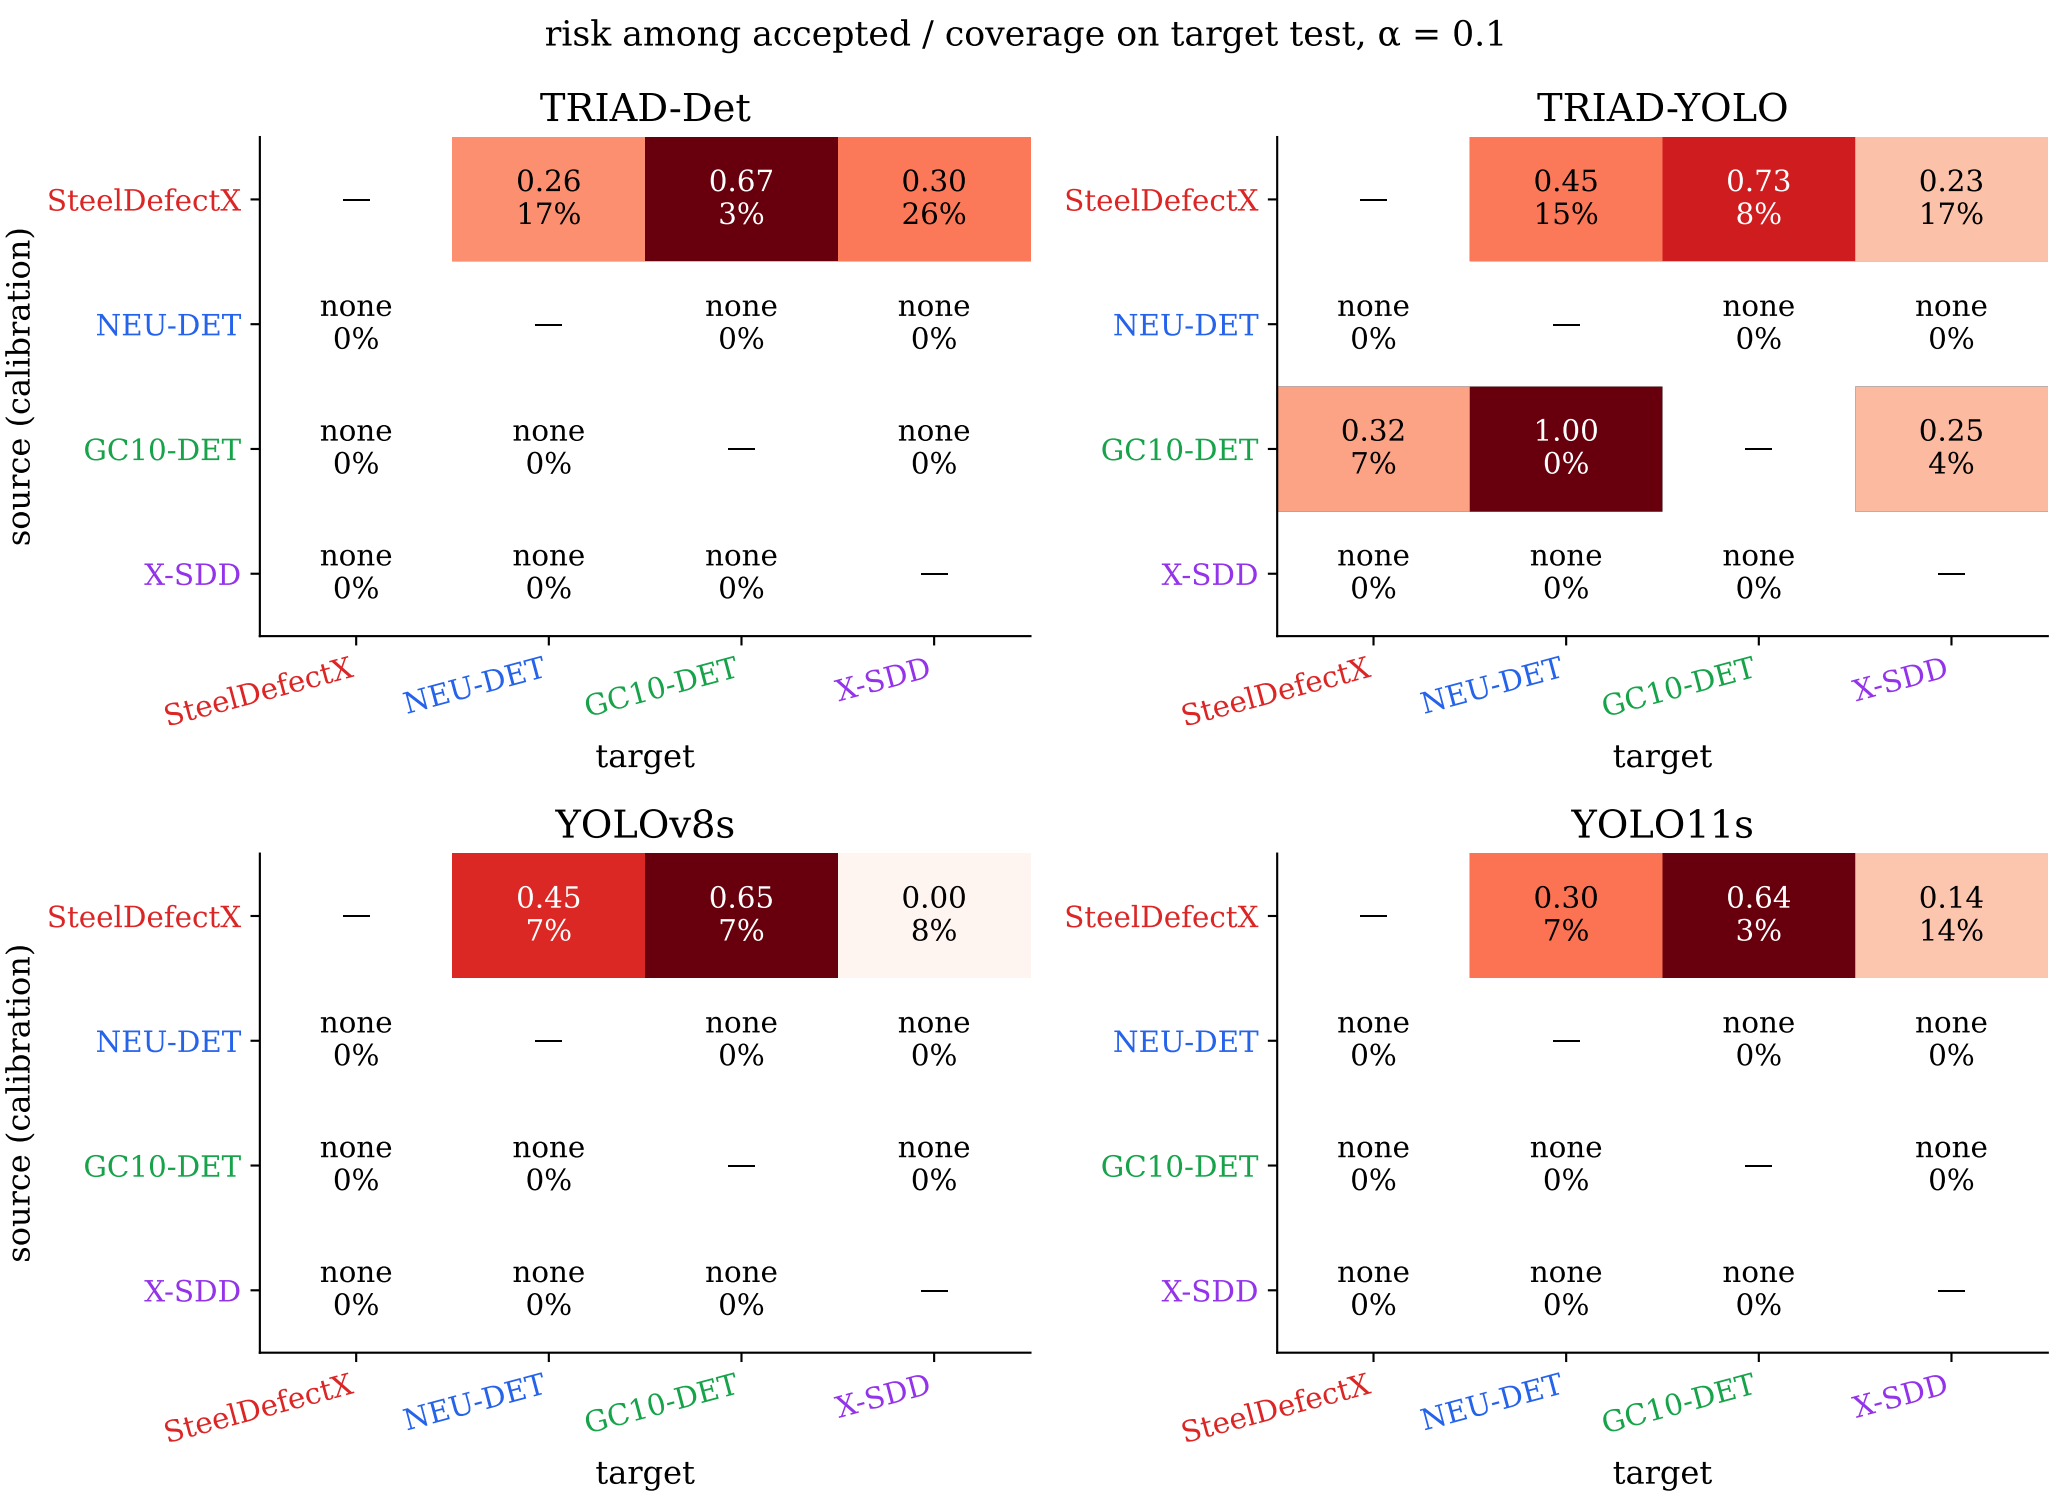
risk among accepted / coverage on target test, α = 0.1
TRIAD-Det
TRIAD-YOLO
YOLOv8s
YOLO11s
source (calibration)
target
SteelDefectX
NEU-DET
GC10-DET
X-SDD
—
none
0%
0.26
17%
0.67
3%
0.30
26%
0.45
15%
0.73
8%
0.23
17%
0.32
7%
1.00
0%
0.25
4%
0.45
7%
0.65
7%
0.00
8%
0.30
7%
0.64
3%
0.14
14%