


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/02/2026 - 17/02/2026
Dias de utilização		5/5 dias (100%)
>= 4 horas		4 dias (80%)
< 4 horas		1 dias (20%)
Horas de utilização		24 horas 31 minutos
Utilização média (total de dias)		4 horas 54 minutos
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 54 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 2 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/02/2026)		6,326 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291907
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.1	Percentil 95.º: 10.1	Máximo: 10.4	
Fugas — l/min	Mediana: 16.6	Percentil 95.º: 32.9	Máximo: 49.0	
Eventos por hora	IA: 4.6	IH: 0.3	IAH: 4.9	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 2.3	Desconhecid	1.0
Índice RERA				0.9
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

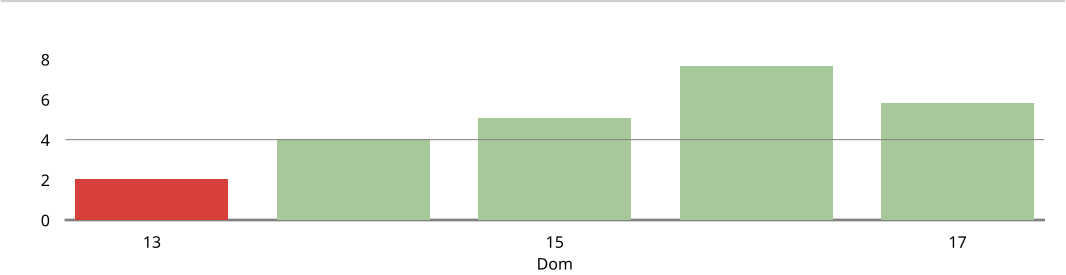


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291907


Utilização (horas)

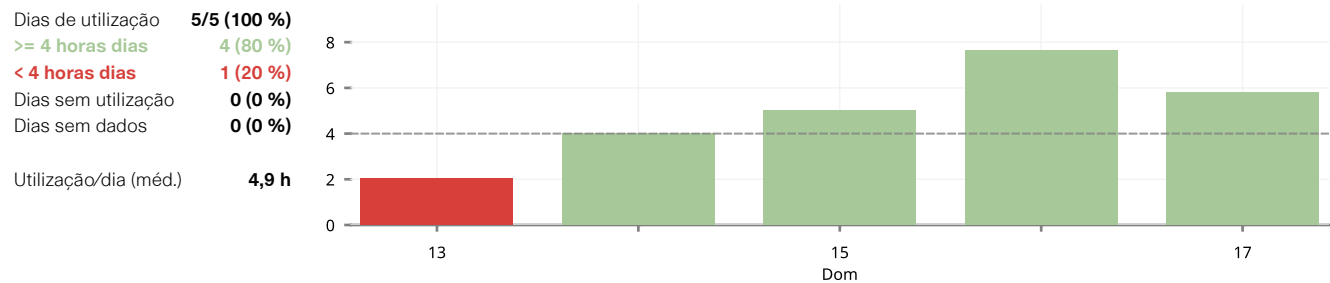

Fuga (l/min)

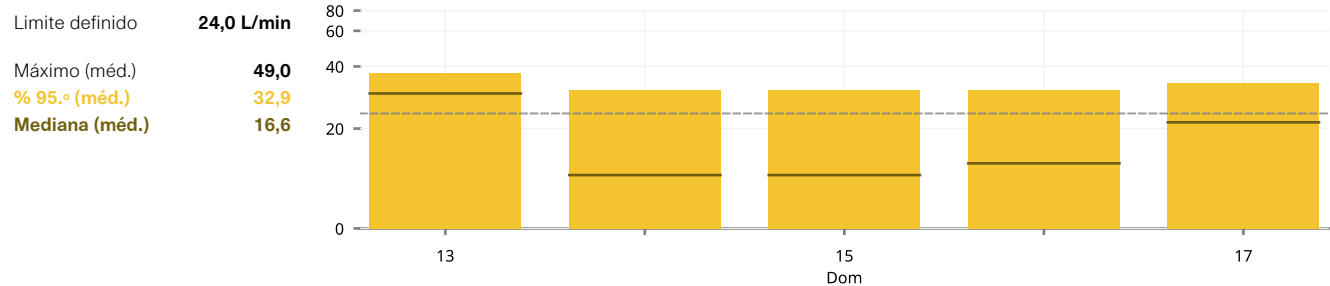

Pressão (cmH2O)

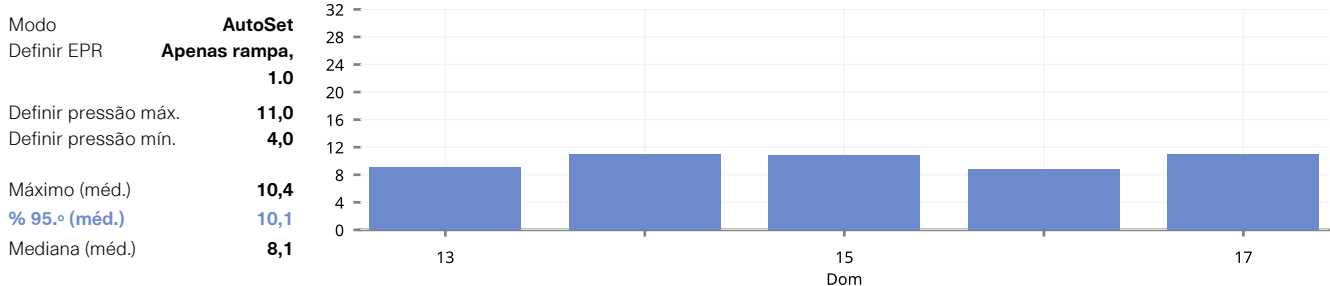

IAH (eventos/hora)

