


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/02/2026 - 07/03/2026
Dias de utilização	17/18 dias (94%)	
>= 4 horas	16 dias (89%)	
< 4 horas	1 dias (6%)	
Horas de utilização	116 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 51 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 10 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/03/2026)	2,534 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882363
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.7	Percentil 95.º: 9.3	Máximo: 9.3	
Fugas — l/min	Mediana: 13.1	Percentil 95.º: 26.8	Máximo: 37.0	
Eventos por hora	IA: 10.0	IH: 2.6	IAH: 12.6	
Índice de apneia	Central: 3.8	Obstrutiva: 5.2	Desconhecid	0.9
Índice RERA	2.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização

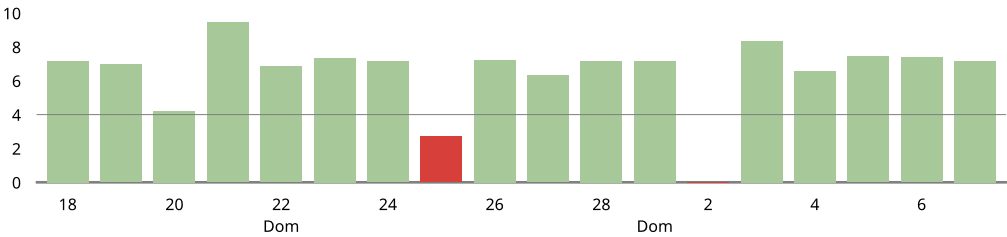


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882363


Utilização (horas)

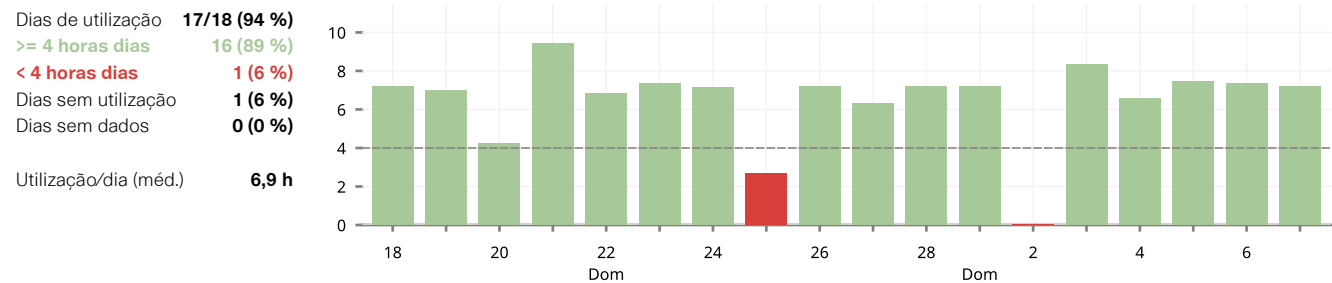

Fuga (l/min)

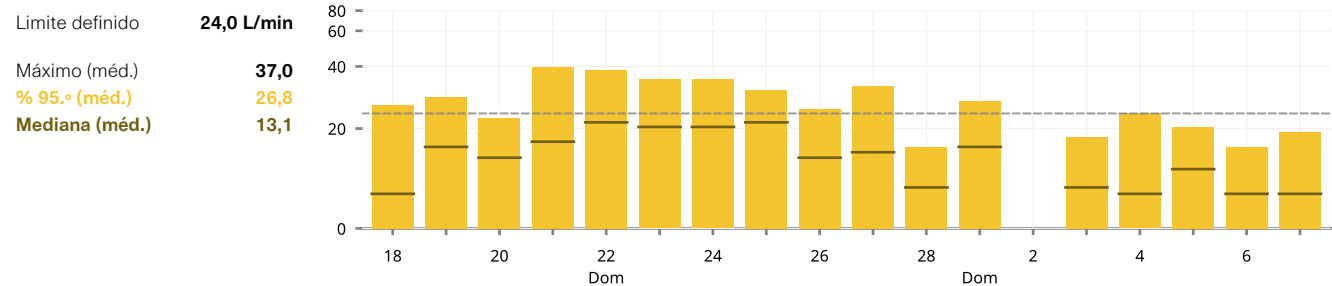

Pressão (cmH2O)

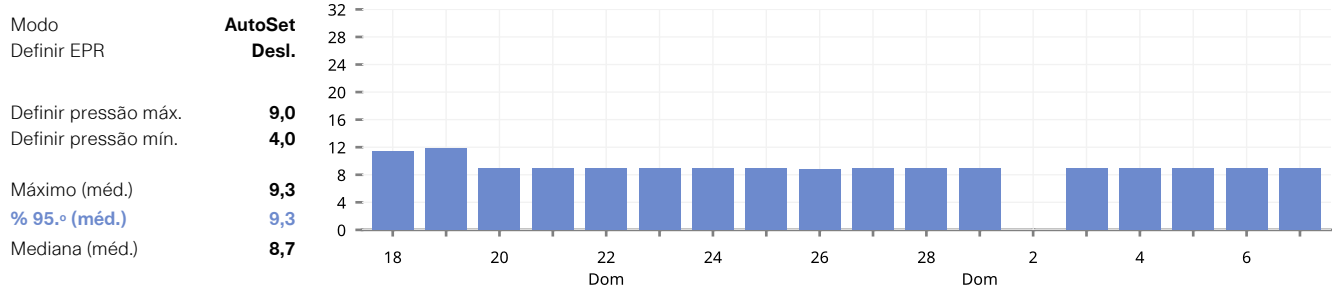

IAH (eventos/hora)

