

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

23/02/2026 - 24/03/2026

Dias de utilização		29/30 dias (97%)	
>= 4 horas		29 dias (97%)	
< 4 horas		0 dias (0%)	
Horas de utilização		233 horas 59 minutos	
Utilização média (total de dias)		7 horas 48 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		8 horas 4 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 46 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/03/2026)		2,675 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22232882359	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		10 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 9.6	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0
Fugas — l/min	Mediana: 8.7	Percentil 95.º: 25.7	Máximo: 34.6
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 1.0	IAH: 1.1
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.4		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

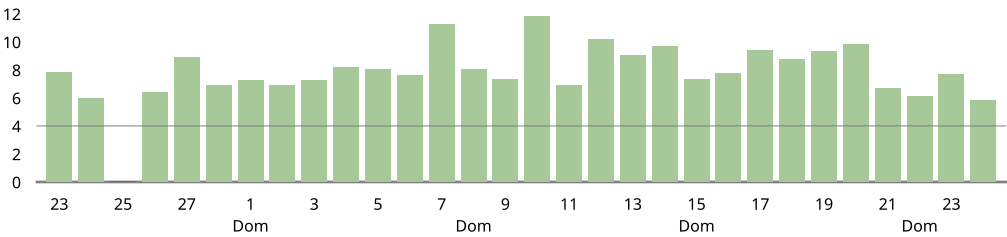


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882359


Utilização (horas)

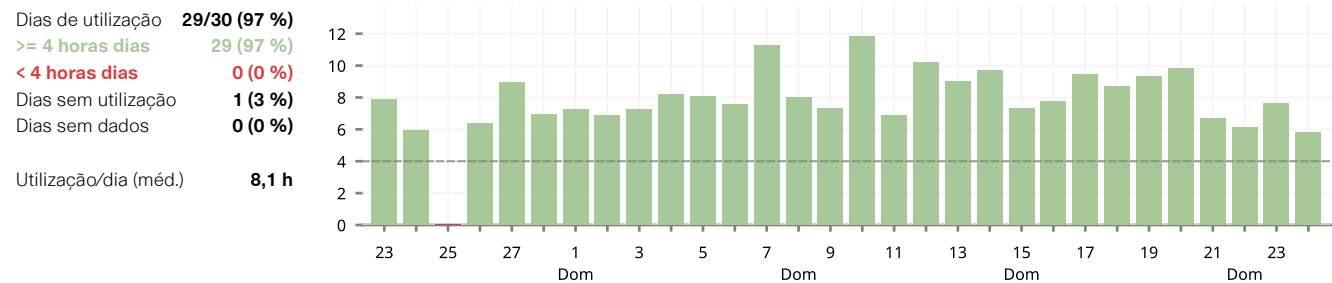

Fuga (l/min)

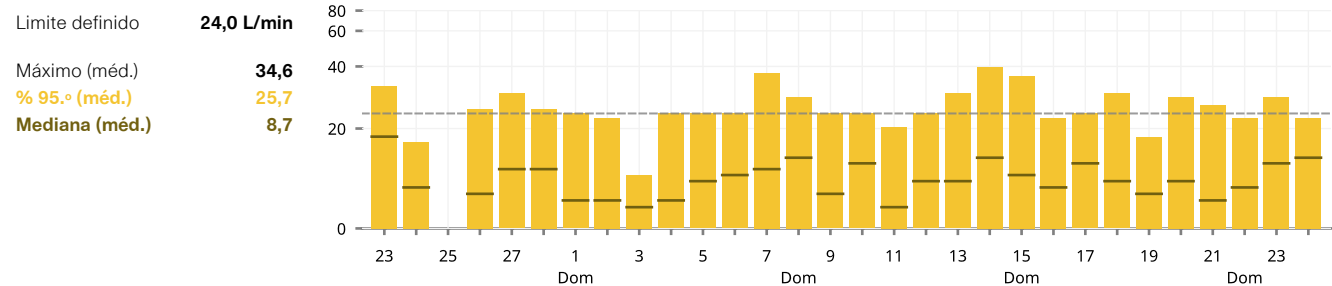

Pressão (cmH2O)

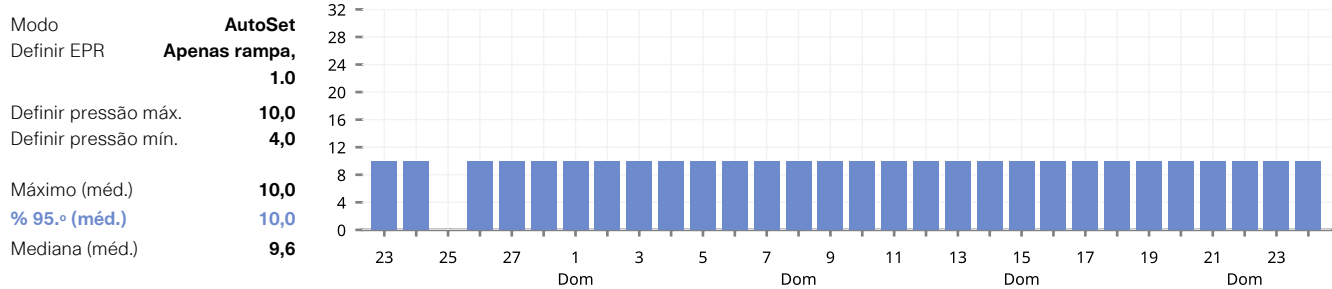

IAH (eventos/hora)

