

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

10/03/2026 - 15/03/2026

Dias de utilização		5/6 dias (83%)	
>= 4 horas		3 dias (50%)	
< 4 horas		2 dias (33%)	
Horas de utilização		19 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)		3 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 58 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/03/2026)		2,257 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		2222291891	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		6 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 6.0	Máximo: 6.0
Fugas — l/min	Mediana: 1.4	Percentil 95.º: 15.4	Máximo: 38.6
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.2	IAH: 0.4
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.8		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

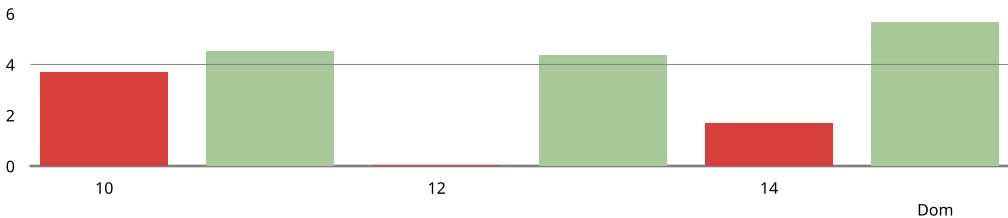


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291891


Utilização (horas)

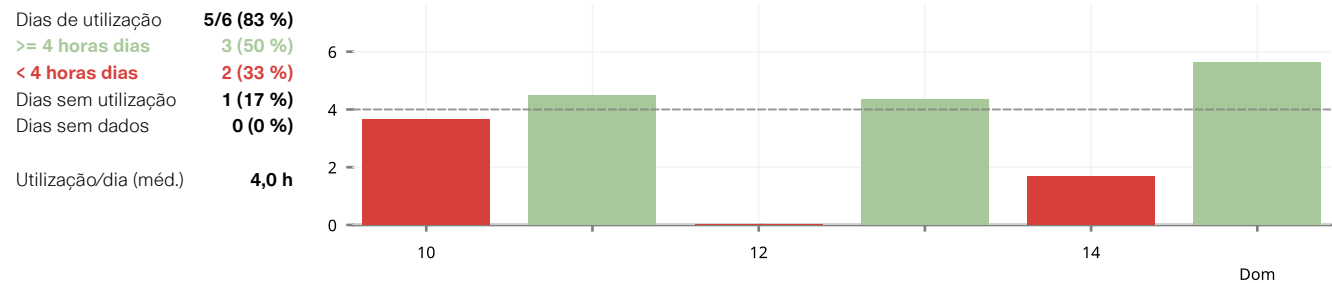

Fuga (l/min)

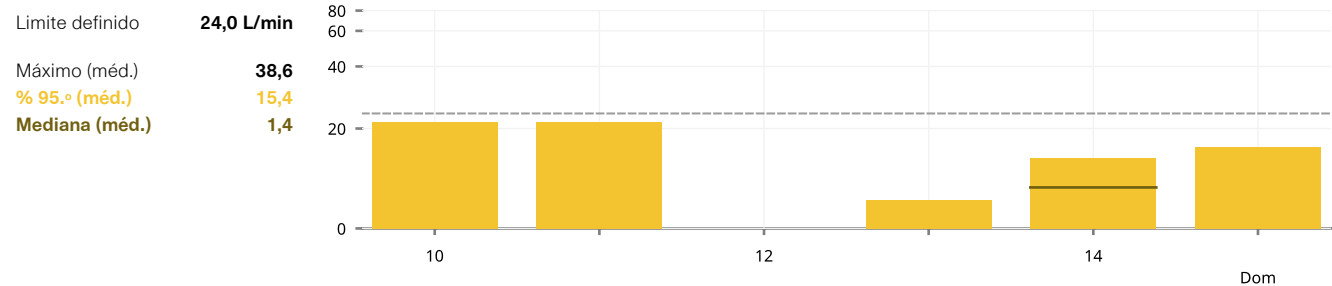

Pressão (cmH2O)

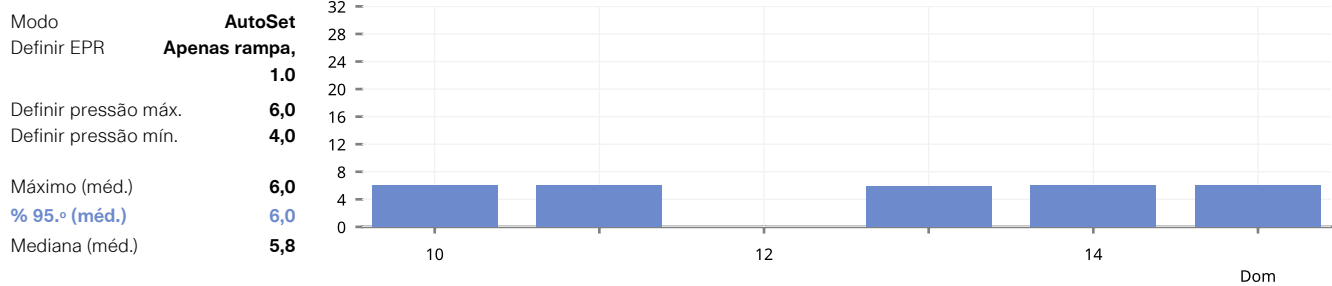

IAH (eventos/hora)

