


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/02/2026 - 11/03/2026
Dias de utilização	10/30 dias (33%)	
>= 4 horas	10 dias (33%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	77 horas 40 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 35 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 5 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/03/2026)	1,325 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024693
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.2	Percentil 95.º: 10.2	Máximo: 10.2	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 4.1	Máximo: 21.7	
Eventos por hora	IA: 3.8	IH: 0.6	IAH: 4.4	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 3.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	2.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

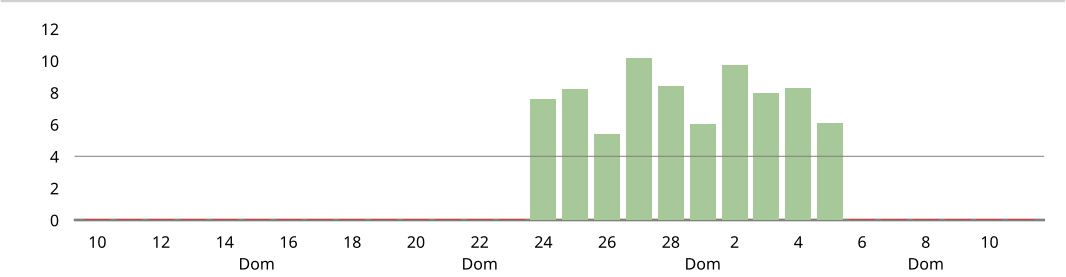


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024693


Utilização (horas)

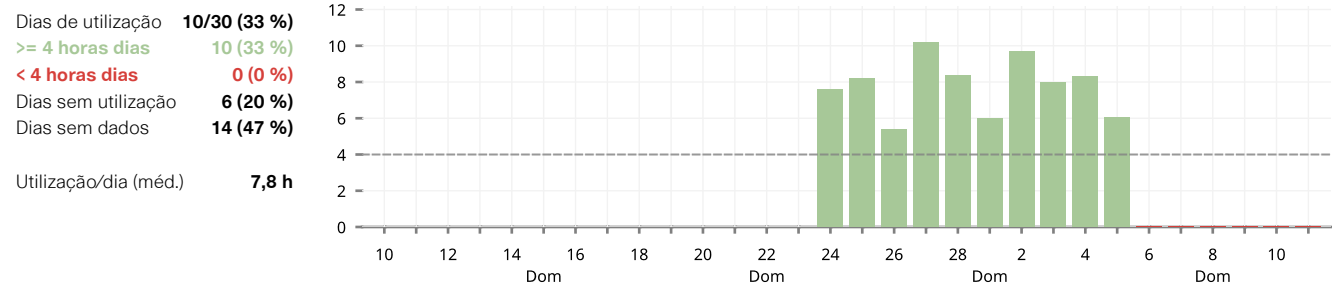

Fuga (l/min)

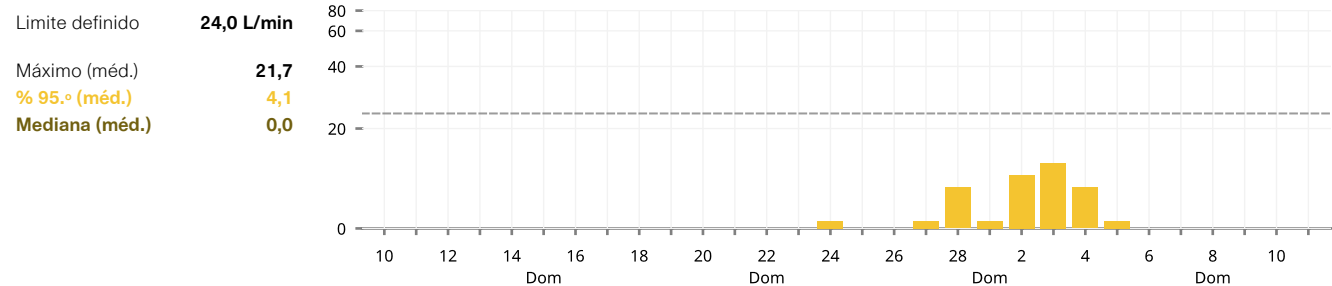

Pressão (cmH2O)

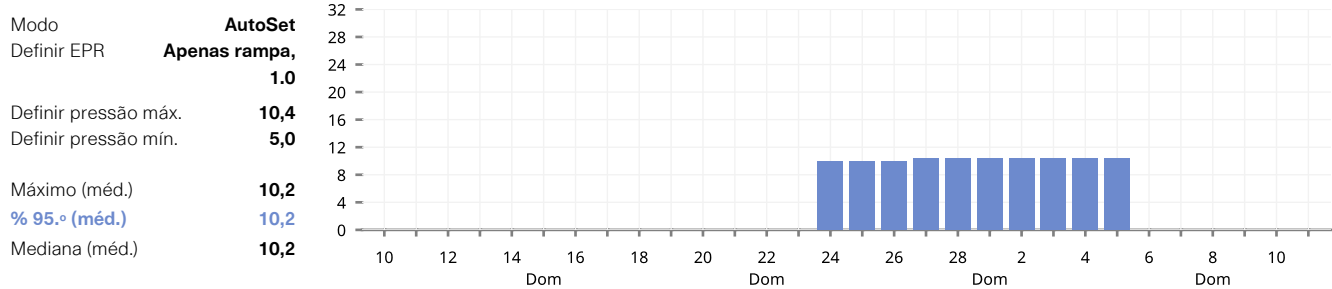

IAH (eventos/hora)

