


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/02/2026 - 01/03/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	52 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 45 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 45 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	9 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/03/2026)	3,062 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292386
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	6.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 7.5	Máximo: 8.0	
Fugas — l/min	Mediana: 1.0	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 20.0	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.2	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

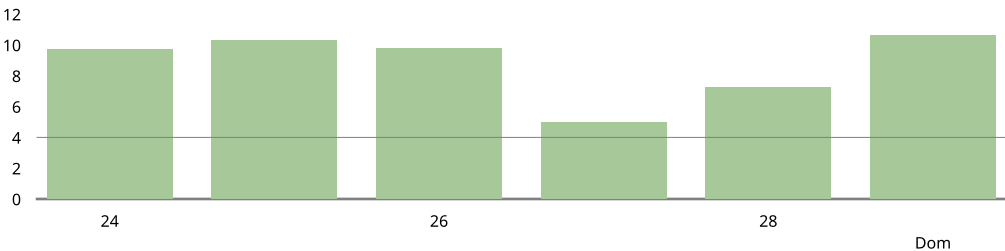


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292386


Utilização (horas)

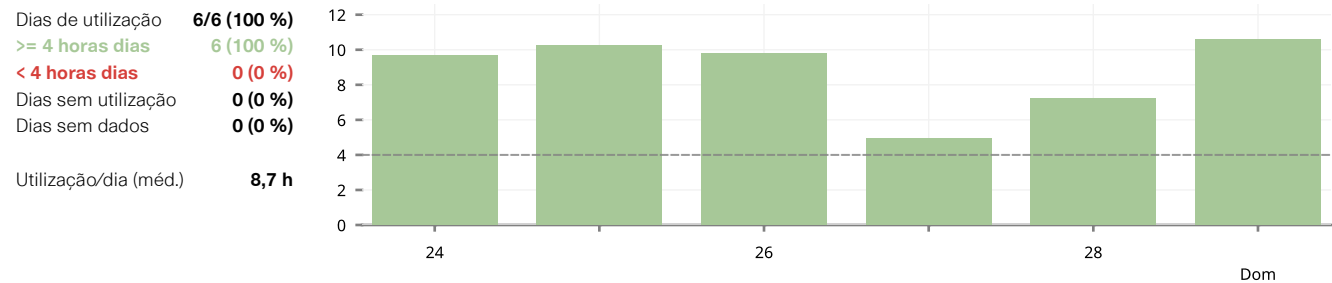

Fuga (l/min)

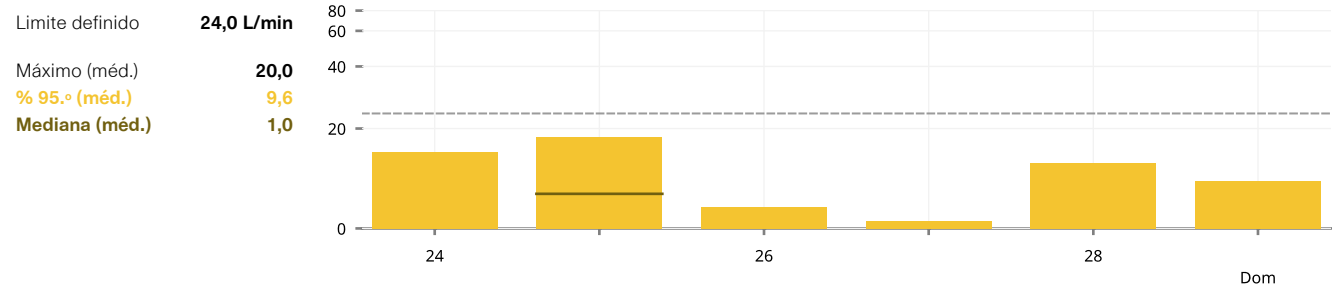

Pressão (cmH2O)

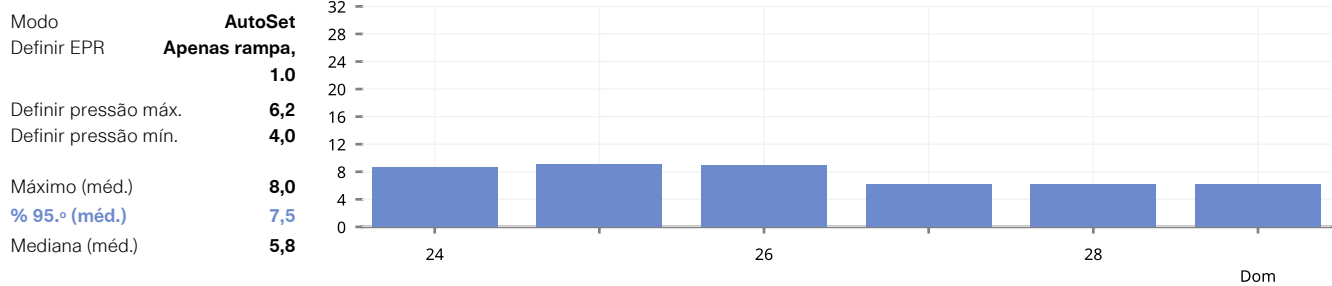

IAH (eventos/hora)

