


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/03/2026 - 11/03/2026
Dias de utilização	4/5 dias (80%)	
>= 4 horas	4 dias (80%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	19 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 58 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 58 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 48 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/03/2026)	3,577 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 11.1	Máximo: 15.3	
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.2	IAH: 1.7	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

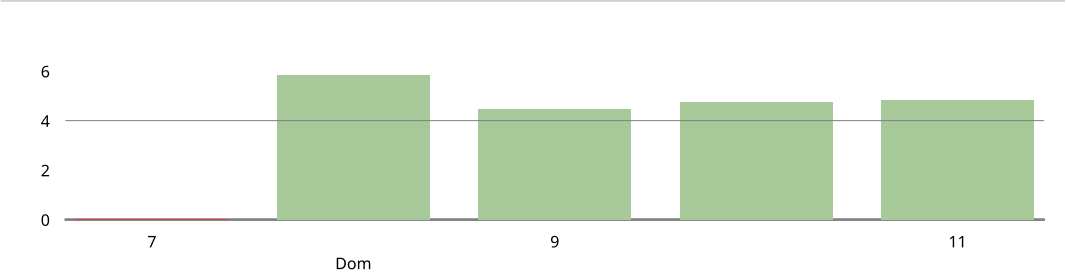

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611


Utilização (horas)

Dias de utilização
>= 4 horas dias
< 4 horas dias
Dias sem utilização
Dias sem dados

Utilização/dia (méd.)

4/5 (80 %)
4 (80 %)
0 (0 %)
1 (20 %)
0 (0 %)


5,0 h

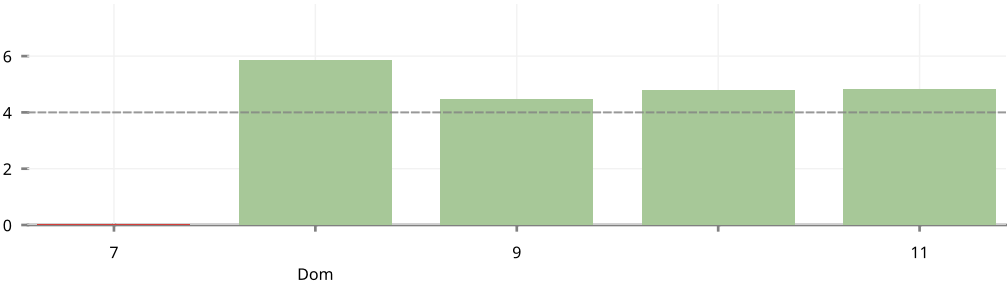

Fuga (l/min)

Limite definido
Máximo (méd.)
% 95.º (méd.)
Mediana (méd.)

24,0 L/min
15,3
11,1
0,0

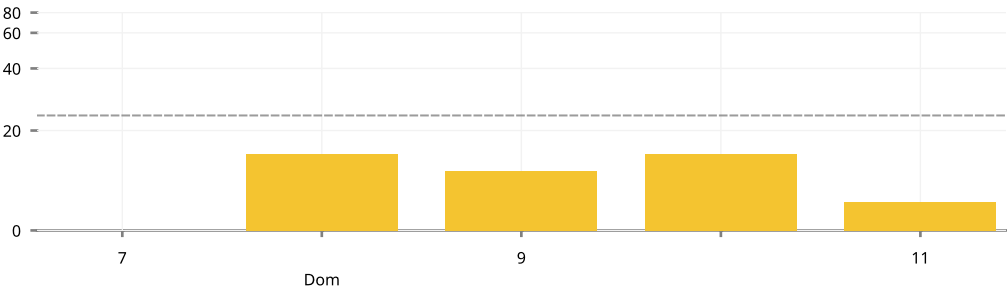


Pressão (cmH2O)

Modo
Definir EPR

Pressão definida

CPAP
Desl.

5,4

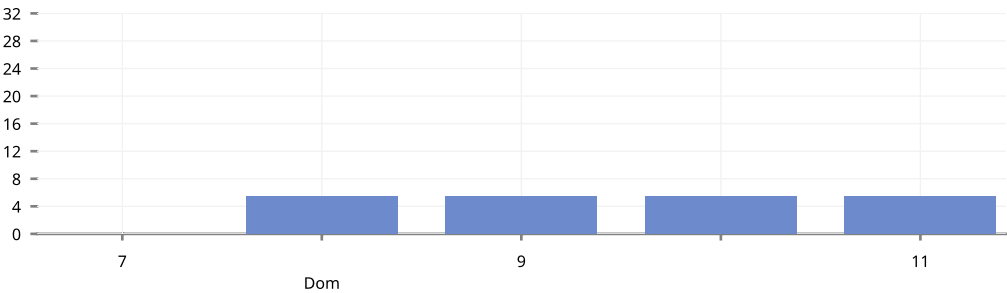

IAH (eventos/hora)

IAH
IH
IA
IAC
IAO
IAD
RERA
%RCS (méd.)

1.7
0.2
1.5
1.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0

