


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/03/2026 - 22/03/2026
Dias de utilização	11/11 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (45%)	
< 4 horas	6 dias (55%)	
Horas de utilização	46 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 14 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026)	3,623 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 8.0	Máximo: 12.0	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.1	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

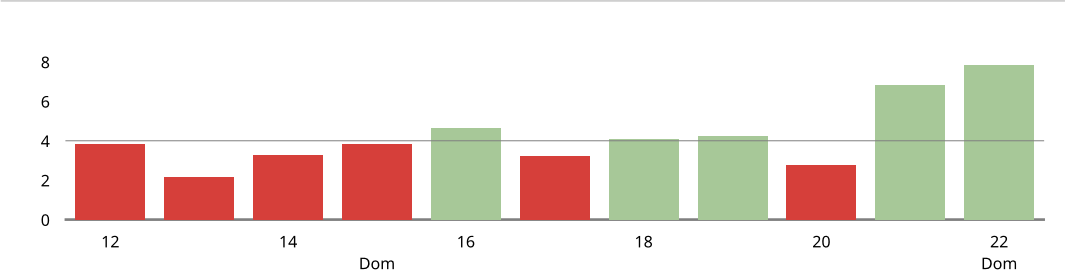

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611

Utilização (horas)

Dias de utilização **11/11 (100 %)**

>= 4 horas dias

5 (45 %)


< 4 horas dias

6 (55 %)

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **4,2 h**

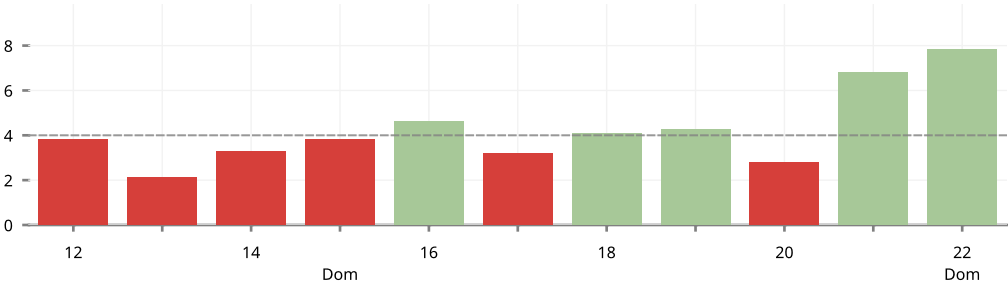


Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **12,0**

% 95.º (méd.) **8,0**

Mediana (méd.) **0,0**

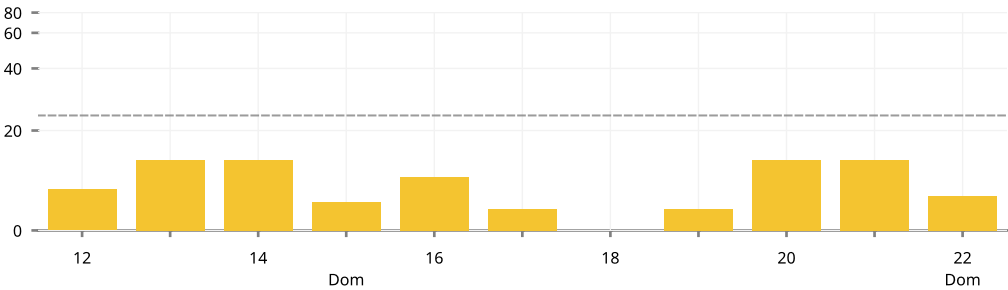


Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Desl.**

Pressão definida **5,4**

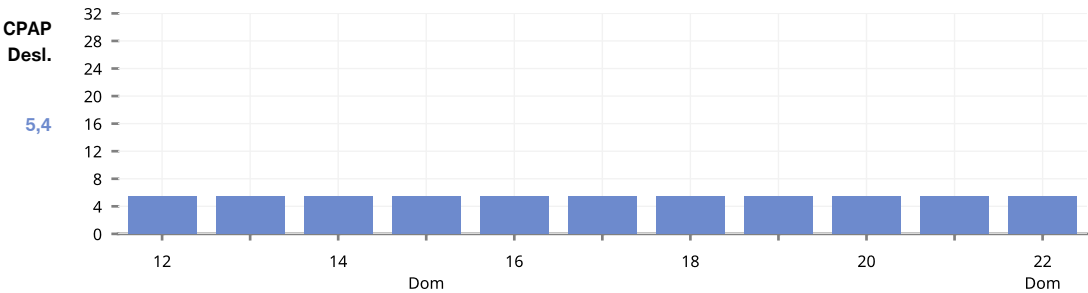

IAH (eventos/hora)

IAH

□

IH

■

IA

■

IAC **0,3**

IAO **0,1**

IAD **0,0**

RERA **0,0**

%RCS (méd.) **0,0**

