


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 12/03/2026 - 22/03/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 7/11 dias (64%)     |                         |
| >= 4 horas                                                   | 4 dias (36%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 3 dias (27%)        |                         |
| Horas de utilização                                          | 31 horas 17 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 2 horas 51 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 4 horas 28 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 5 horas 7 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026) | 2,874 horas         |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22232882350  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 5.4 cmH2O    |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |

| Terapia                                            |                |                     |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 0.0   | Percentil 95.º: 8.6 | Máximo: 90.5 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 2.0        | IH: 0.6             | IAH: 2.6     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.8   | Obstrutiva: 0.6     | Desconhecid  | 0.5 |
| Índice RERA                                        | 0.6            |                     |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                     |              |     |

## Horas de utilização

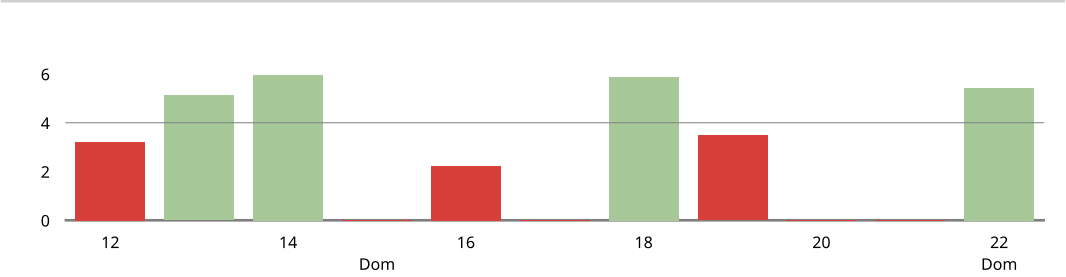


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882350


## Utilização (horas)

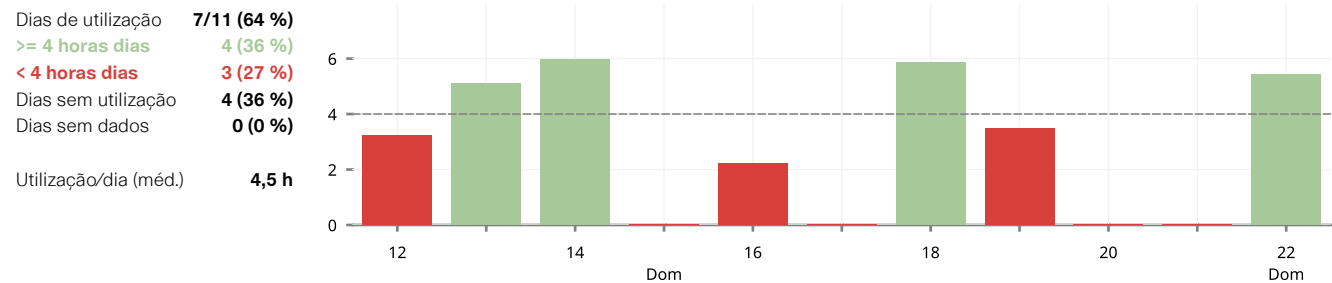

## Fuga (l/min)

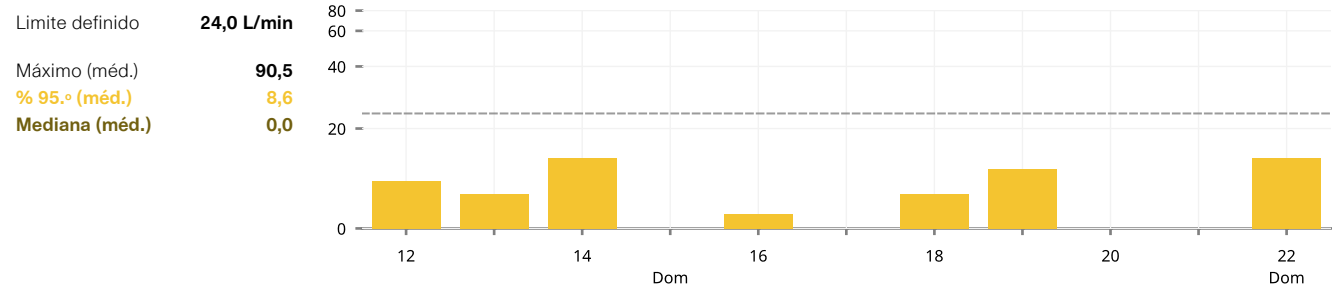

## Pressão (cmH2O)

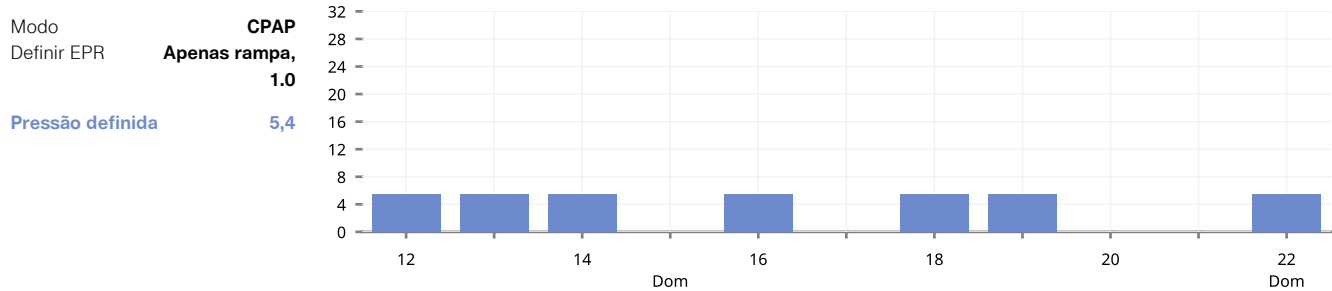

## IAH (eventos/hora)

