


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/03/2026 - 26/03/2026
Dias de utilização		9/9 dias (100%)
>= 4 horas		9 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		51 horas 36 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 44 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 44 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 20 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/03/2026)		4,540 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039537
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7.2 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.2	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.1	
Fugas — l/min	Mediana: 7.9	Percentil 95.º: 19.2	Máximo: 26.5	
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.3	IAH: 1.2	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.3
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

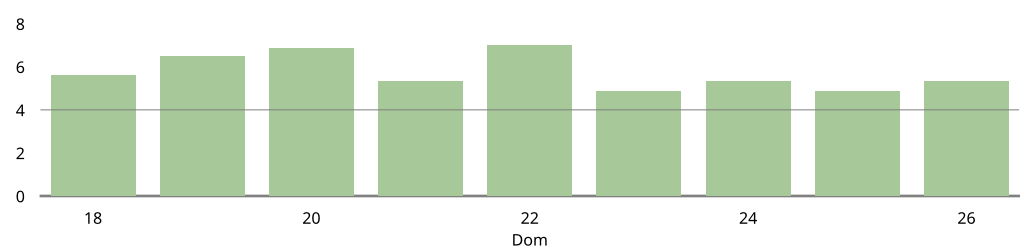


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039537


Utilização (horas)

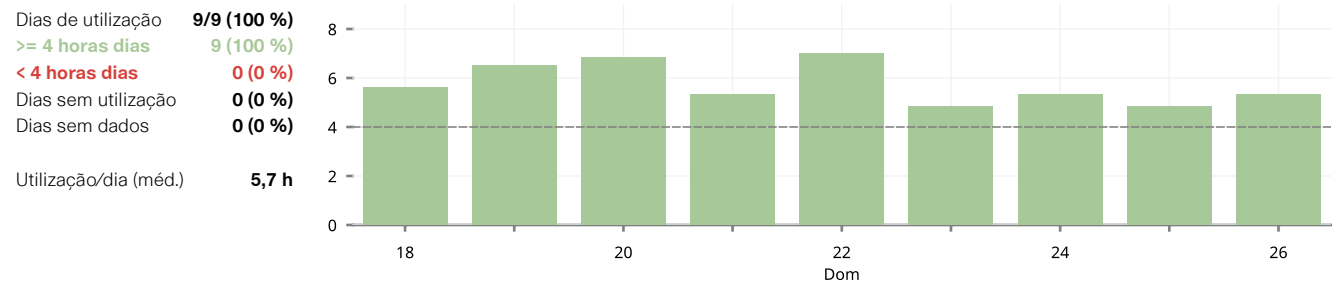

Fuga (l/min)

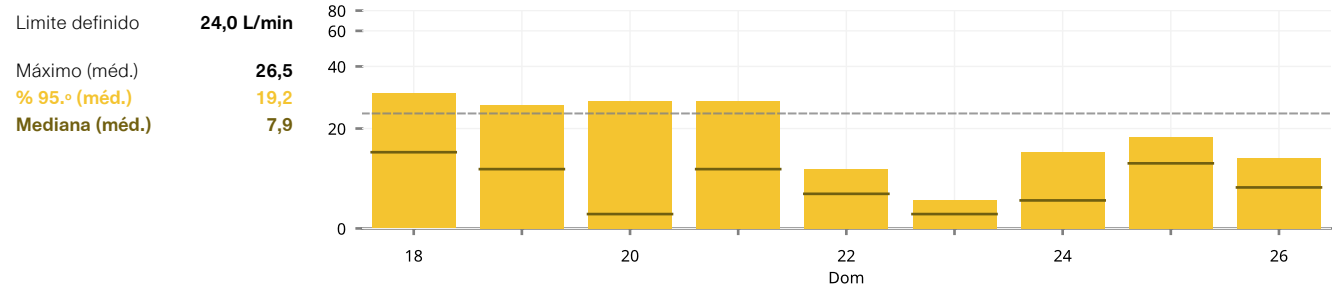

Pressão (cmH2O)

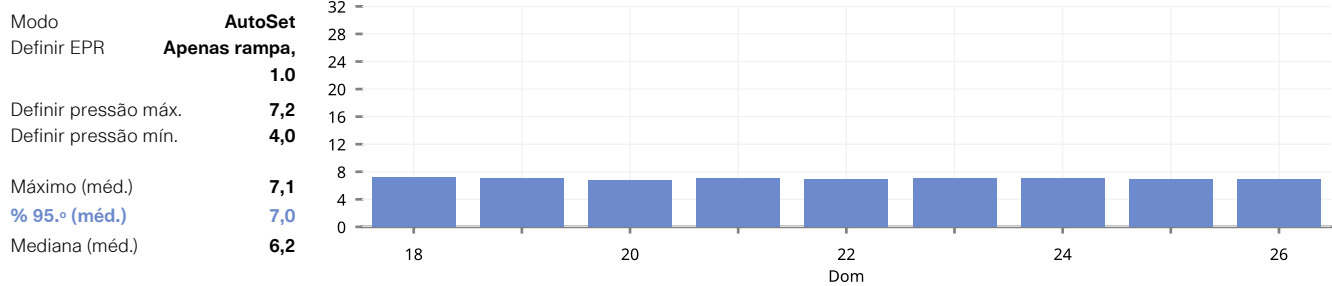

IAH (eventos/hora)

