


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/02/2026 - 08/03/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	22 dias (73%)	
< 4 horas	6 dias (20%)	
Horas de utilização	144 horas 44 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 49 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 13 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)	4,384 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221993036
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 8.4	Máximo: 8.8	
Fugas — l/min	Mediana: 1.6	Percentil 95.º: 15.7	Máximo: 29.8	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.6	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.6	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

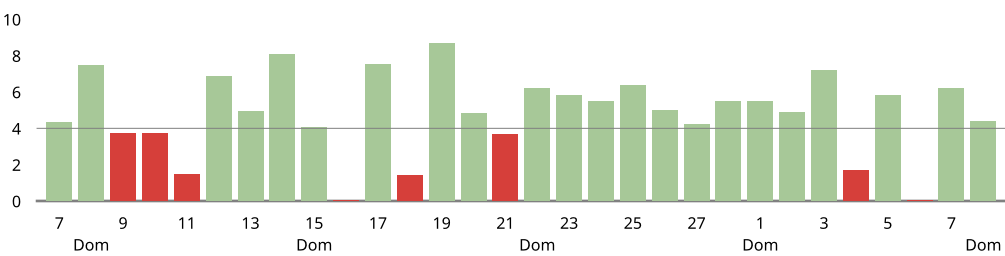


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221993036


Utilização (horas)

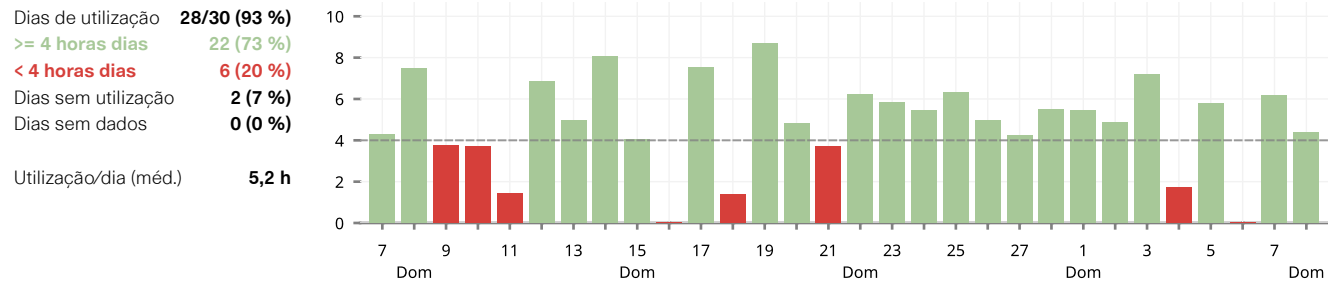

Fuga (l/min)

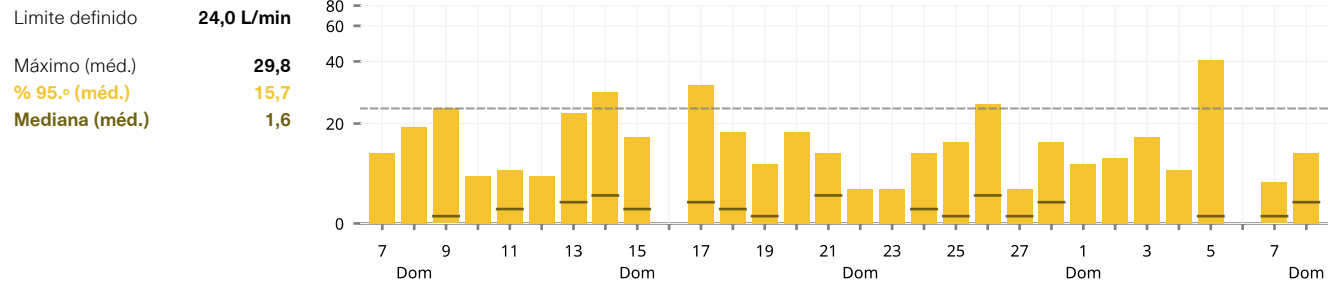

Pressão (cmH2O)

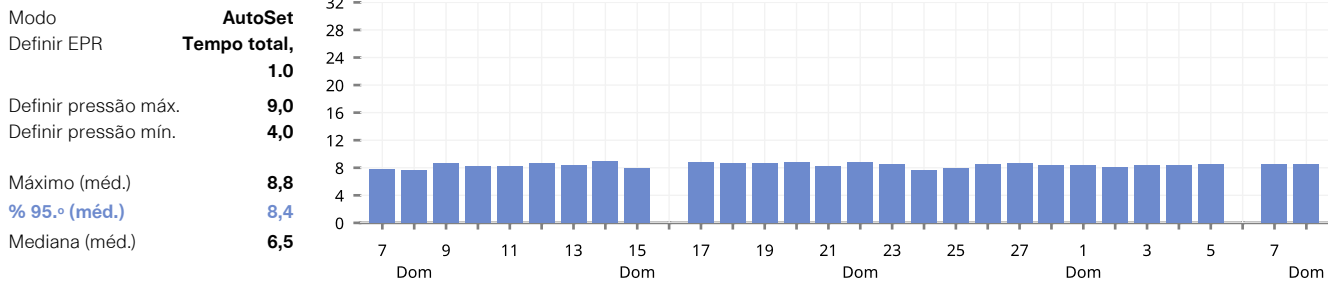

IAH (eventos/hora)

