


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/03/2026 - 31/03/2026
Dias de utilização	11/11 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (64%)	
< 4 horas	4 dias (36%)	
Horas de utilização	49 horas 0 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 27 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 27 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 31/03/2026)	3,158 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221596628
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	6.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 6.6	Máximo: 6.6	
Fugas — l/min	Mediana: 5.9	Percentil 95.º: 18.1	Máximo: 27.9	
Eventos por hora	IA: 2.2	IH: 1.2	IAH: 3.4	
Índice de apneia	Central: 1.3	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	2 minutos (1%)			

Horas de utilização

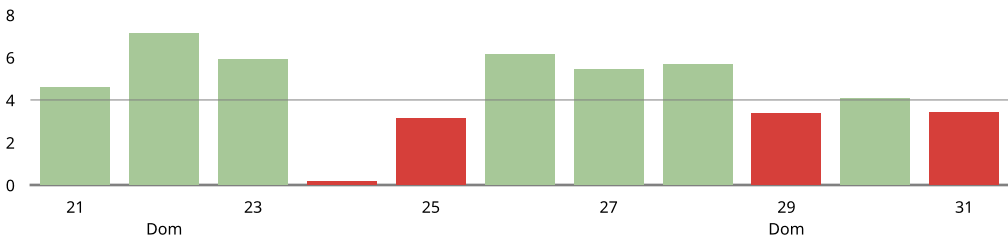


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221596628


Utilização (horas)

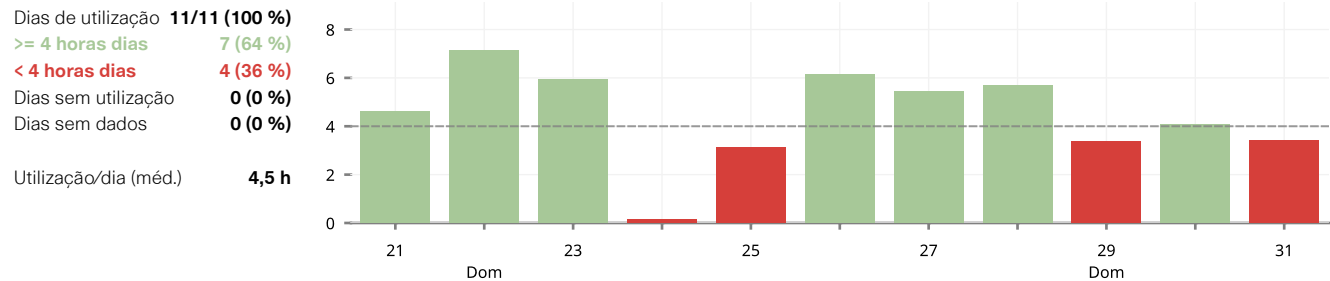

Fuga (l/min)

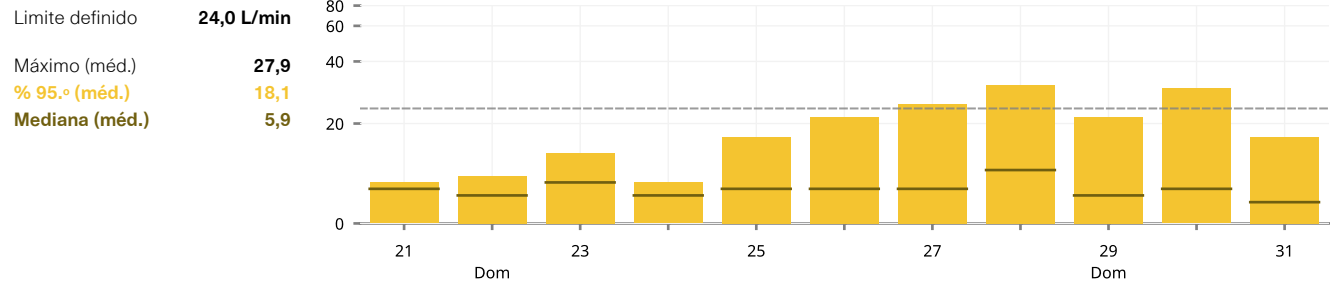

Pressão (cmH2O)

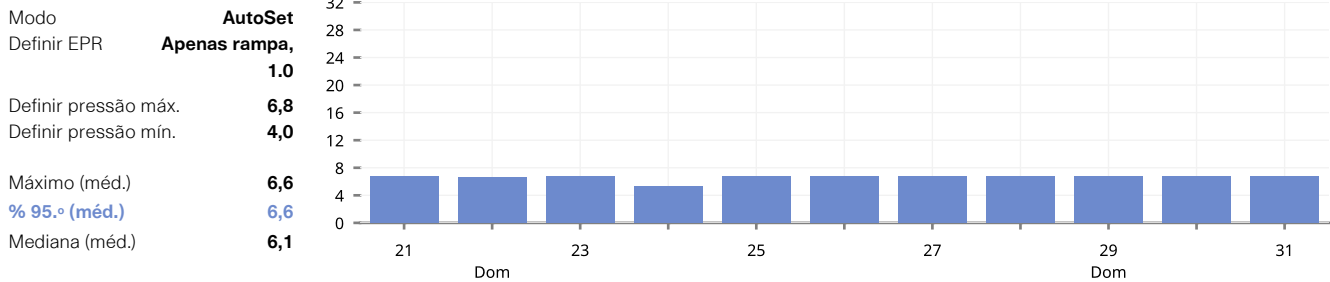

IAH (eventos/hora)

