

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

14/03/2026 - 22/03/2026

Dias de utilização		3/9 dias (33%)	
>= 4 horas		1 dias (11%)	
< 4 horas		2 dias (22%)	
Horas de utilização		10 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)		1 horas 13 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 38 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		2 horas 47 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/03/2026)		2,431 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22232882368	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		10 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 9.9
Fugas — l/min	Mediana: 2.0	Percentil 95.º: 33.6	Máximo: 102.8
Eventos por hora	IA: 8.2	IH: 2.1	IAH: 10.3
Índice de apneia	Central: 7.5	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid 0.4
Índice RERA	0.4		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

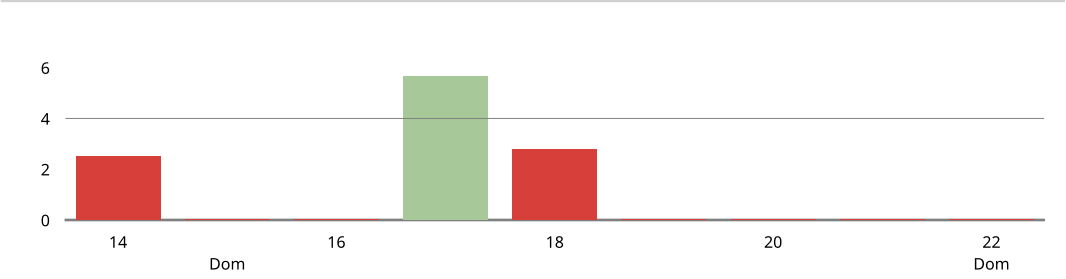


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)

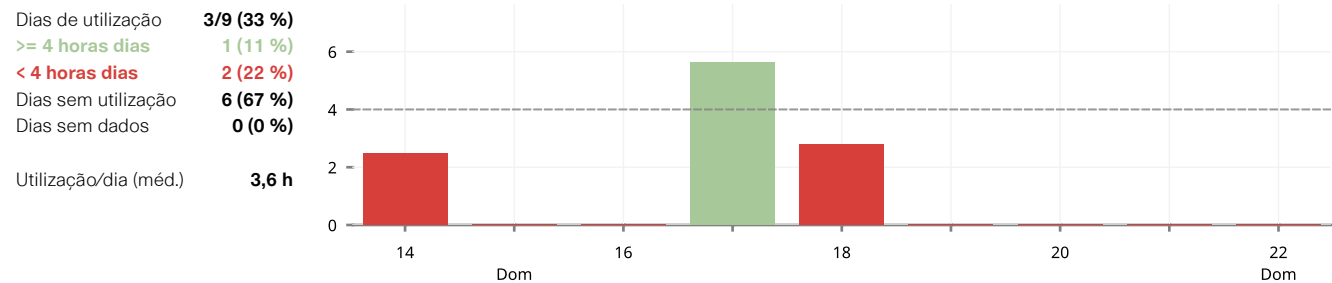

Fuga (l/min)

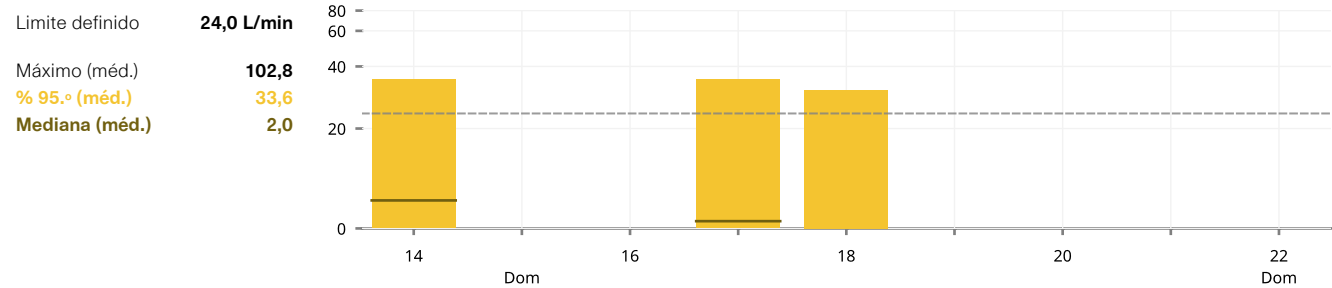

Pressão (cmH2O)

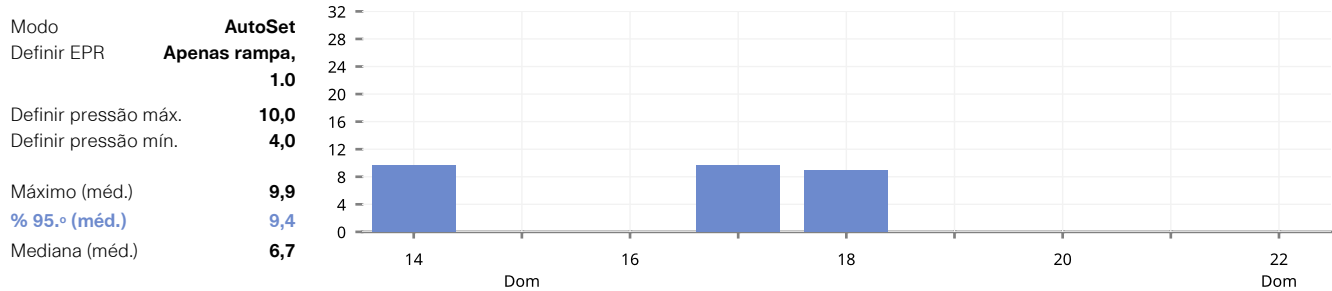

IAH (eventos/hora)

