

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

14/03/2026 - 26/03/2026

Dias de utilização		6/13 dias (46%)	
>= 4 horas		1 dias (8%)	
< 4 horas		5 dias (38%)	
Horas de utilização		19 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)		1 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		3 horas 13 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		2 horas 53 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/03/2026)		2,440 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22232882368	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		10 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.4
Fugas — l/min	Mediana: 1.6	Percentil 95.º: 32.6	Máximo: 79.2
Eventos por hora	IA: 7.0	IH: 2.3	IAH: 9.3
Índice de apneia	Central: 6.2	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid 0.6
Índice RERA	0.4		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

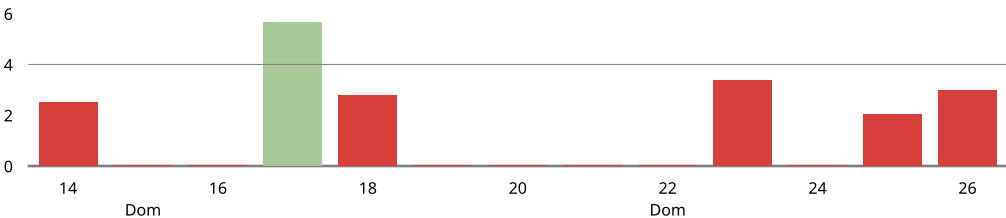


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)

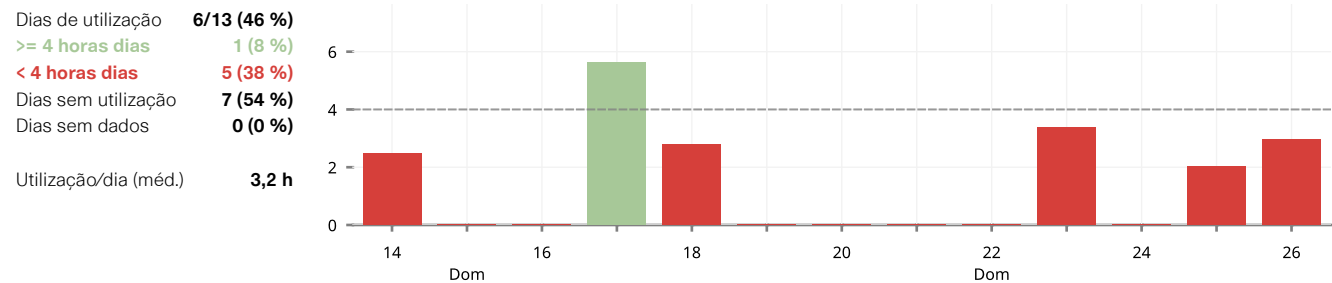

Fuga (l/min)

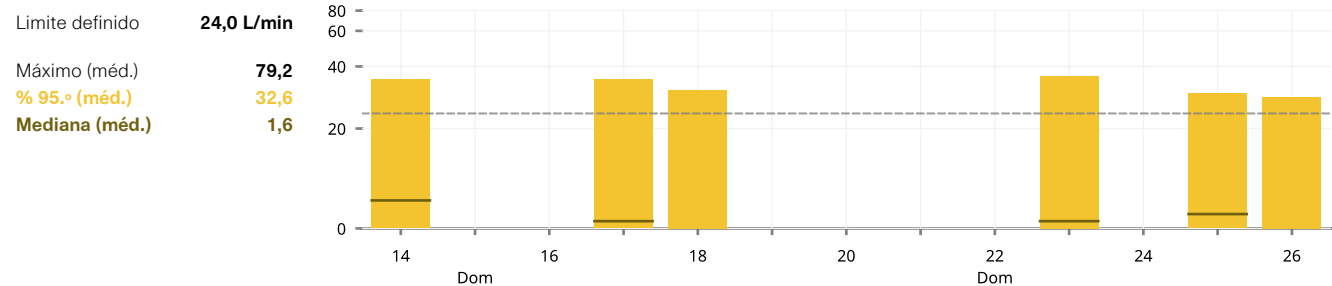

Pressão (cmH2O)

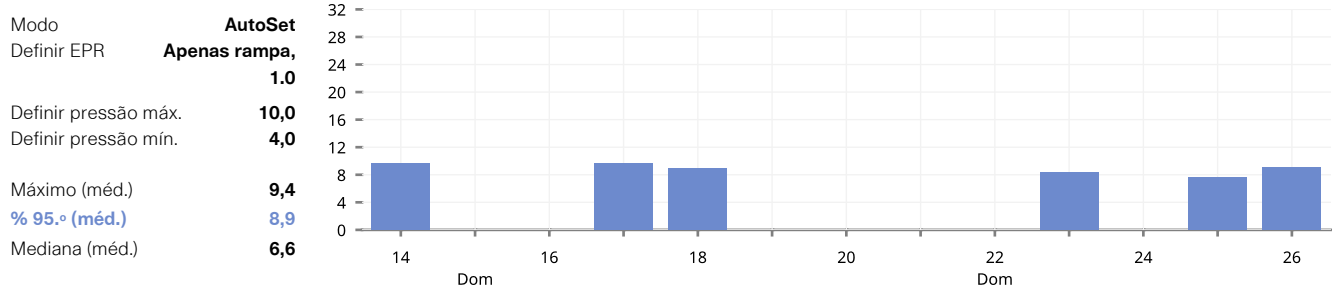

IAH (eventos/hora)

