


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/02/2026 - 23/03/2026
Dias de utilização	20/30 dias (67%)	
>= 4 horas	17 dias (57%)	
< 4 horas	3 dias (10%)	
Horas de utilização	110 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 40 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 30 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 9 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/03/2026)	8,142 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22181526990
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.5	Percentil 95.º: 6.7	Máximo: 6.7	
Fugas — l/min	Mediana: 13.9	Percentil 95.º: 28.7	Máximo: 35.3	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.2	IAH: 0.3	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

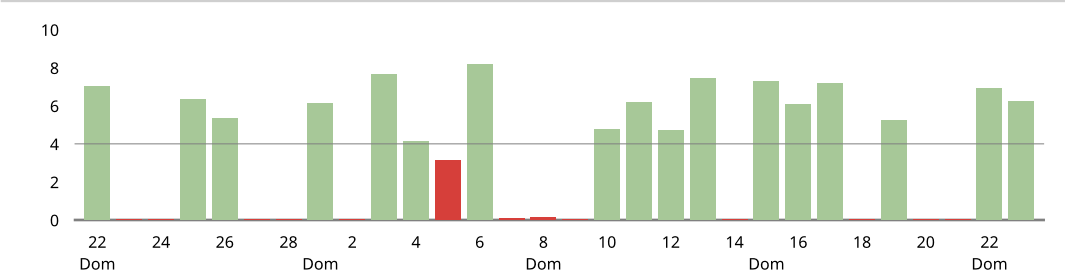


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22181526990


Utilização (horas)

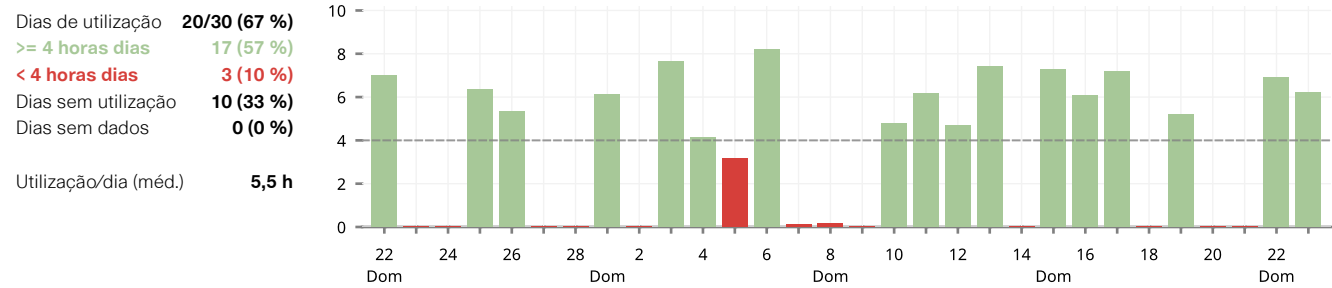

Fuga (l/min)

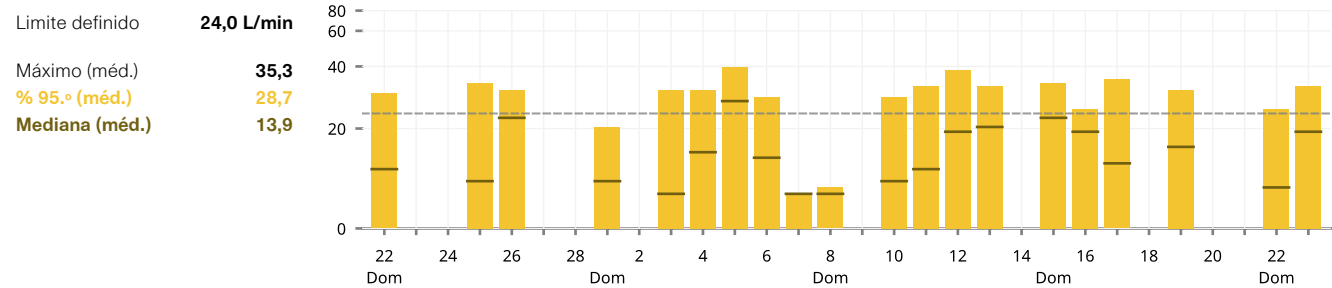

Pressão (cmH2O)

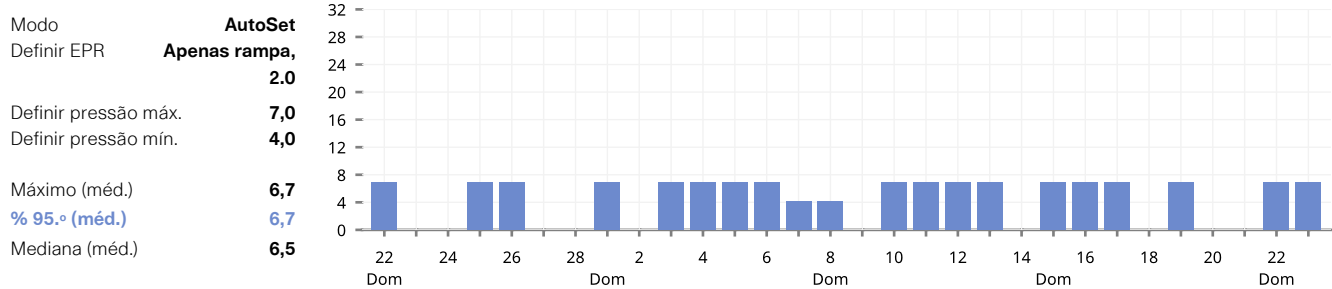

IAH (eventos/hora)

