

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

25/03/2026 - 30/03/2026

Dias de utilização		6/6 dias (100%)	
>= 4 horas		6 dias (100%)	
< 4 horas		0 dias (0%)	
Horas de utilização		53 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)		8 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		8 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		9 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 30/03/2026)		8,886 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22221549735	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		6 cmH2O	
Pressão máx.		10 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 6.9	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 9.4
Fugas — l/min	Mediana: 24.6	Percentil 95.º: 52.0	Máximo: 68.0
Eventos por hora	IA: 1.6	IH: 0.2	IAH: 1.8
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid 0.8
Índice RERA	1.2		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

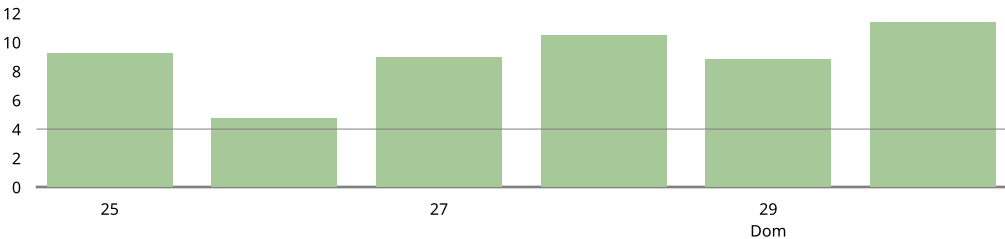

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549735

Utilização (horas)

Dias de utilização **6/6 (100 %)**
>= 4 horas dias **6 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **8,9 h**

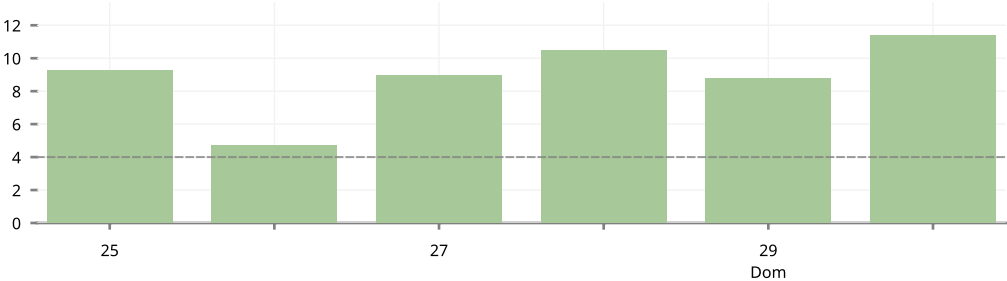

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **68,0**
% 95.º (méd.) **52,0**
Mediana (méd.) **24,6**

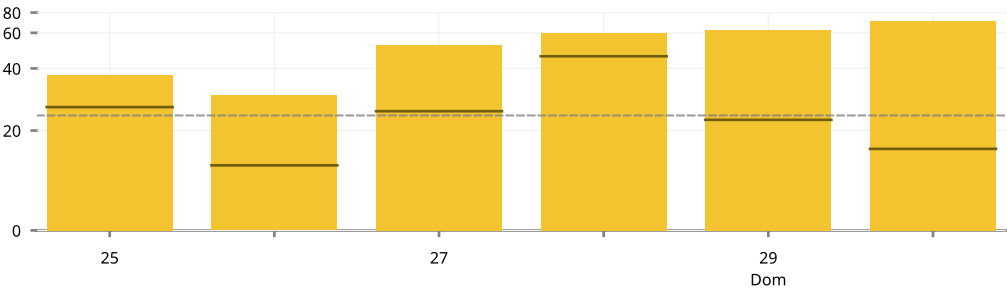


Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1,0**

Definir pressão máx. **10,0**
Definir pressão mín. **6,0**

Máximo (méd.) **9,4**
% 95.º (méd.) **9,0**
Mediana (méd.) **6,9**

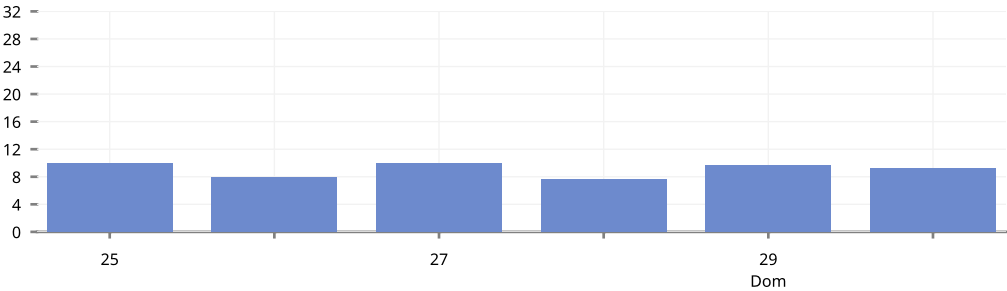

IAH (eventos/hora)

IAH **1,8**
IH **0,2**
IA **1,6**

IAC **0,6**
IAO **0,2**
IAD **0,8**
RERA **1,2**
%RCS (méd.) **0,0**

