


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/03/2026 - 03/04/2026
Dias de utilização		7/10 dias (70%)
>= 4 horas		0 dias (0%)
< 4 horas		7 dias (70%)
Horas de utilização		13 horas 34 minutos
Utilização média (total de dias)		1 horas 21 minutos
Utilização média (dias de utilização)		1 horas 56 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		1 horas 50 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/04/2026)		5,037 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211840650
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.5	Percentil 95.º: 7.6	Máximo: 8.2	
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 9.1	Máximo: 20.9	
Eventos por hora	IA: 3.5	IH: 0.3	IAH: 3.8	
Índice de apneia	Central: 1.6	Obstrutiva: 1.8	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.0
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

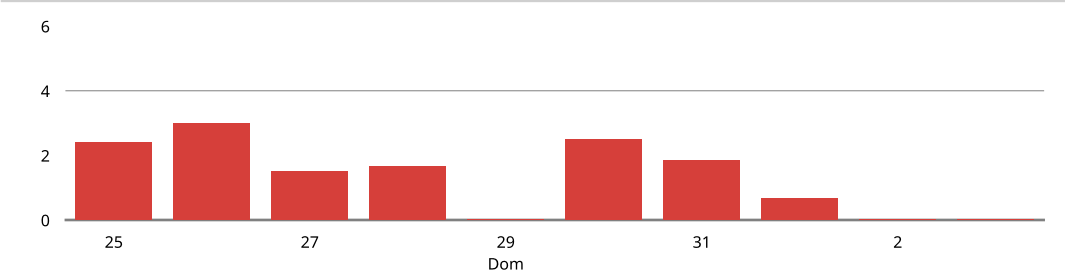


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650


Utilização (horas)

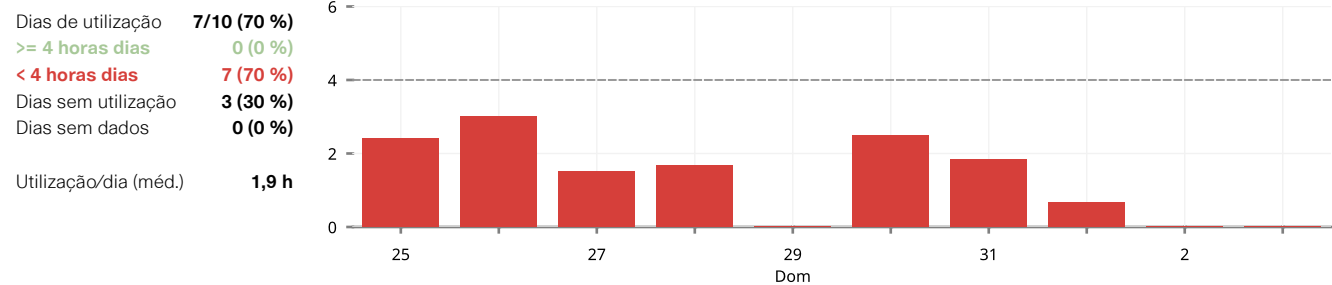

Fuga (l/min)

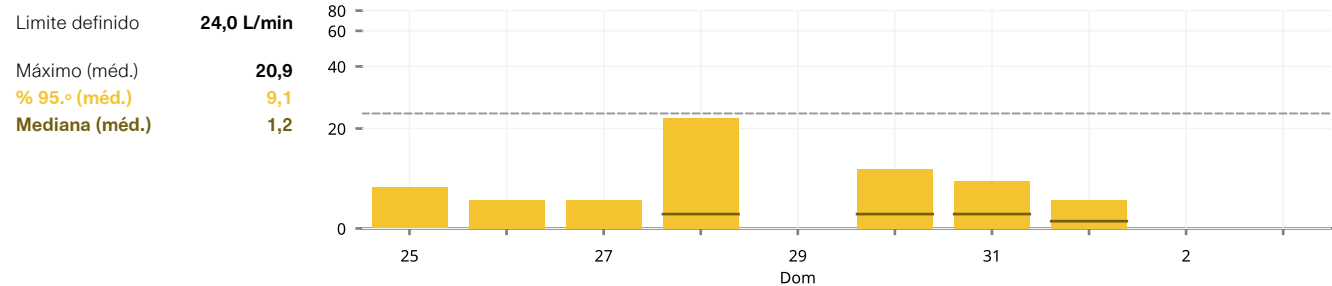

Pressão (cmH2O)

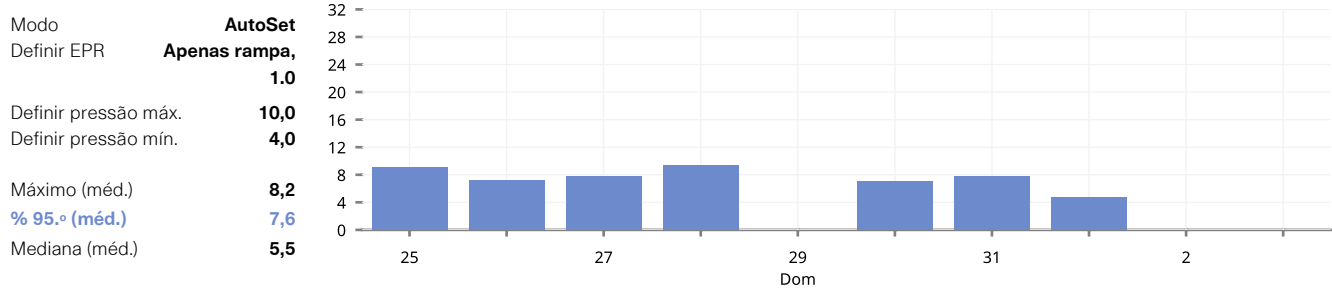

IAH (eventos/hora)

