


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/04/2026 - 06/05/2026
Dias de utilização	12/14 dias (86%)	
>= 4 horas	9 dias (64%)	
< 4 horas	3 dias (21%)	
Horas de utilização	68 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 56 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 45 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/05/2026)	5,147 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211840650
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.2	
Fugas — l/min	Mediana: 1.9	Percentil 95.º: 12.5	Máximo: 29.7	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.0	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

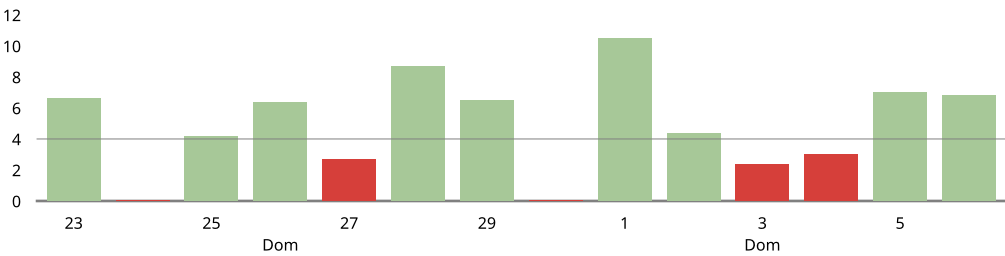


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650


Utilização (horas)

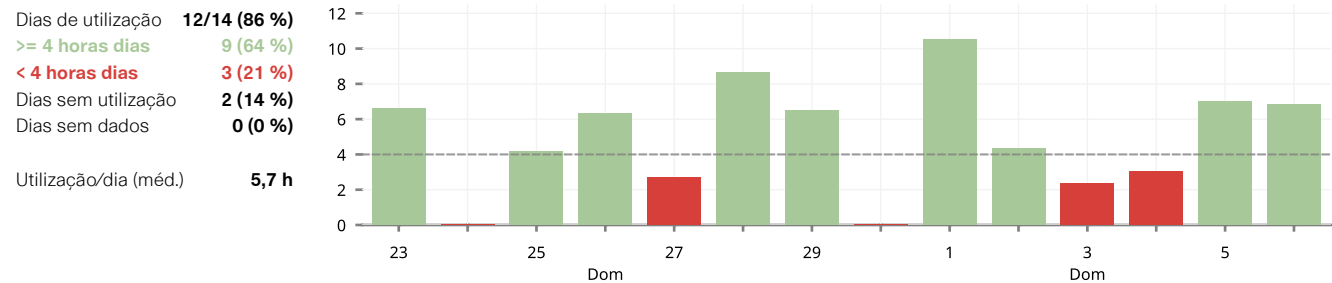

Fuga (l/min)

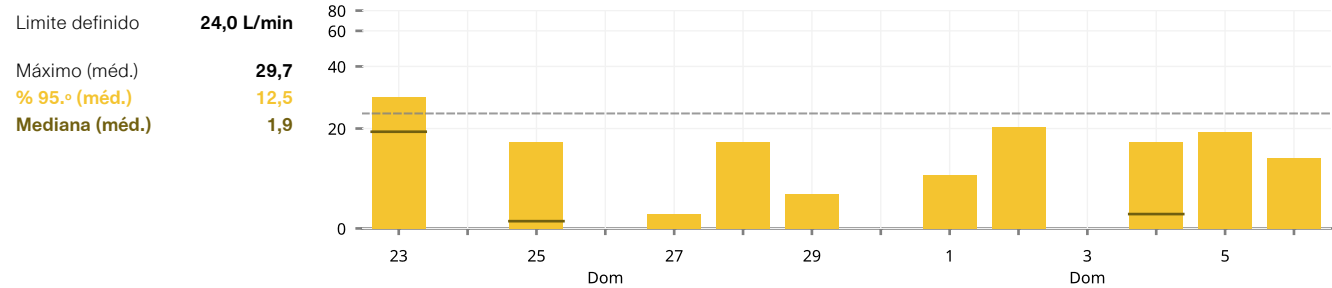

Pressão (cmH2O)

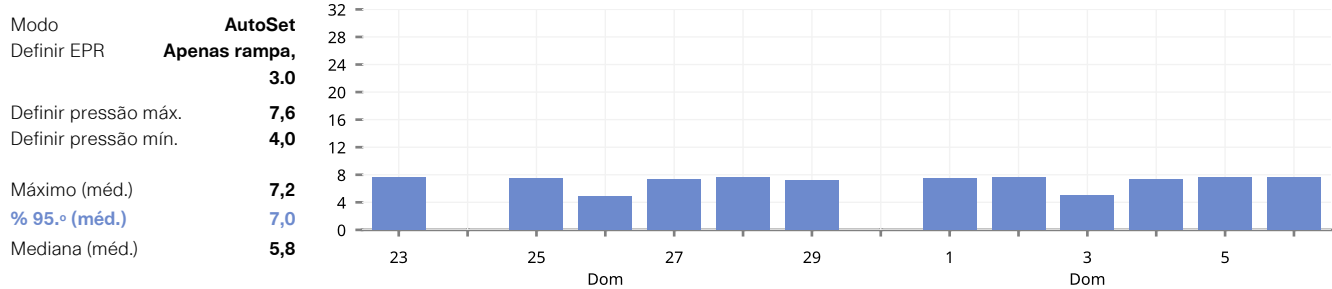

IAH (eventos/hora)

