

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

13/04/2026 - 19/04/2026

Dias de utilização		6/7 dias (86%)	
>= 4 horas		4 dias (57%)	
< 4 horas		2 dias (29%)	
Horas de utilização		29 horas 42 minutos	
Utilização média (total de dias)		4 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 57 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 8 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/04/2026)		5,070 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22211840650	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		4 cmH2O	
Pressão máx.		7.6 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		3	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 5.6	Percentil 95.º: 7.5	Máximo: 7.6
Fugas — l/min	Mediana: 1.6	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 26.4
Eventos por hora	IA: 0.9	IH: 0.2	IAH: 1.1
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.0		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

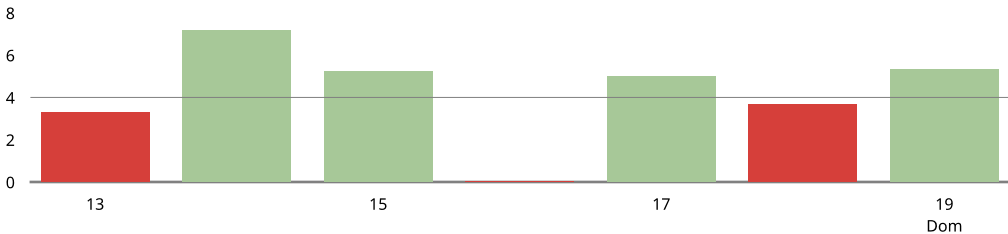


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211840650


Utilização (horas)

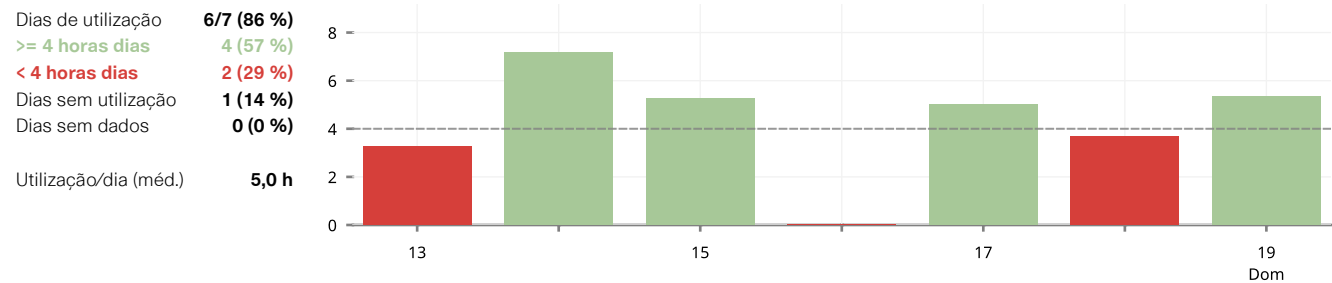

Fuga (l/min)

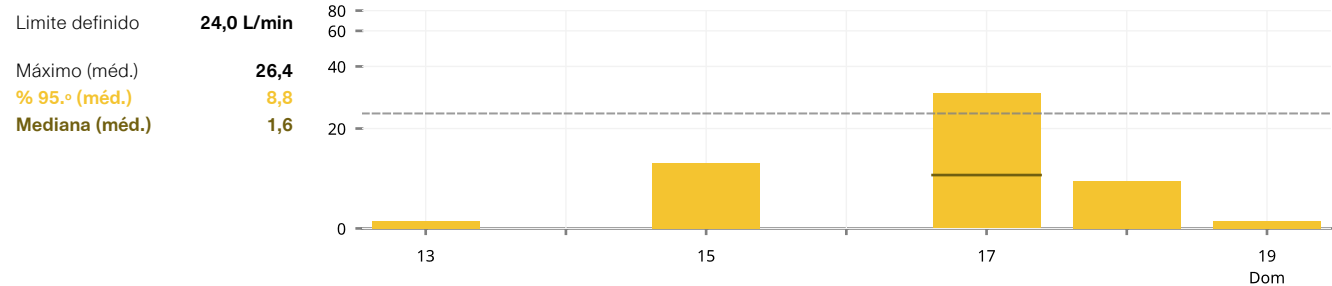

Pressão (cmH2O)

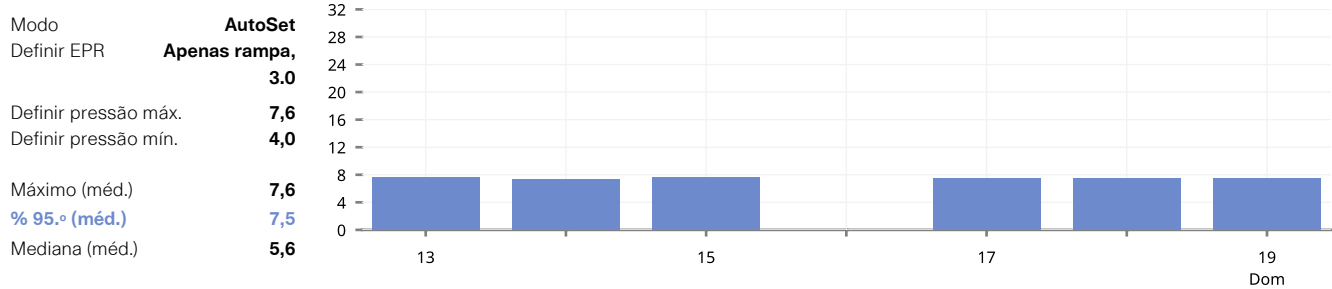

IAH (eventos/hora)

