


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/02/2026 - 24/03/2026
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	270 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	9 horas 1 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	9 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	9 horas 0 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 24/03/2026)	12,157 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22191796034
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.8	Percentil 95.º: 10.7	Máximo: 11.5	
Fugas — l/min	Mediana: 22.0	Percentil 95.º: 34.2	Máximo: 43.0	
Eventos por hora	IA: 2.2	IH: 0.4	IAH: 2.6	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	1.2
Índice RERA	1.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

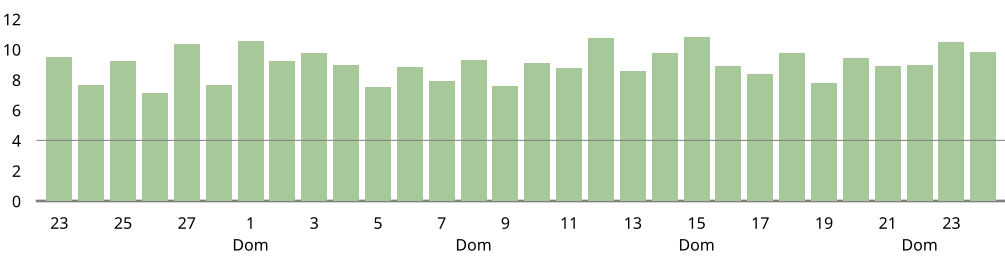


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191796034


Utilização (horas)

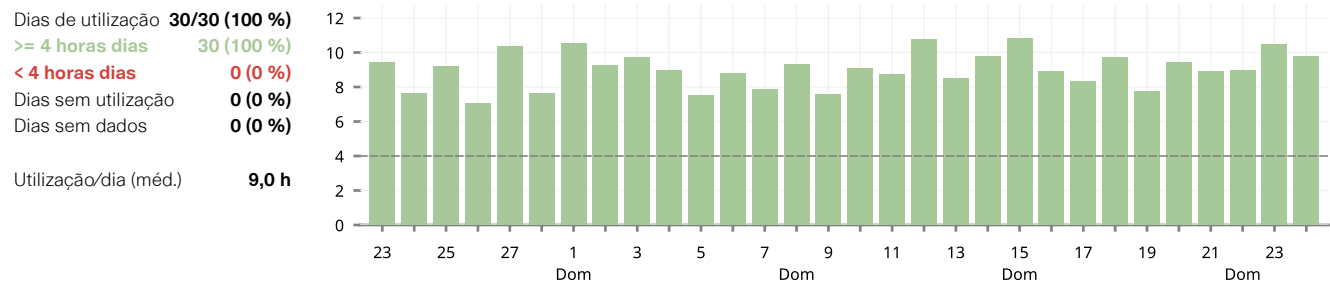

Fuga (l/min)

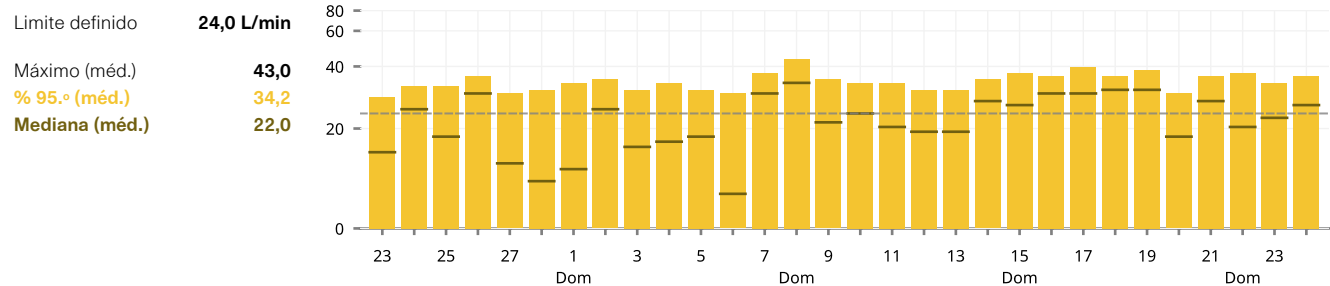

Pressão (cmH2O)

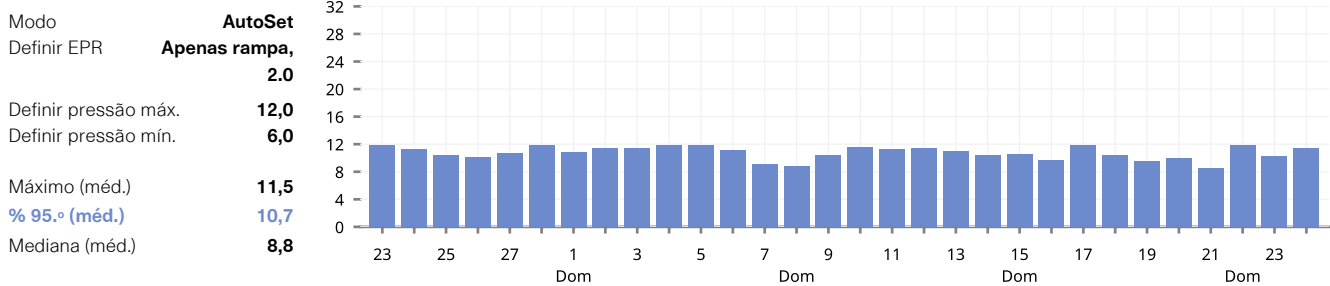

IAH (eventos/hora)

