


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/03/2026 - 01/04/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		44 horas 15 minutos
Utilização média (total de dias)		6 horas 19 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 19 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 13 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/04/2026)		2,248 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221830374
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	12.8 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.6	Percentil 95.º: 12.6	Máximo: 13.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.3	Percentil 95.º: 12.2	Máximo: 23.0	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

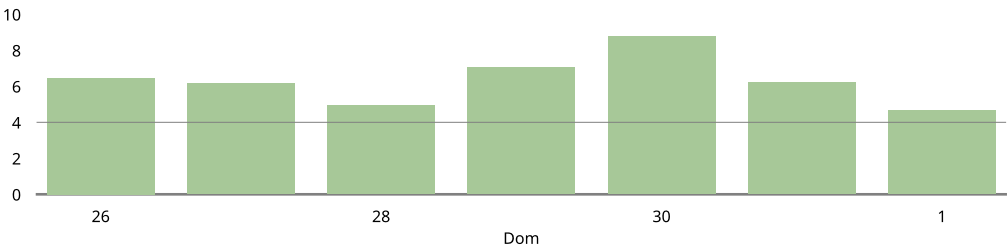


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221830374


Utilização (horas)

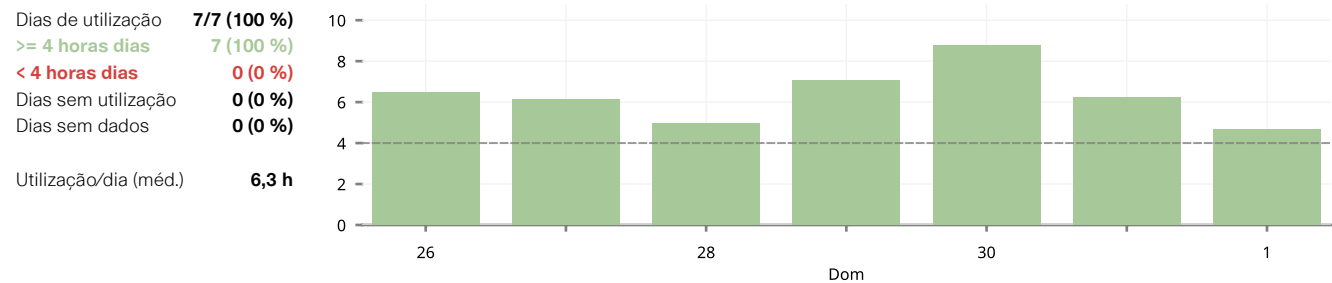

Fuga (l/min)

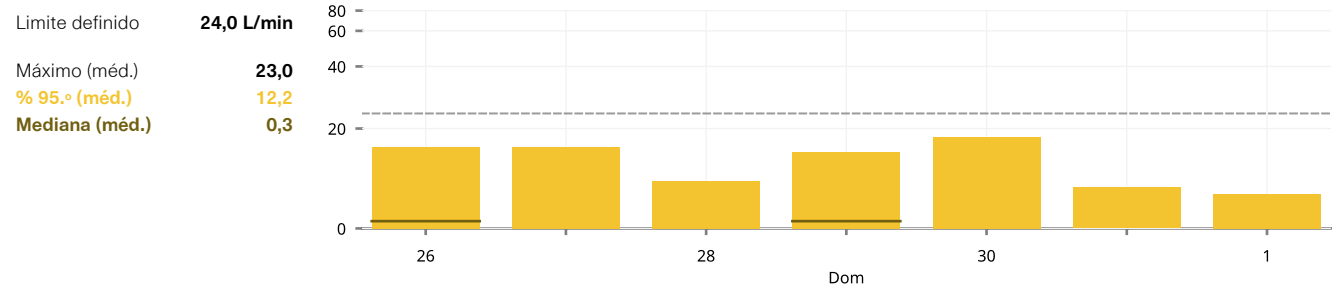

Pressão (cmH2O)

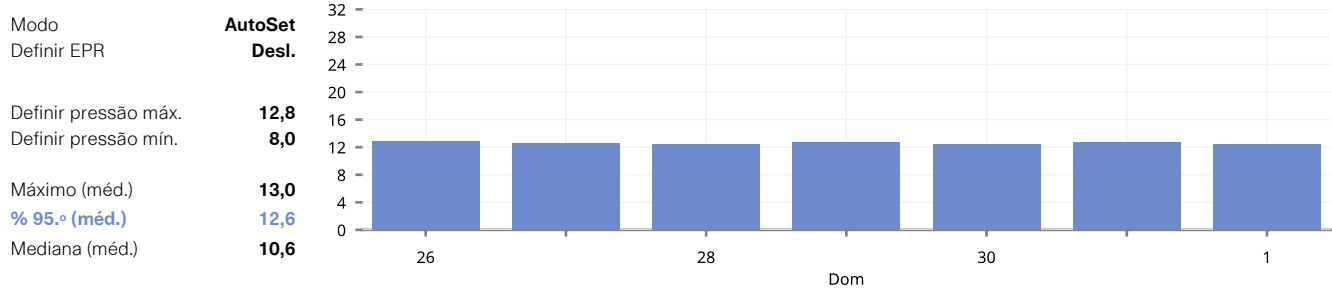

IAH (eventos/hora)

