

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **22 novembro 1967** Idade: **58**
Sexo: **Feminino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **16/04/2026**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

03/04/2026 - 15/04/2026 Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191029349)

Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 2,0 cmH2O
Activar APE: OFF	Activação paciente APE: OFF	Activação subida: OFF
Tempo de rampa: 5,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Resposta: STANDARD
Pressão mínima: 4,0 cmH2O	Pressão máxima: 10,0 cmH2O	
Pressão - cmH2O		
Mediana: 9,2	Percentil 95: 10,0	Máximo/a: 10,0
Fuga - l/min		
Mediana: 0,0	Percentil 95: 7,8	Máximo/a: 25,8
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 0,5	Índice de hipopneia: 1,2	AHI: 1,6
Obstrutiva: 0,2	Central: 0,2	Desconhecida: 0,0
Índice RERA: 0,2	% tempo em CSR: 0,0	
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 8	Dias de Uso < 4 horas : 2	% Dias de Uso >= 4 horas : 61
Dias de não utilização: 3	Totalidade de dias: 13	Horas de utilização: 50:20
Mediana do uso diário: 4:45	Média de uso diário: 3:52	


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


03/04/2026 - 15/04/2026

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191029349)


Pressão

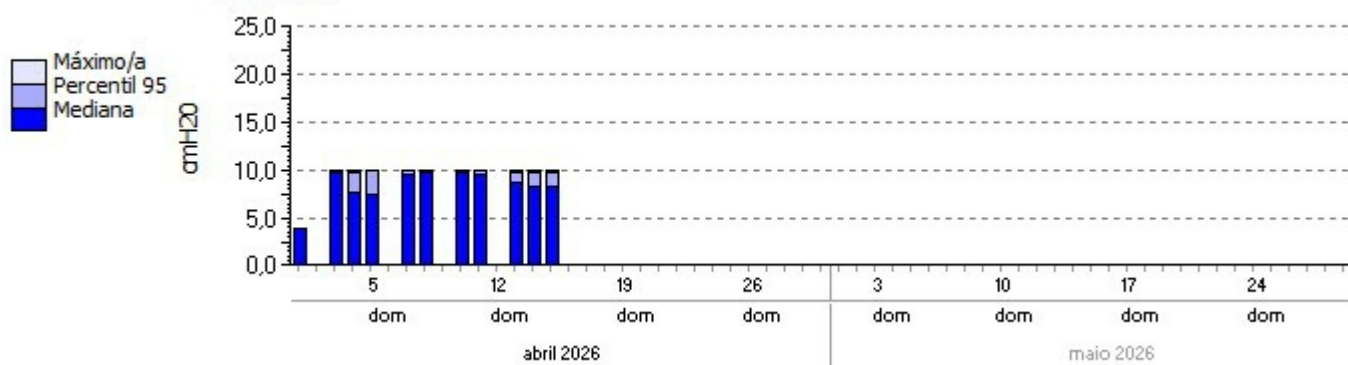


Fuga

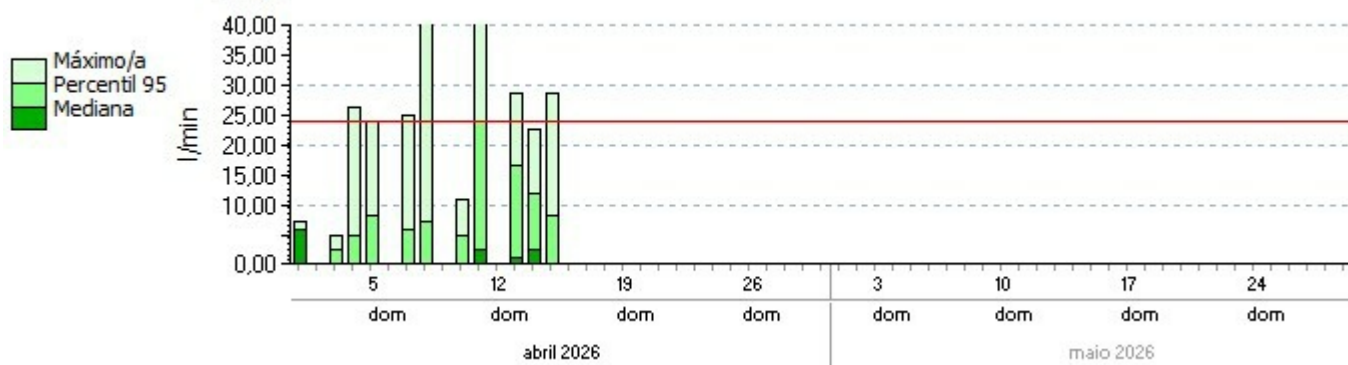

IAH & IA

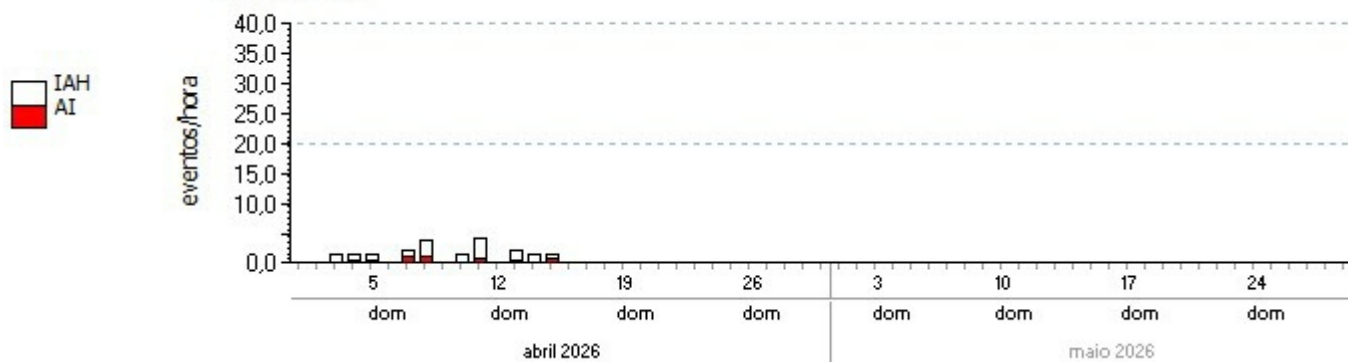

Uso

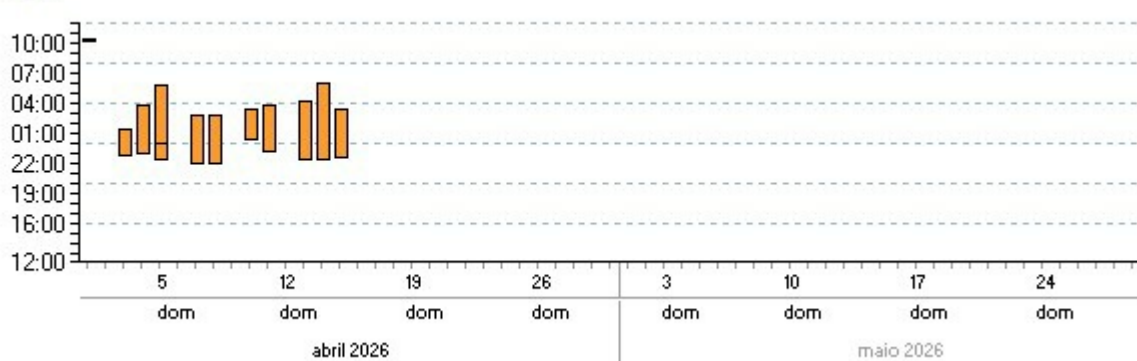

Utilização total e Cheyne-Stokes

