


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/04/2026 - 09/05/2026
Dias de utilização	22/22 dias (100%)	
>= 4 horas	22 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	199 horas 21 minutos	
Utilização média (total de dias)	9 horas 4 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	9 horas 4 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	9 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/05/2026)	4,514 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9.4 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.6	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 9.4	
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 17.1	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.4	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

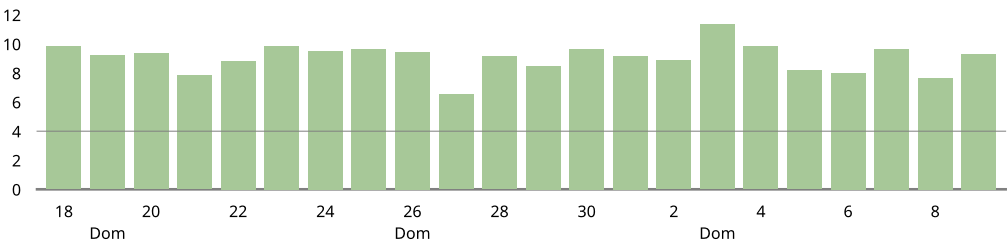


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573


Utilização (horas)

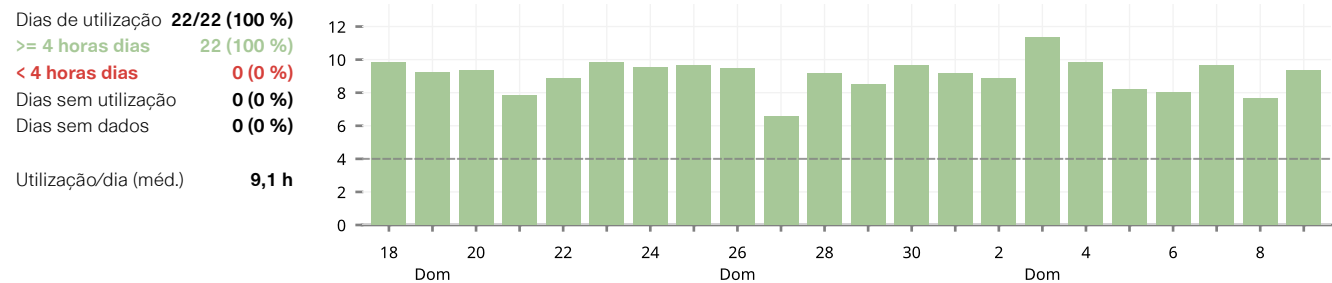

Fuga (l/min)

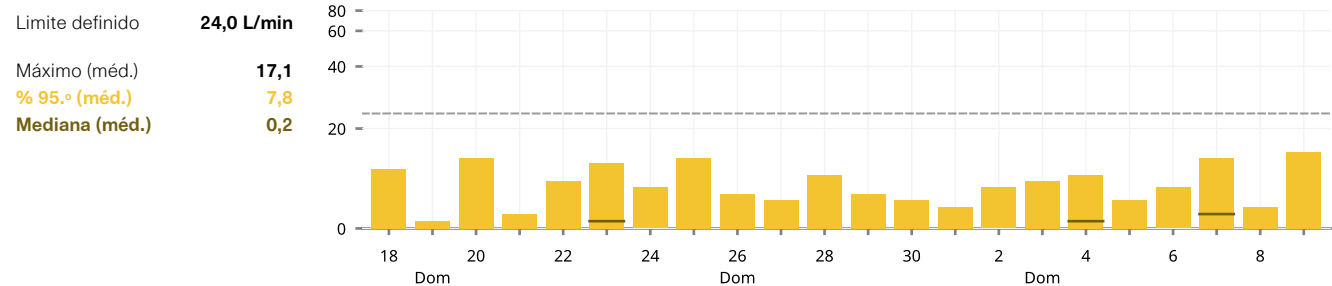

Pressão (cmH2O)

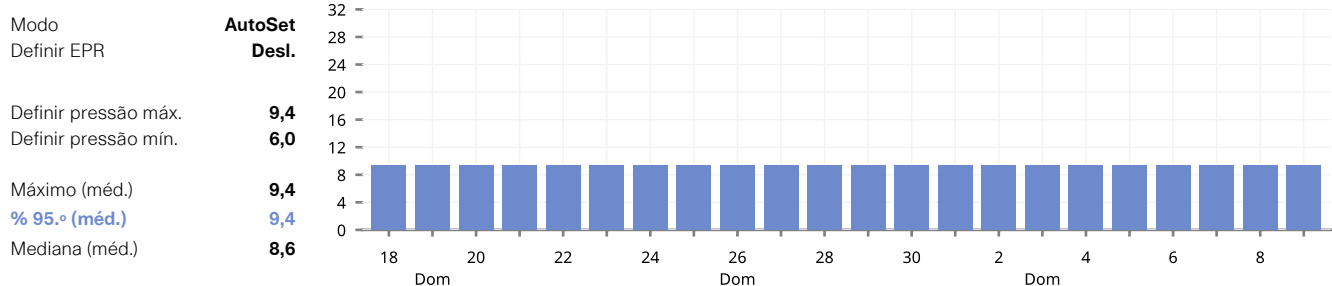

IAH (eventos/hora)

