


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/04/2026 - 16/04/2026
Dias de utilização	15/15 dias (100%)	
>= 4 horas	15 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	124 horas 25 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 18 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 18 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/04/2026)	4,306 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292573
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia					
Pressão — cmH2O	Mediana:	9.4	Percentil 95.º:	11.4	Máximo: 11.8
Fugas — l/min	Mediana:	3.2	Percentil 95.º:	11.8	Máximo: 19.3
Eventos por hora	IA:	0.6	IH:	0.2	IAH: 0.8
Índice de apneia	Central:	0.1	Obstrutiva:	0.4	Desconhecid 0.0
Índice RERA					0.8
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)

Horas de utilização

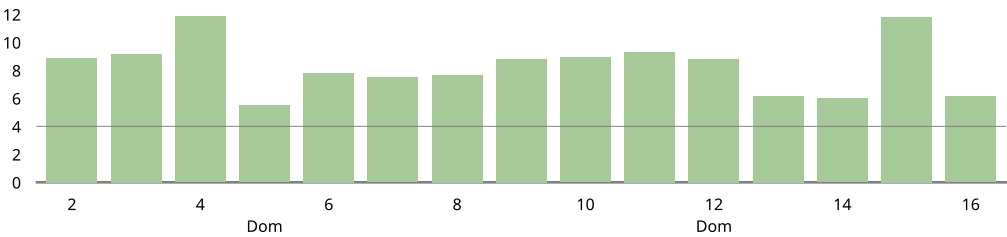

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292573

Utilização (horas)


Dias de utilização **15/15 (100 %)**
>= 4 horas dias **15 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **8,3 h**

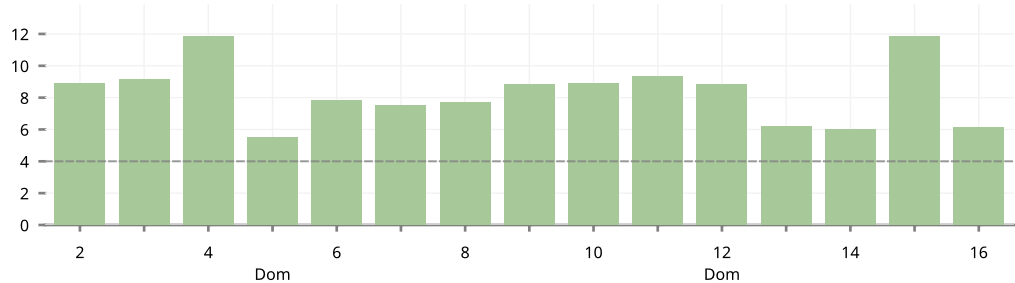

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **19,3**
% 95.º (méd.) **11,8**
Mediana (méd.) **3,2**

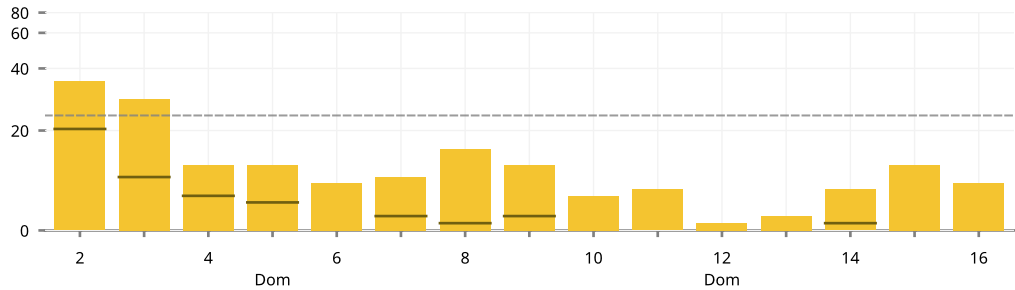


Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Desl.**

Definir pressão máx. **12,0**
Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **11,8**
% 95.º (méd.) **11,4**
Mediana (méd.) **9,4**

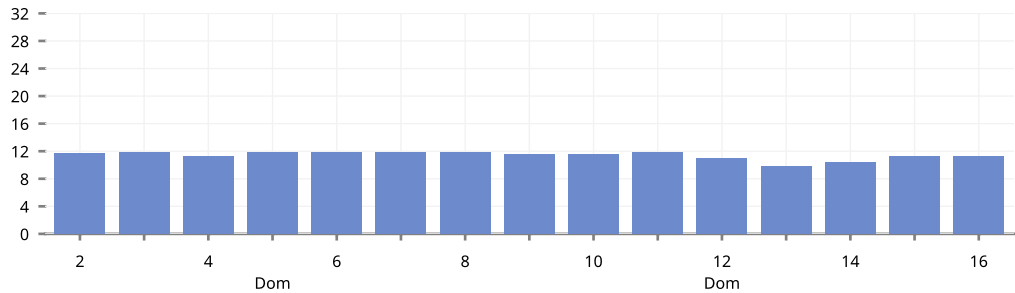

IAH (eventos/hora)

IAH ☐
IH ☐
IA ☐
IAC **0,1**
IAO **0,4**
IAD **0,0**
RERA **0,8**
%RCS (méd.) **0,0**

