


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		02/04/2026 - 13/04/2026
Dias de utilização	12/12 dias (100%)	
>= 4 horas	8 dias (67%)	
< 4 horas	4 dias (33%)	
Horas de utilização	51 horas 4 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 19 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/04/2026)	2,941 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882350
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 36.0	Máximo: 62.2	
Eventos por hora	IA: 1.7	IH: 1.0	IAH: 2.7	
Índice de apneia	Central: 0.6	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.8
Índice RERA	2.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

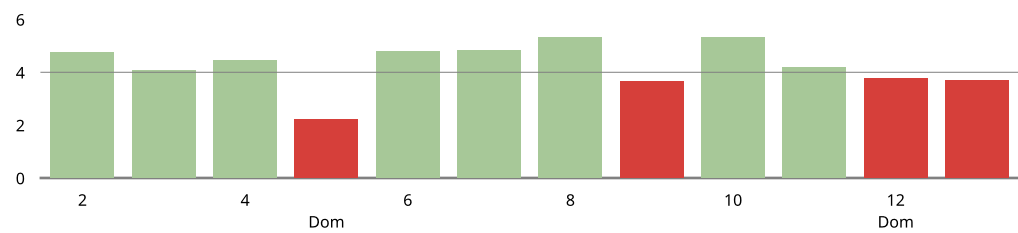


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882350


Utilização (horas)

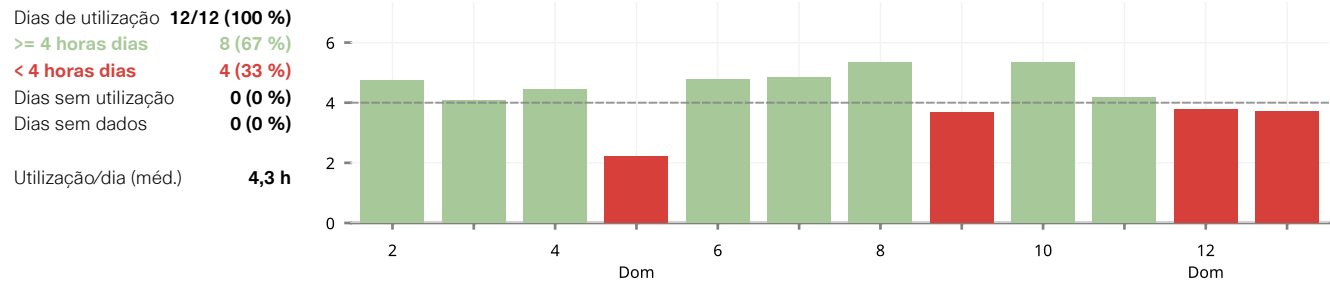

Fuga (l/min)

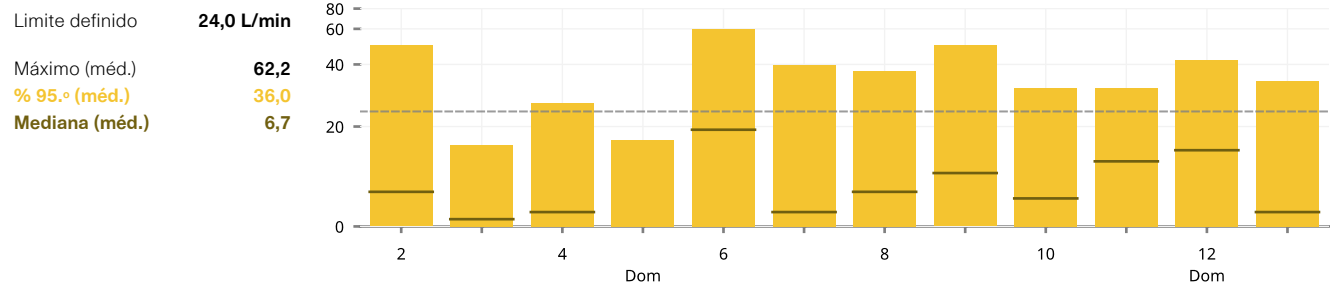

Pressão (cmH2O)

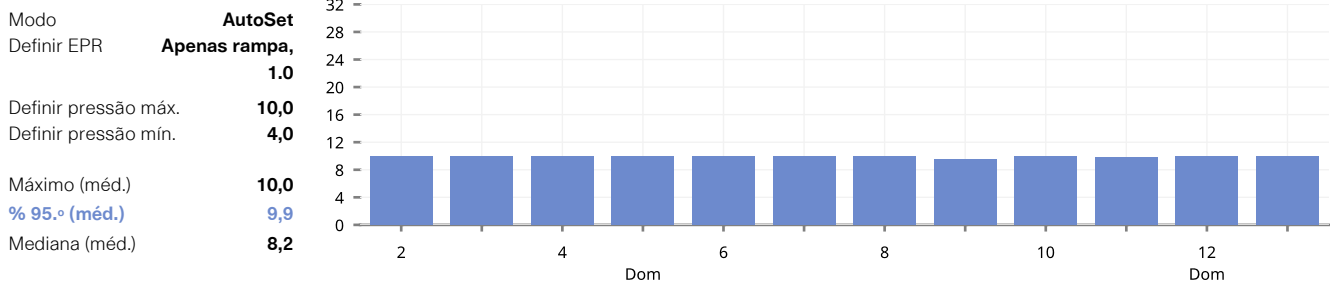

IAH (eventos/hora)

