


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/04/2026 - 08/04/2026
Dias de utilização		6/6 dias (100%)
>= 4 horas		5 dias (83%)
< 4 horas		1 dias (17%)
Horas de utilização		30 horas 46 minutos
Utilização média (total de dias)		5 horas 8 minutos
Utilização média (dias de utilização)		5 horas 8 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 30 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/04/2026)		3,127 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.9	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 3.8	Percentil 95.º: 15.4	Máximo: 26.2	
Eventos por hora	IA: 4.9	IH: 4.9	IAH: 9.8	
Índice de apneia	Central: 4.9	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA				1.7
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização

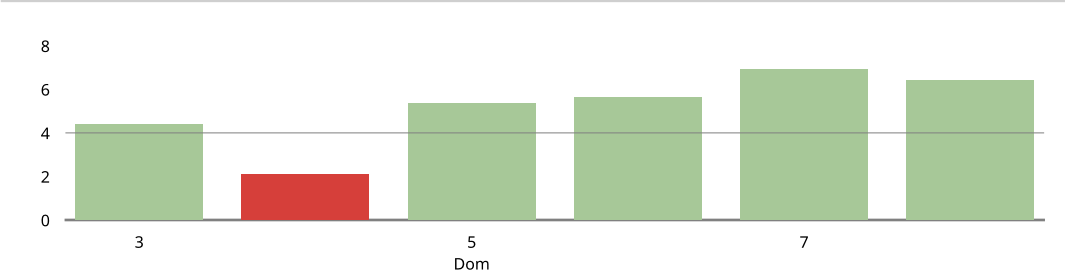

Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638

Utilização (horas)

Dias de utilização

6/6 (100 %)

>= 4 horas dias

5 (83 %)

< 4 horas dias

1 (17 %)

Dias sem utilização


0 (0 %)

Dias sem dados

0 (0 %)

Utilização/dia (méd.)

5,1 h

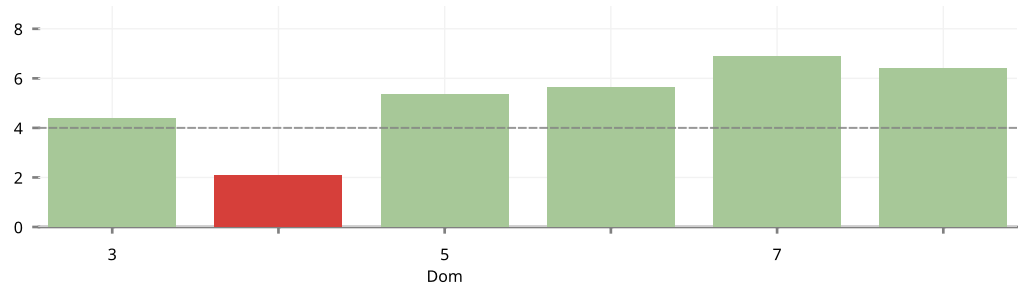

Fuga (l/min)

Limite definido

24,0 L/min

Máximo (méd.)


26,2

% 95.º (méd.)

15,4

Mediana (méd.)

3,8

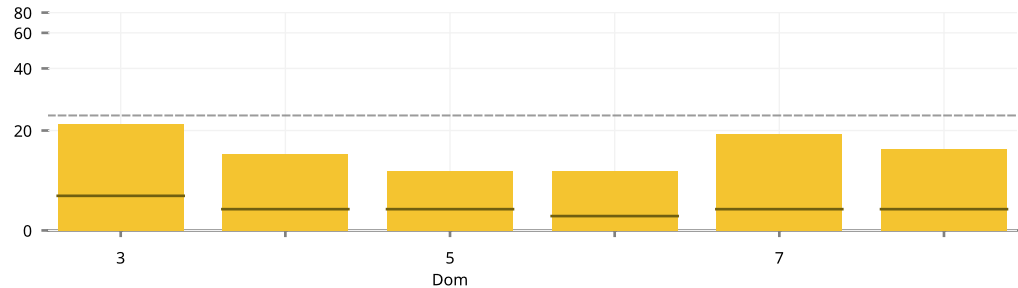

Pressão (cmH2O)

Modo

AutoSet

Definir EPR

Apenas rampa, 2.0

Definir pressão máx.

10,0

Definir pressão mín.

4,0

Máximo (méd.)


10,0

% 95.º (méd.)

10,0

Mediana (méd.)

9,9

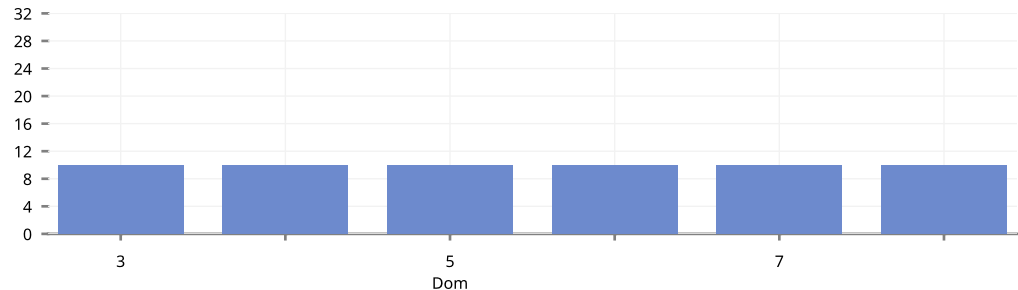

IAH (eventos/hora)

IAH

9.8

IH

4.9

IA

4.9

IAC

4.9

IAO

0.0

IAD

0.0

RERA

1.7

%RCS (méd.)

0.0

