


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/04/2026 - 15/04/2026
Dias de utilização	13/13 dias (100%)	
>= 4 horas	11 dias (85%)	
< 4 horas	2 dias (15%)	
Horas de utilização	75 horas 36 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 49 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 49 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/04/2026)	3,172 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.9	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 4.3	Percentil 95.º: 18.8	Máximo: 30.1	
Eventos por hora	IA: 3.3	IH: 4.3	IAH: 7.6	
Índice de apneia	Central: 3.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

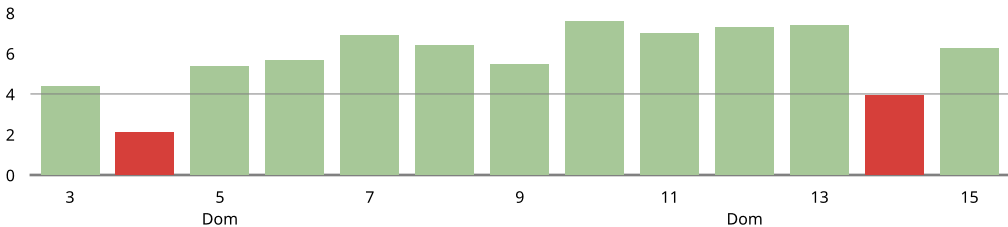

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638

Utilização (horas)


Dias de utilização **13/13 (100 %)**
>= 4 horas dias **11 (85 %)**
< 4 horas dias **2 (15 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **5,8 h**

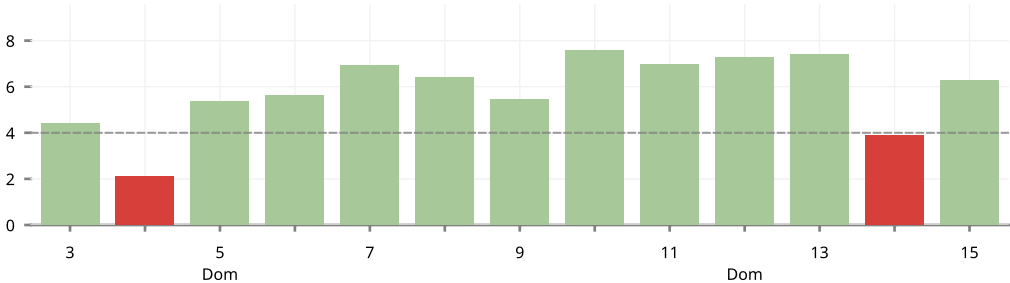

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **30,1**
% 95.º (méd.) **18,8**
Mediana (méd.) **4,3**

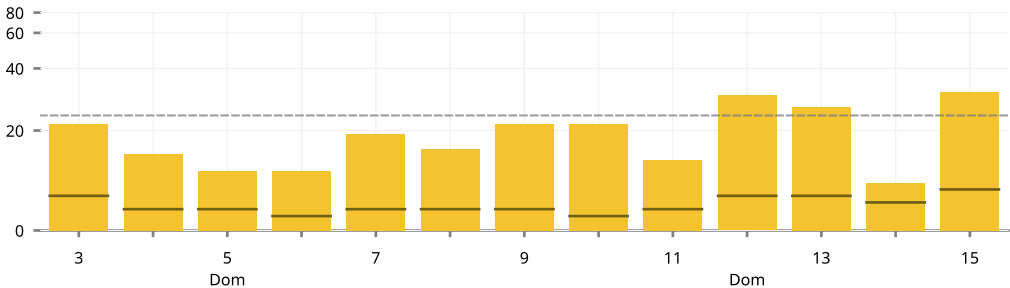


Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Definir pressão máx. **10,0**
Definir pressão mín. **4,0**

Máximo (méd.) **10,0**
% 95.º (méd.) **10,0**
Mediana (méd.) **9,9**

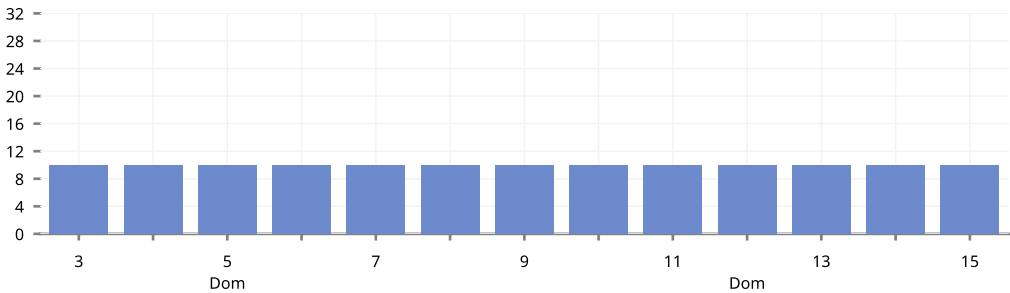

IAH (eventos/hora)

IAH ☐ **7.6**
IH ☐ **4.3**
IA ☐ **3.3**
IAC **3,2**
IAO **0,0**
IAD **0,0**
RERA **1,5**
%RCS (méd.) **0,0**

