


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/04/2026 - 12/04/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	1 dias (14%)	
Horas de utilização	44 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 22 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 22 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 6 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/04/2026)	3,684 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024667
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.1	Percentil 95.º: 8.5	Máximo: 8.6	
Fugas — l/min	Mediana: 2.9	Percentil 95.º: 22.1	Máximo: 40.1	
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 0.1	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 1.3	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

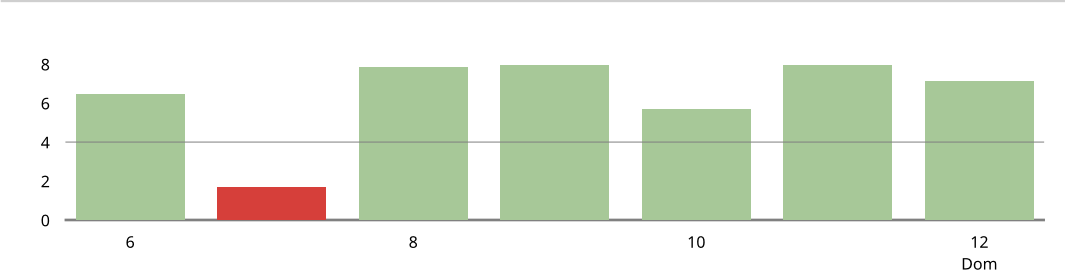


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024667


Utilização (horas)

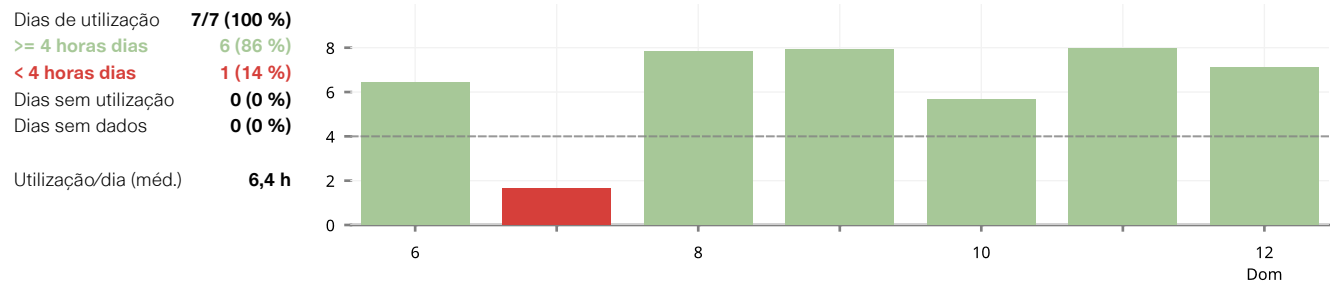

Fuga (l/min)

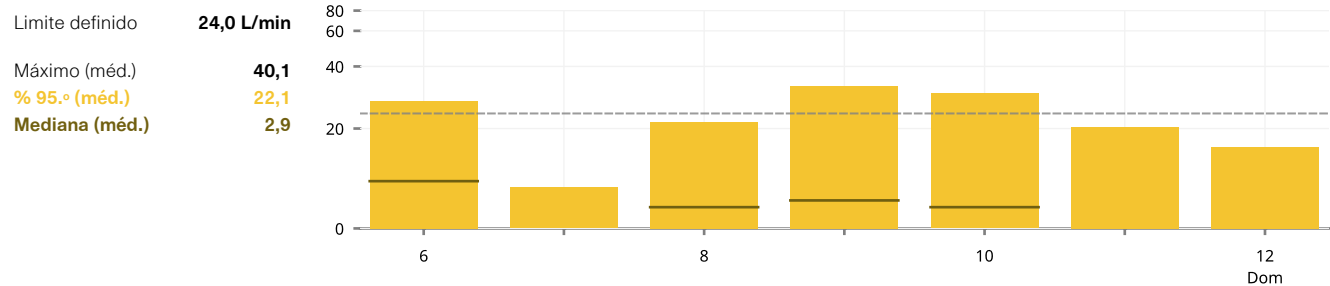

Pressão (cmH2O)

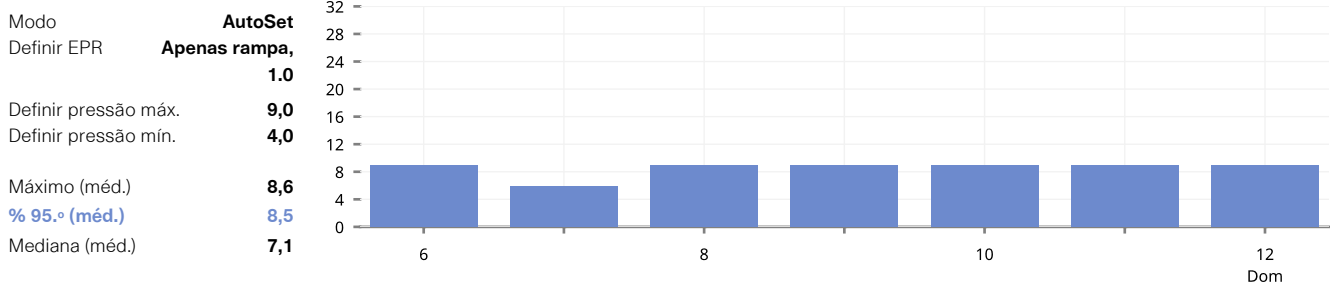

IAH (eventos/hora)

