


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/10/2025 - 16/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	24 dias (80%)	
< 4 horas	6 dias (20%)	
Horas de utilização	148 horas 20 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 57 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 56 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/11/2025)	7,362 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22201153481
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.4	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 11.0	Percentil 95.º: 29.2	Máximo: 38.6	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.3	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

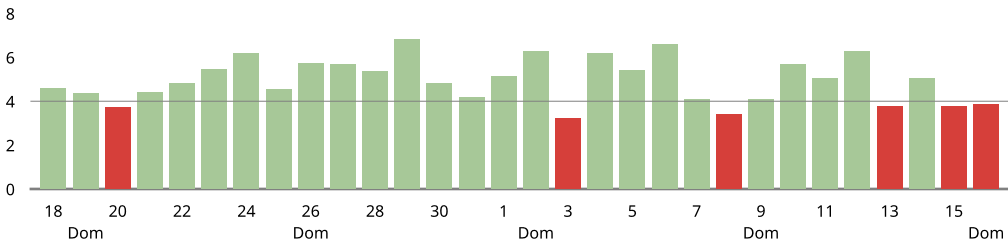


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22201153481


Utilização (horas)

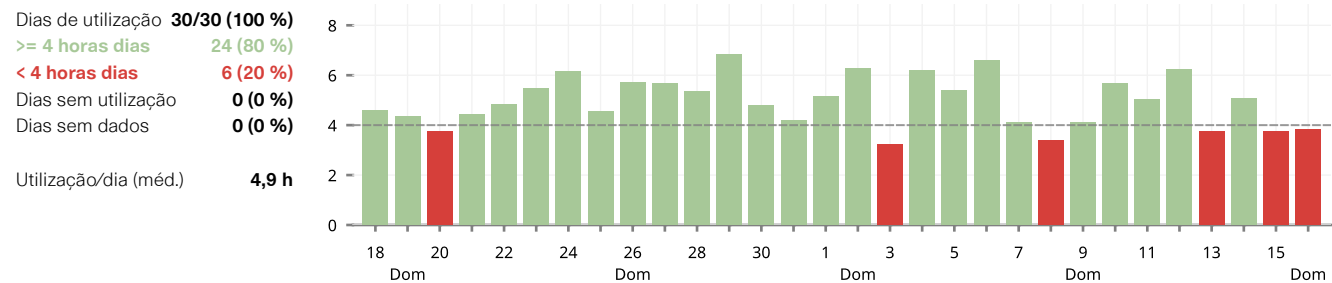

Fuga (l/min)

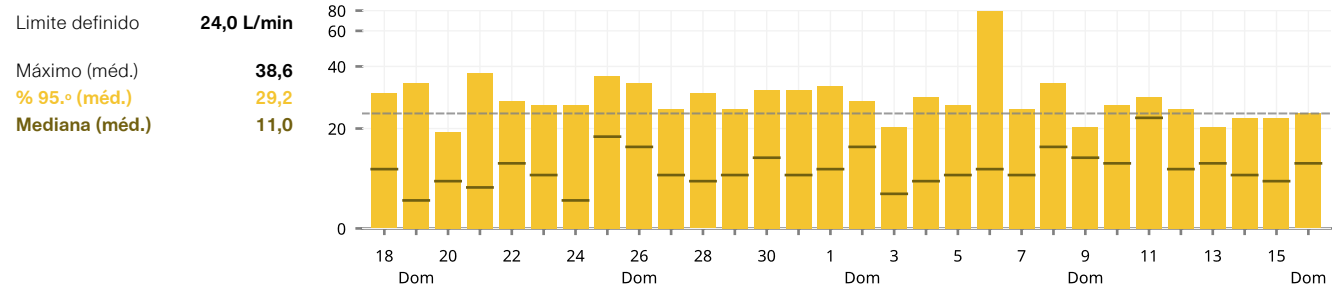

Pressão (cmH2O)

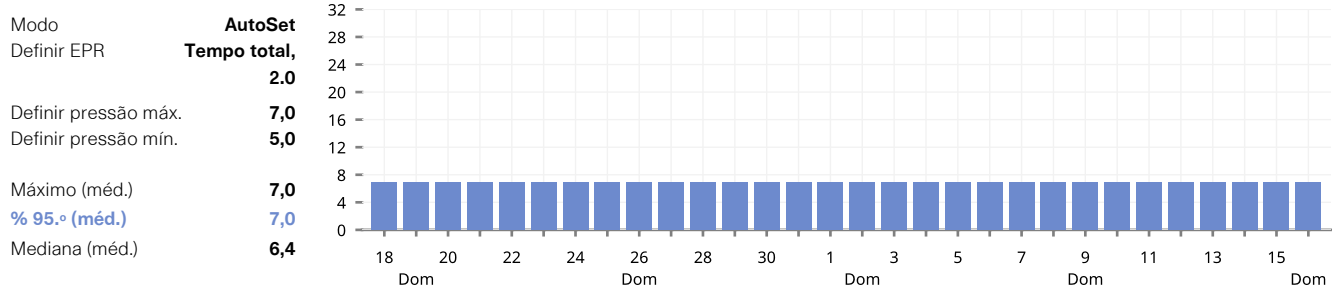

IAH (eventos/hora)

