


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/04/2026 - 13/04/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	47 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 50 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 29 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/04/2026)	47 horas	

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252032628
Modo	AutoSet for Her
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.5	Percentil 95.º: 8.9	Máximo: 9.1	
Fugas — l/min	Mediana: 2.9	Percentil 95.º: 9.8	Máximo: 16.8	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.4	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			





Horas de utilização

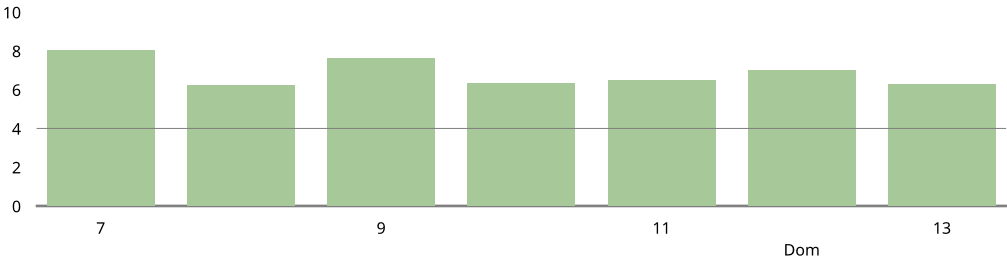

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet


NS: 22252032628

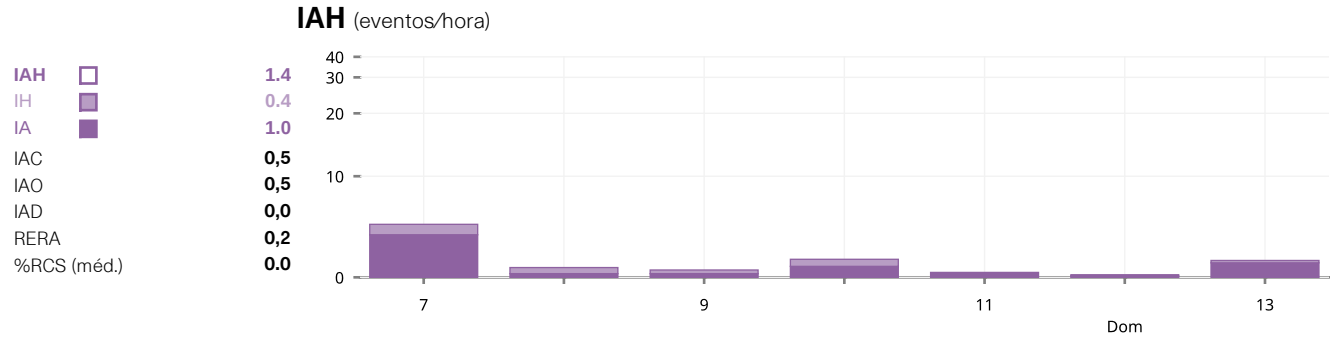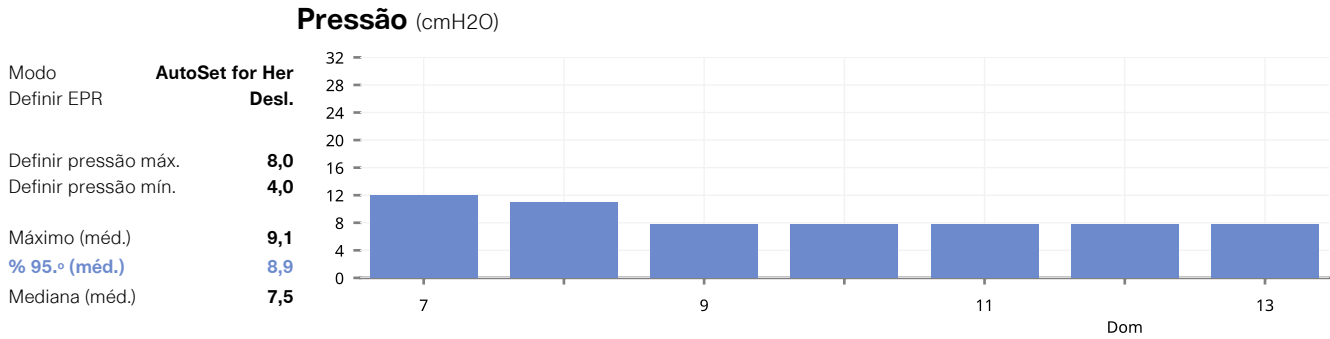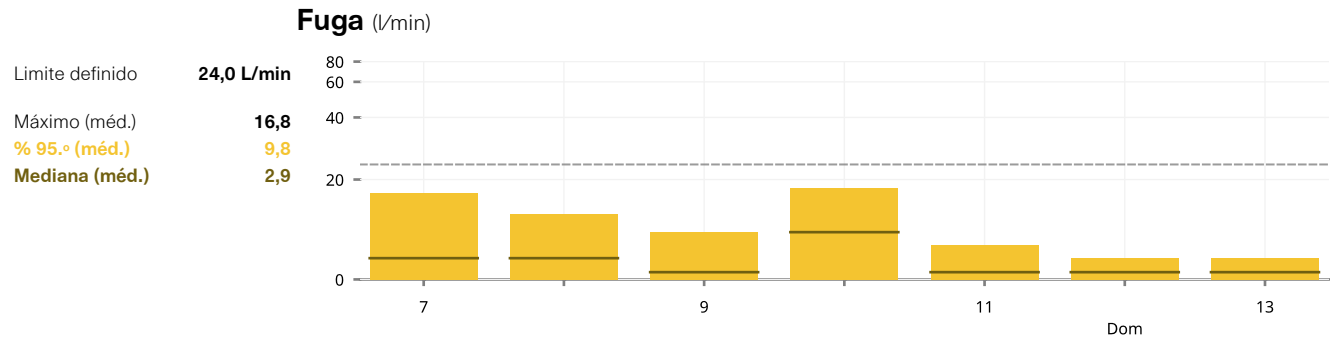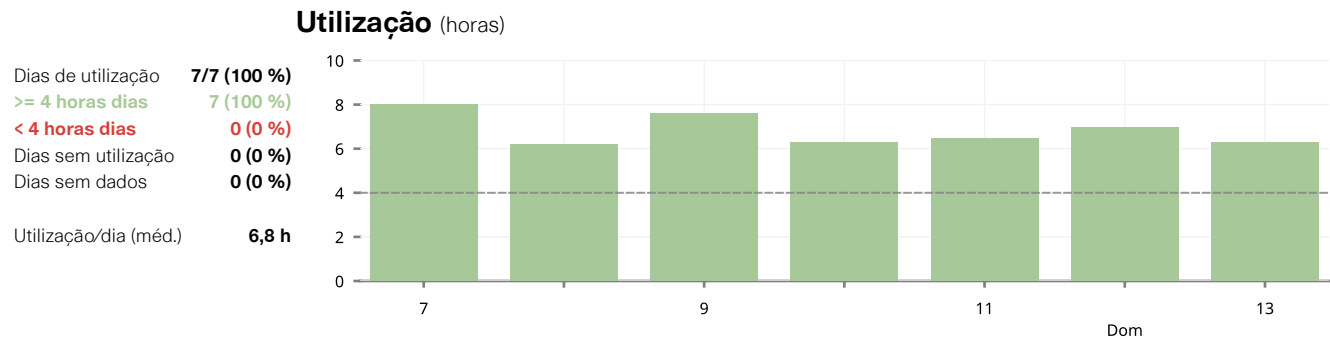

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032628

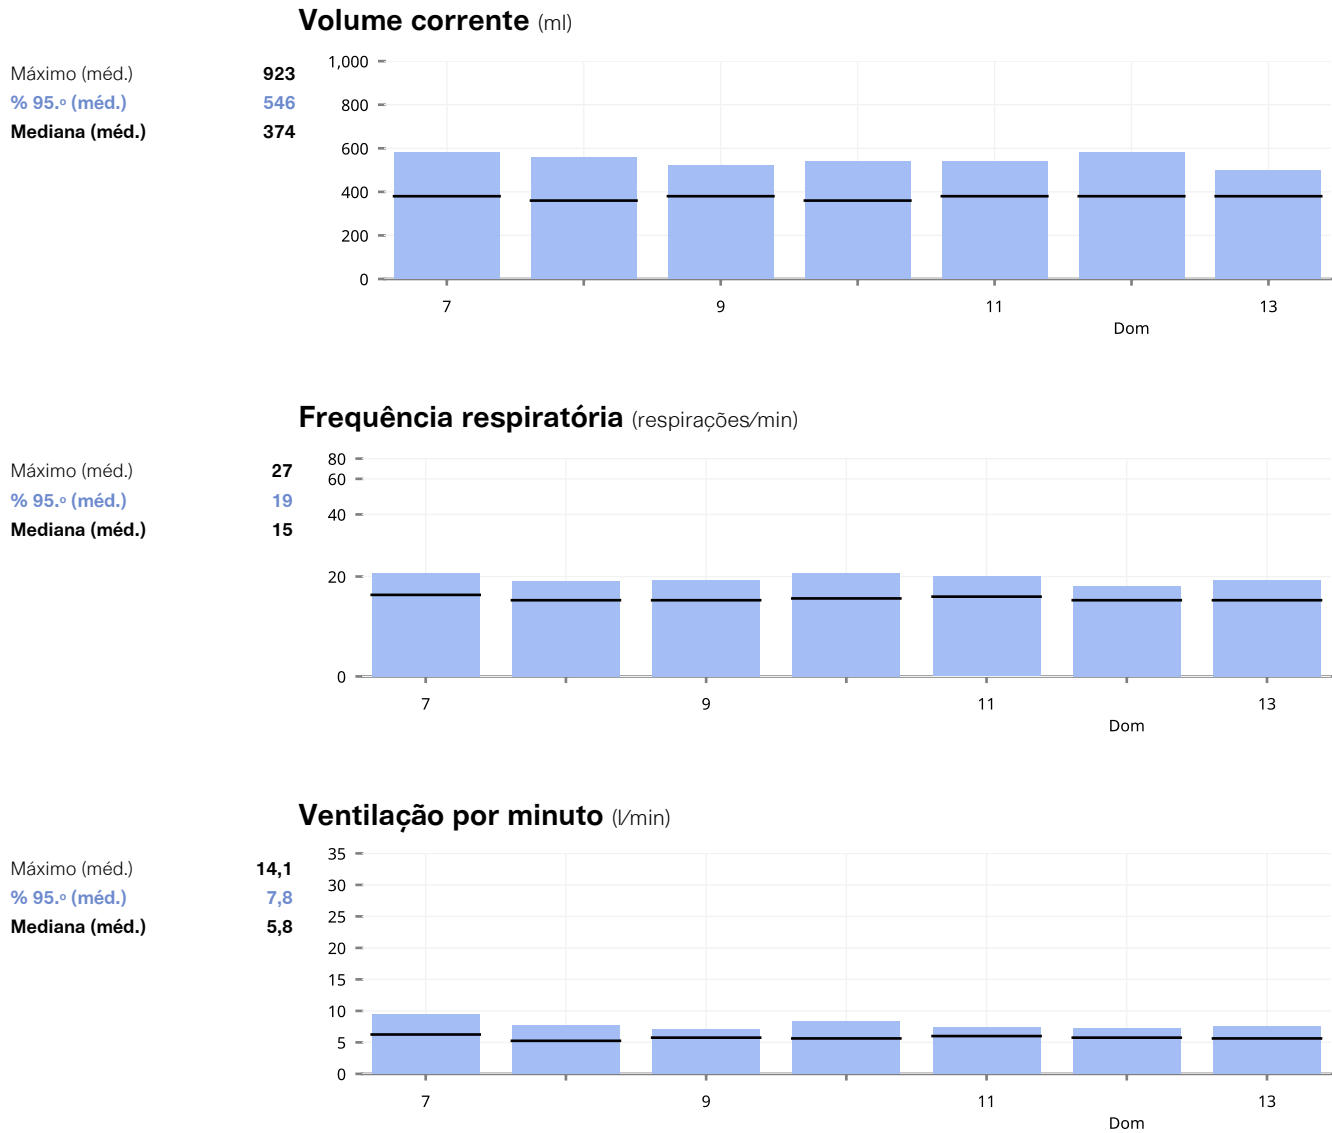

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032628

Care Check-In

11/04/2026

Como está sua terapia?

Bem 

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento