

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA**
Identificação do
paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **19 janeiro 1961** Idade: **65**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **06/05/2026**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

14/04/2026 - 05/05/2026 Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191750992)

Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: AutoSet	APE: RAMP_ONLY	Nível APE: 1,0 cmH2O
Activar APE: ON	Activação paciente APE: ON	Activação subida: ON
Tempo de rampa: 10,0 Minutos	Acesso: LIGADO	Resposta: STANDARD
Pressão mínima: 7,0 cmH2O	Pressão máxima: 14,0 cmH2O	
Pressão - cmH2O		
Mediana: 10,3	Percentil 95: 13,1	Máximo/a: 13,9
Fuga - l/min		
Mediana: 14,4	Percentil 95: 76,8	Máximo/a: 97,2
Índices respiratórios - eventos/hora		
Índice de apneia: 1,3	Índice de hipopneia: 0,4	AHI: 1,7
Obstrutiva: 0,5	Central: 0,3	Desconhecida: 0,2
Índice RERA: 0,2	% tempo em CSR: 0,0	
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 18	Dias de Uso < 4 horas : 2	% Dias de Uso >= 4 horas : 81
Dias de não utilização: 2	Totalidade de dias: 22	Horas de utilização: 109:25
Mediana do uso diário: 5:39	Média de uso diário: 4:58	


Estatísticas de oximetria

Gráficos em sumário


14/04/2026 - 05/05/2026

Dispositivo: AirSense 10 AutoSet (S/N: 22191750992)


Pressão

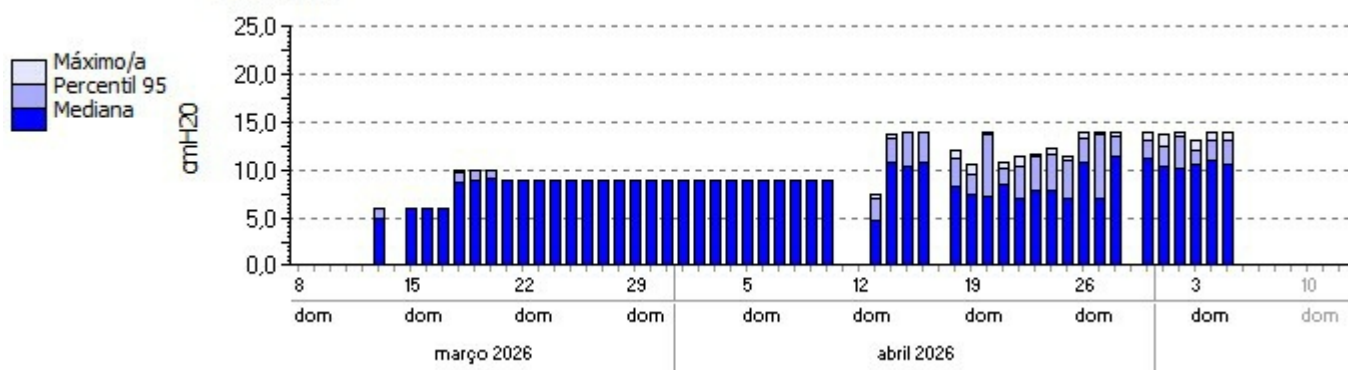


Fuga

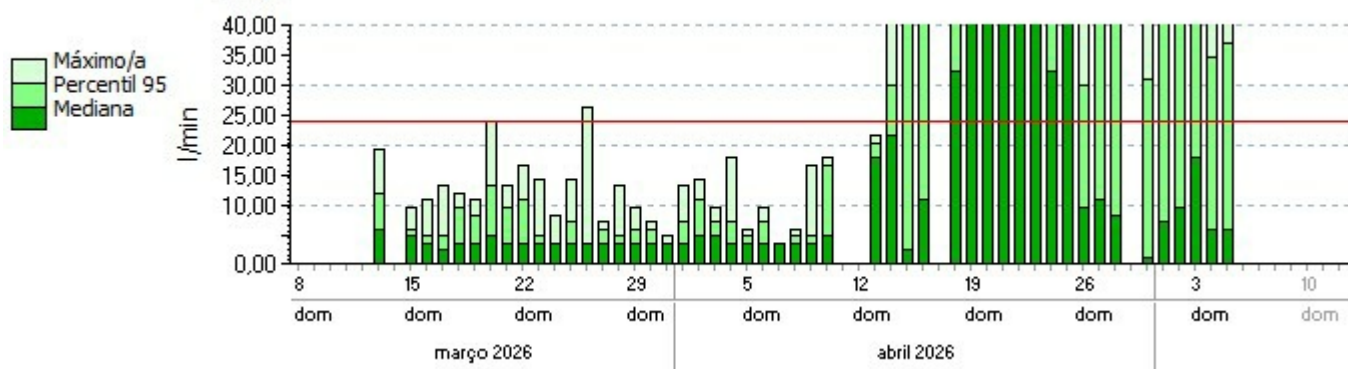

IAH & IA

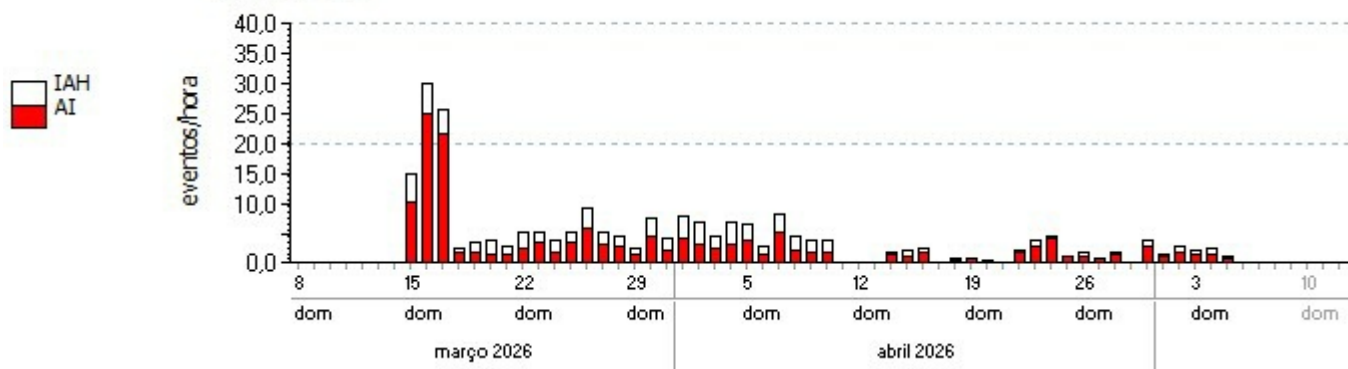

Uso

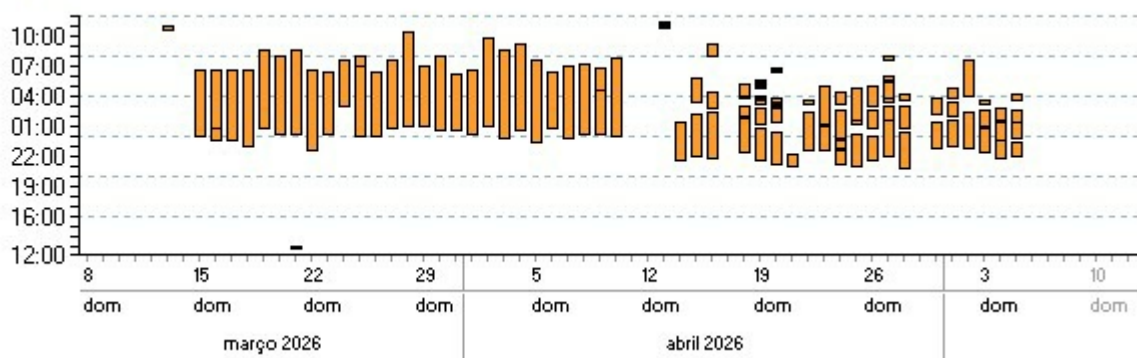

Utilização total e Cheyne-Stokes

