


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                     | 27/04/2026 - 09/05/2026 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 13/13 dias (100%)   |                         |
| >= 4 horas                                                   | 13 dias (100%)      |                         |
| < 4 horas                                                    | 0 dias (0%)         |                         |
| Horas de utilização                                          | 80 horas 59 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 6 horas 14 minutos  |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 6 horas 14 minutos  |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 8 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 09/05/2026) | 594 horas           |                         |

| AirSense 10 AutoSet |             |
|---------------------|-------------|
| Número de série     | 22222291908 |
| Modo                | AutoSet     |
| Pressão mín.        | 5 cmH2O     |
| Pressão máx.        | 7 cmH2O     |
| EPR                 | Desl.       |
| Resposta            | Padrão      |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 6.4   | Percentil 95.º: 7.0  | Máximo: 7.0  |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 0.3   | Percentil 95.º: 25.8 | Máximo: 70.8 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 1.9        | IH: 0.8              | IAH: 2.7     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 1.5   | Obstrutiva: 0.1      | Desconhecid  | 0.2 |
| Índice RERA                                        | 0.3            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

## Horas de utilização

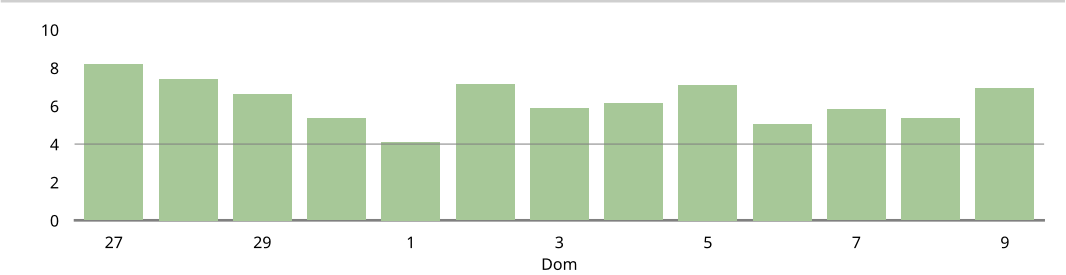


# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291908


## Utilização (horas)

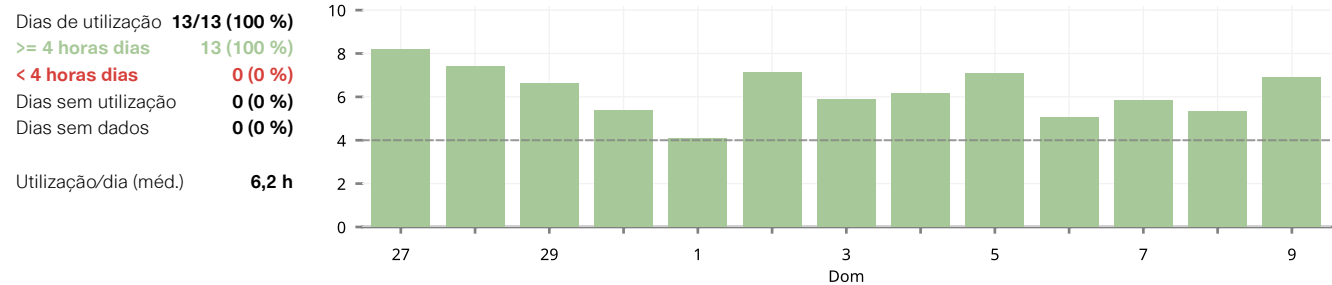

## Fuga (l/min)

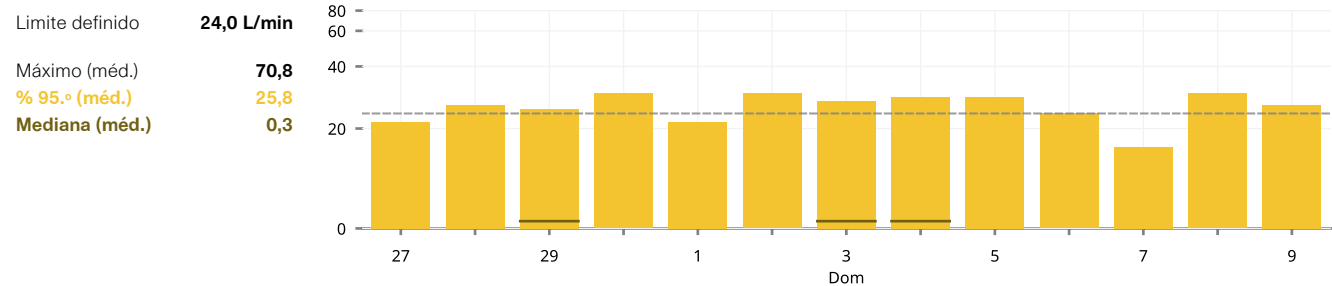

## Pressão (cmH2O)

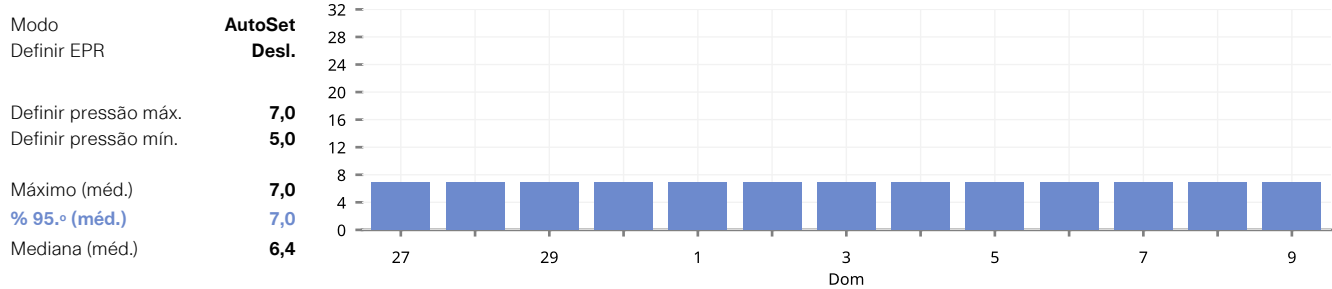

## IAH (eventos/hora)

