


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/03/2026 - 20/04/2026	
Dias de utilização		28/30 dias (93%)	
>= 4 horas		28 dias (93%)	
< 4 horas		0 dias (0%)	
Horas de utilização		169 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)		5 horas 39 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 3 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/04/2026)		5,759 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22191504756	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		5 cmH2O	
Pressão máx.		14 cmH2O	
EPR		Tempo total	
Nível de EPR		2	
Resposta		Suave	
Terapia			
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.7	Percentil 95.º: 9.5	Máximo: 10.8
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 4.3	Máximo: 17.3
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.3	IAH: 0.6
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid 0.0
Índice RERA		0.2	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização

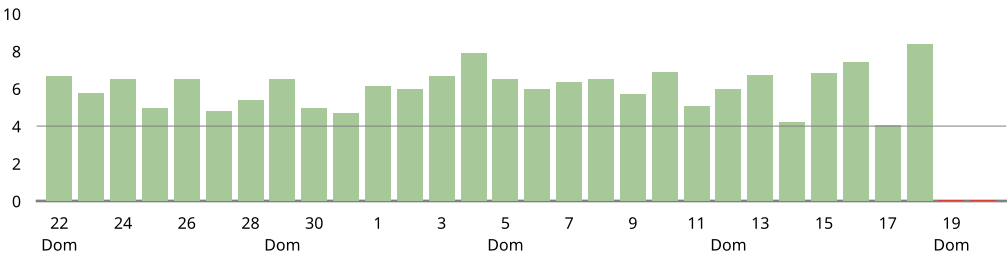


Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22191504756


Utilização (horas)

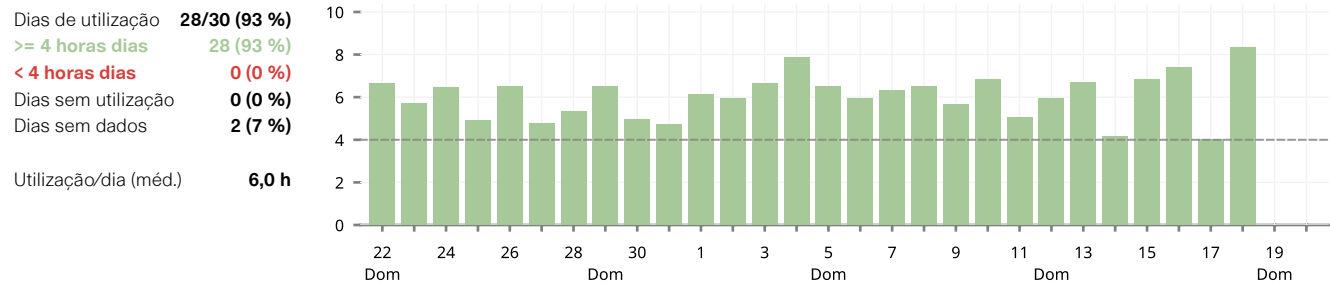

Fuga (l/min)

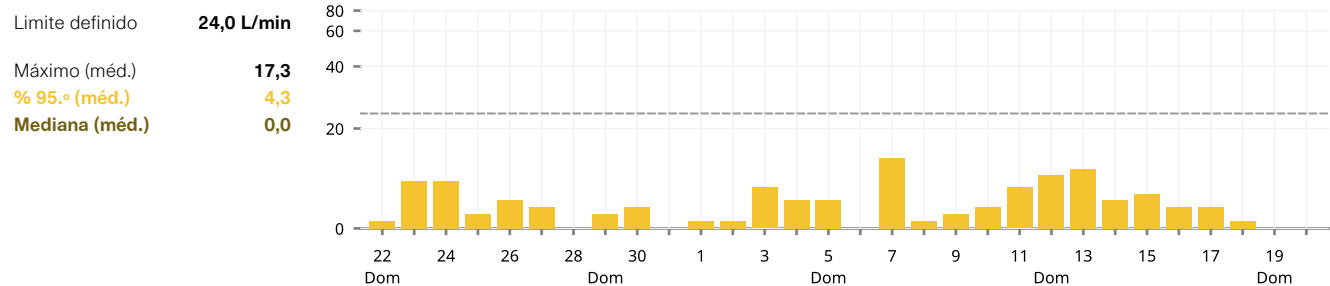

Pressão (cmH2O)

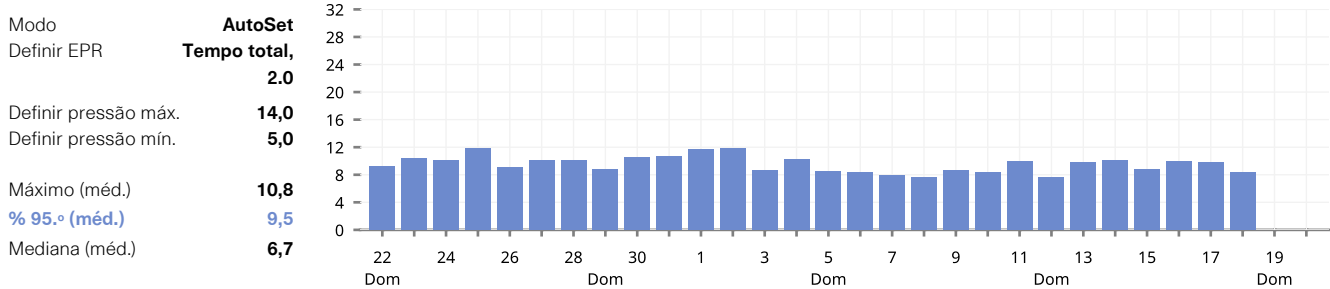

IAH (eventos/hora)

