


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/04/2026 - 26/04/2026
Dias de utilização	17/17 dias (100%)	
>= 4 horas	17 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	102 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 26/04/2026)	102 horas	

AirSense 11 AutoSet	
Número de série	22252032522
Modo	AutoSet for Her
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	20 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.8	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 13.1	Máximo: 26.3	
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 0.9	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 1.1	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

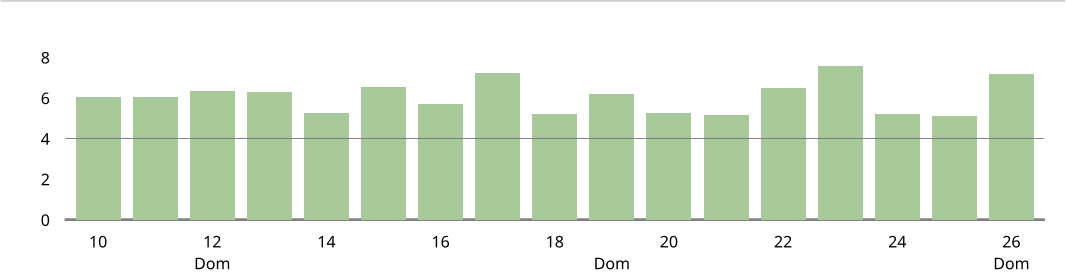


Relatório de terapia


AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032522


Utilização (horas)

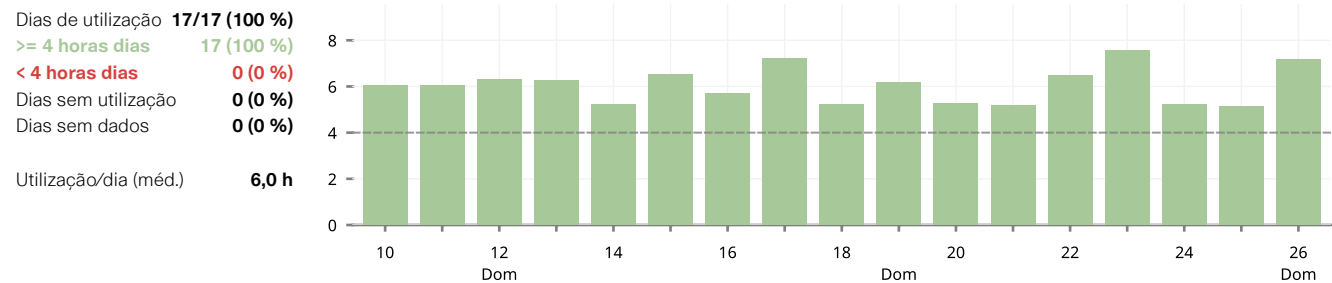


Fuga (l/min)

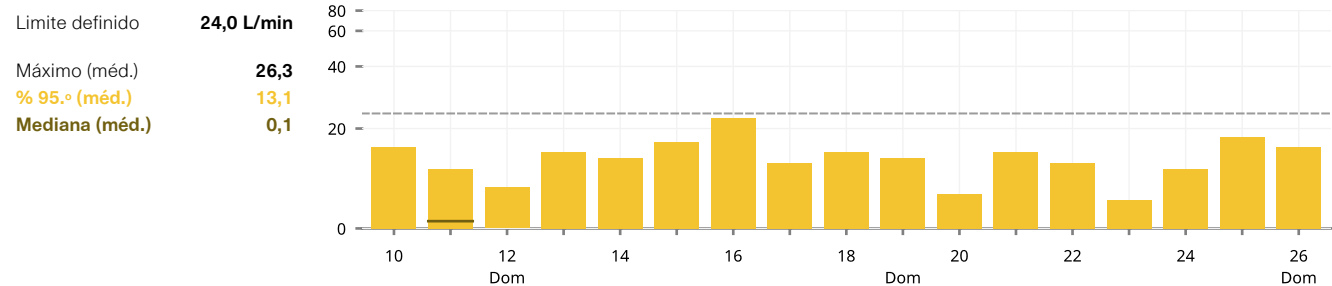

Pressão (cmH2O)

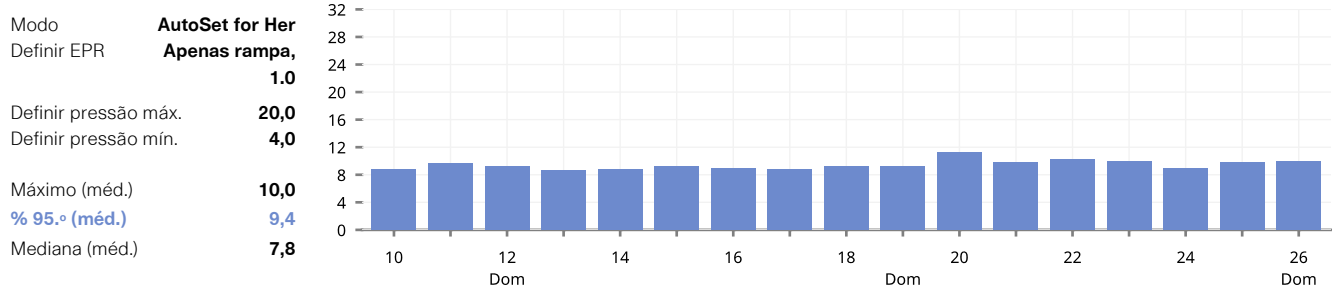


IAH (eventos/hora)

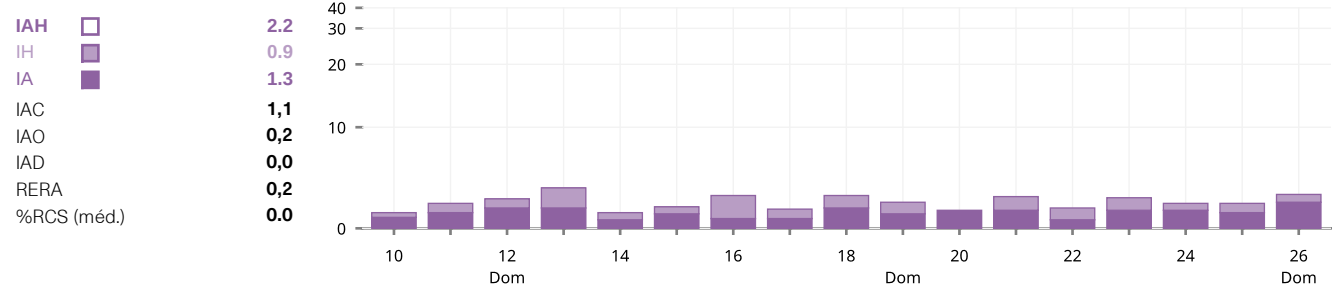

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032522

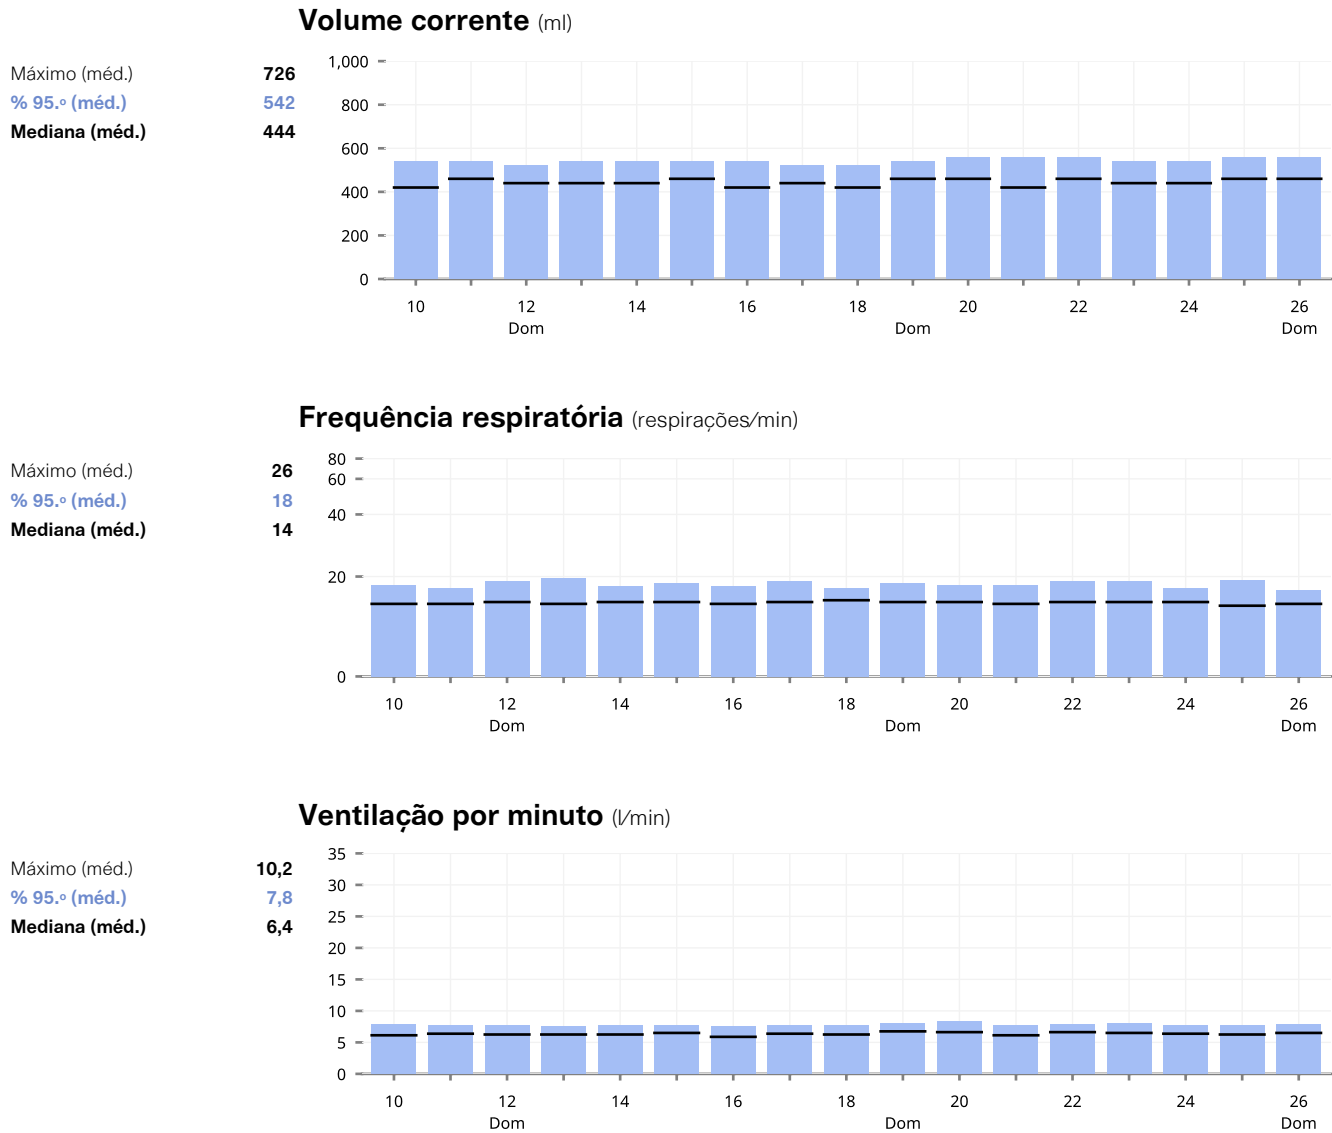

Relatório de terapia

AirSense 11 AutoSet

NS: 22252032522

Care Check-In

Não há dados disponíveis porque o usuário se recusou a responder as perguntas de terapia, esse recurso foi desativado no dispositivo do usuário ou o usuário não autorizou compartilhar seus dados com o myAir.

Sobre o Care Check-In

São realizadas pesquisas curtas com pacientes em dispositivos ResMed selecionados (incluindo Air11™) e no aplicativo myAir para entender melhor como o paciente está se saindo com a terapia. Se o paciente consentir, podemos compartilhar informações do Care Check-in por meio do AirView para usuários clínicos.

Perguntas e respostas

No início da terapia, é feita uma pergunta de referência ao paciente. Algumas perguntas adicionais são feitas, cerca de uma vez por semana, durante os estágios iniciais da terapia. As perguntas variam de acordo com o tipo de dispositivo. Por exemplo, para um dispositivo específico, você poderá ver perguntas deste tipo:

Quão sonolento você se sentiu esta semana? Extremamente, Muito, Moderado, Levemente, Não me senti sonolento