


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/04/2026 - 27/04/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	36 horas 11 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/04/2026)	4,078 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291912
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.9	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 9.3	
Fugas — l/min	Mediana: 17.8	Percentil 95.º: 36.6	Máximo: 57.6	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.2	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização

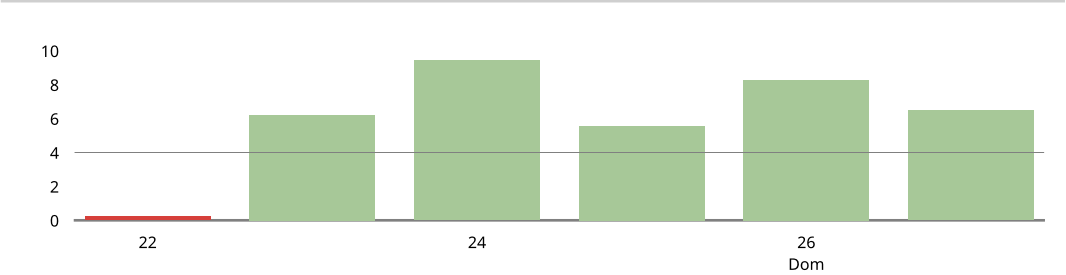

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291912

Utilização (horas)

Dias de utilização**6/6 (100 %)**
>= 4 horas dias**5 (83 %)**
< 4 horas dias**1 (17 %)**
Dias sem utilização**0 (0 %)**
Dias sem dados**0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.)**6,0 h**

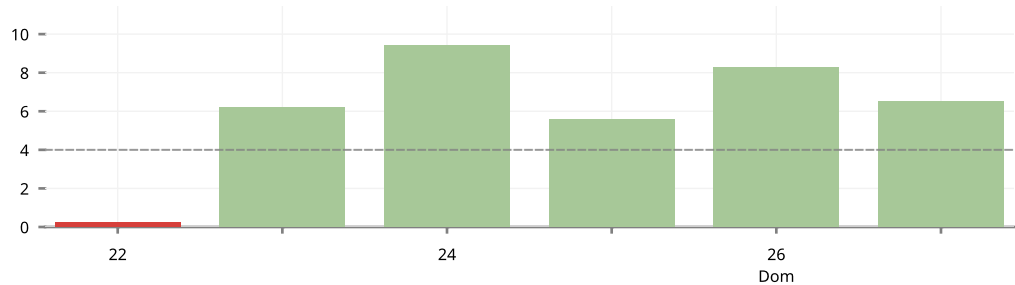

Fuga (l/min)

Limite definido**24,0 L/min**

Máximo (méd.)**57,6**
% 95.º (méd.)**36,6**
Mediana (méd.)**17,8**

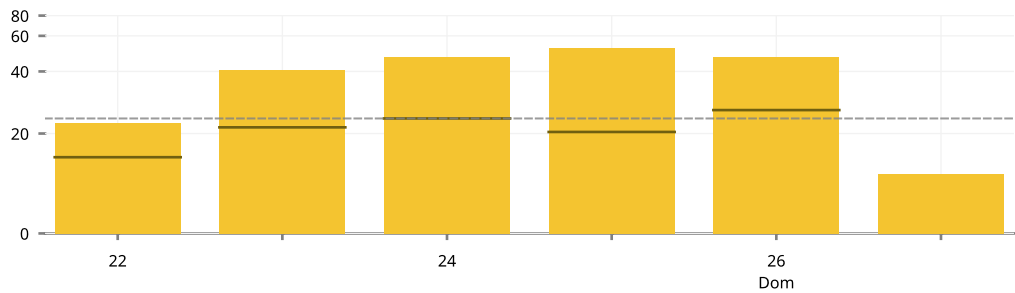


Pressão (cmH2O)

Modo**AutoSet**
Definir EPR**Desl.**

Definir pressão máx.**10,0**
Definir pressão mín.**4,0**

Máximo (méd.)**9,3**
% 95.º (méd.)**8,8**
Mediana (méd.)**6,9**

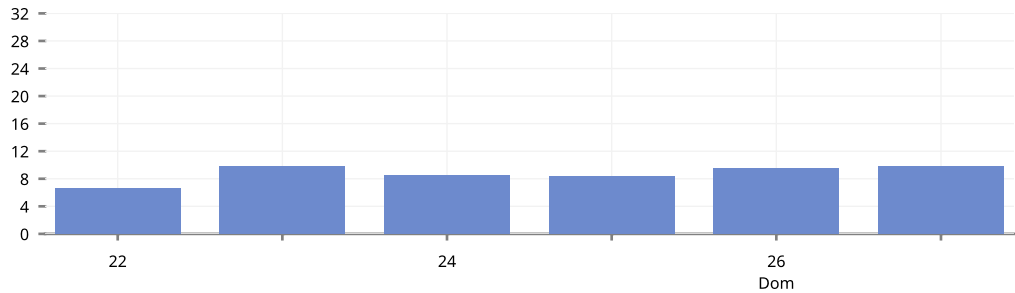

IAH (eventos/hora)

IAH ☐**0.4**
IH ☐**0.2**
IA ☐**0.2**
IAC**0,0**
IAO**0,0**
IAD**0,1**
RERA**0,9**
%RCS (méd.)**0.0**

